

技术资料

Oxymax COS61D, COS61

荧光法溶解氧传感器



荧光淬灭法测量原理，采用或不采用 Memosens 通信协议的数字式荧光法溶解氧传感器

应用

- 污水处理厂
 - 在活性污泥池中进行溶解氧测量和调节，实现高效生物净化过程
 - 污水处理厂出水口中的氧浓度监测
- 水质监测
 - 用作水质指标，例如：河水、湖水或海水中的溶解氧测量
- 水处理
 - 用于状态监控的溶解氧测量，例如：饮用水(富氧、腐蚀保护等)
- 渔场
 - 优化活性和增长条件的溶解氧测量和调节

优势

- 采用荧光淬灭法测量原理：
 - 低维护需求
 - 高可用性
- 传感器自带数字信号处理功能：
 - 传感器内保存有标定参数
 - 与变送器进行数字通信，高电磁兼容安全防护等级
- 更长维护间隔时间，高长期稳定性
- 配备智能自监测功能，测量值始终准确可靠
- 无最小介质流量要求，满足静水测量要求
- COS61D 数字式传感器，连接 Liquiline 变送器：
 - 即插即用：采用 Memosens 技术，安全数据通信
 - 可选配 M12 插头，快速连接变送器
- COS61 模拟式传感器，连接 Liquisys 变送器：
 - 兼容 COS31，连接 COM2x3W 变送器使用：测量点轻松升级改造为荧光法测量系统
 - 兼容 COS41，通过转换套件连接 COM2x3D 变送器使用

功能与系统设计

测量原理

传感器结构

氧敏感分子（记号体）集成在光学活性层（荧光层）中。荧光层、光学隔离层和保护层依次叠加在载板上。保护层直接接液。传感器光学部件位于载板下方，即荧光层下方。

测量过程（淬灭原理）

传感器插入至介质中时，介质和荧光层之间迅速建立氧分压平衡。

1. 传感器光学部件向荧光层发出绿色光脉冲信号。
2. 记号体发出红色光脉冲信号进行响应。
 - ↳ 响应信号的持续时间和强度与氧浓度和氧分压直接相关。

在无氧介质中响应信号持续时间长，信号强度高。

氧分子掩蔽记号体分子。因此响应信号持续时间变短，信号强度变弱。

测量结果

- ▶ 传感器返回的信号与介质中的溶解氧浓度相关。

可以固定设置大气压力，或者通过其他传感器输入大气压力。传感器内部自动记录介质温度。溶解氧计算过程中将考虑这两项参数。

传感器输出温度和氧分压测量值，以及原始测量值。原始测量值等于荧光衰减时间，在空气中约为 20 μs ，在无氧介质中约为 60 μs 。

获取最优测量结果

1. 在标定过程中，在变送器中输入当前大气压力。
2. 如果无法在空气 **100% rH** 条件下执行测量：
 - 输入当前湿度。
3. 测量高含盐量介质时：
 - 输入盐度。
4. 测量单位为%Vol 或%SAT 时：
 - 还需要在测量模式下输入当前工作压力。



- Memosens 的《操作手册》BA01245C
适用 Liquiline CM44x/P/R、Liquiline System CA80XX 和 Liquistation CSFxx 系列的所有变送器、分析仪和采样仪
- Liquisys COM2x3 的《操作手册》BA00199C

测量系统


COS61D

整套测量系统包括:

- Oxymax COS61D 溶解氧传感器
带整体电缆 (配备线鼻子或 M12 插头, 取决于具体订购型号)
- Liquiline CM44x 多通道变送器
- 安装支架, 例如 COA250 流通式安装支架、CYA112 浸入式安装支架或 COA451 可伸缩式安装支架

可选:

- 浸入式安装的 Flexdip CYH112 安装支座
- CYK11 延长电缆, 连接接线盒
- 清洗系统

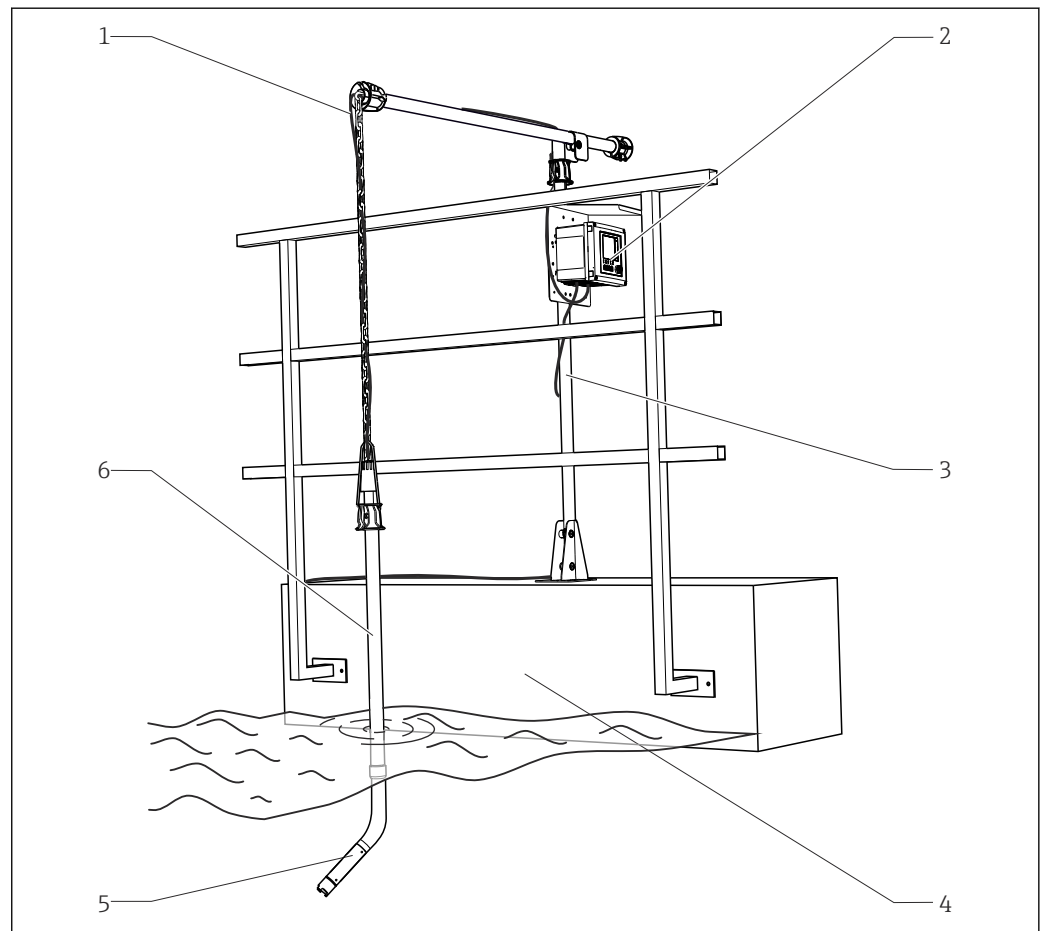

A0042837

图 1 安装有 COS61D 传感器的测量系统示意图

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1 传感器电缆 | 4 池边, 带护栏 |
| 2 Liquiline CM44x 变送器 | 5 Oxymax COS61D 溶解氧传感器 |
| 3 Flexdip CYH112 安装支座 | 6 Flexdip CYA112 安装支架 |


COS61

整套测量系统包括:

- Oxymax COS61 溶解氧传感器
- 变送器, 例如 Liquisys COM2x3-W
- 传感器电缆
- 安装支架, 例如 COA250 流通式安装支架、CYA112 浸入式安装支架或 COA451 可伸缩式安装支架

可选:

- 浸入式安装的 Flexdip CYH112 安装支座
- VS 接线盒 (连接延长电缆)
- 清洗系统

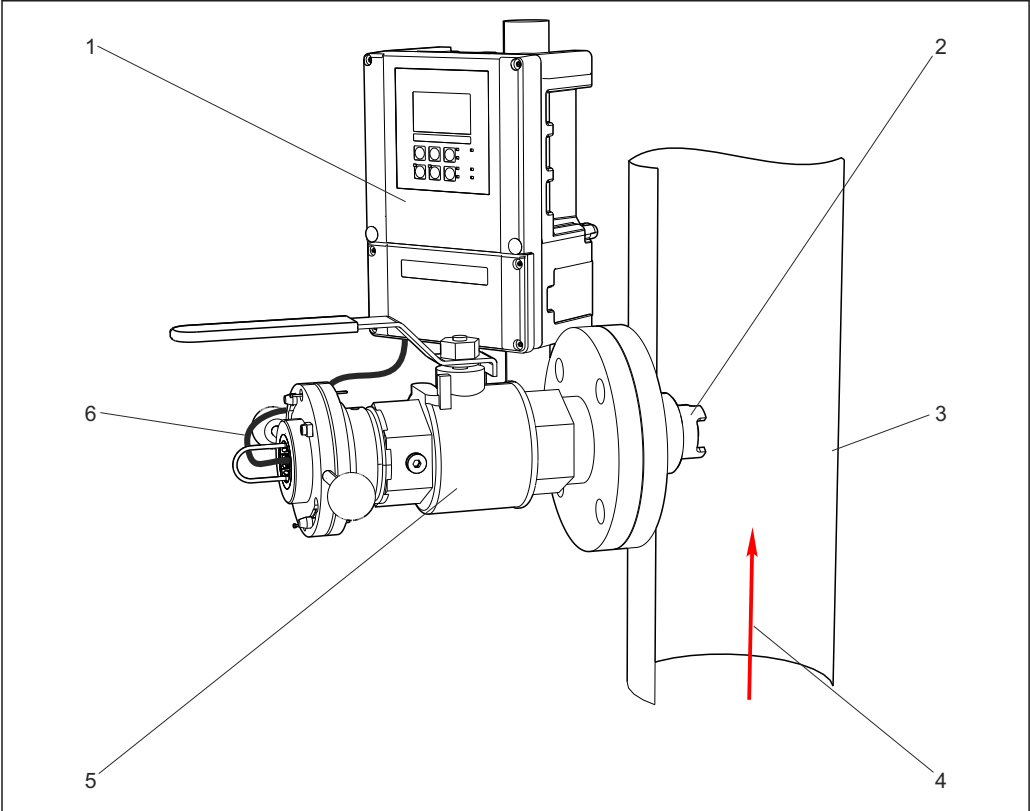

A0012885

2 安装有 COS61 传感器的测量系统示意图

- | | | | |
|---|---------------------|---|----------------------|
| 1 | Liquisys COM253 变送器 | 4 | 介质流向 |
| 2 | Oxymax COS61 溶解氧传感器 | 5 | Cleanfit COA451 安装支架 |
| 3 | 管道 (介质自下向上流动) | 6 | 传感器电缆 |

输入

测量变量	溶解氧[mg/l、µg/l、ppm、ppb、% SAT 或 hPa]
测量范围	20 °C (68 °F)和 1013 hPa (15 psi)条件下的测量范围 与 Liquiline CM44x、CM44xR、CM44P 或 Liquisys COM2x3-W 搭配使用: ■ 0...20 mg/l ■ 0...400 hPa ■ 0...200 % SAT

电源

电气连接

COS61D
电气连接
将传感器电缆直接连接至变送器基本模块的接线端子上

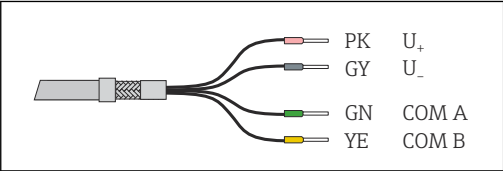


图 3 传感器整体电缆，电缆线芯完成预端接

可选：传感器电缆插头直接插入变送器上的 M12 插座。
选择此类接线方式的变送器出厂前已经完成相应的接线操作。

连接至现场设备
选择带 SXP 插头的专用测量电缆，直接连接传感器和变送器。

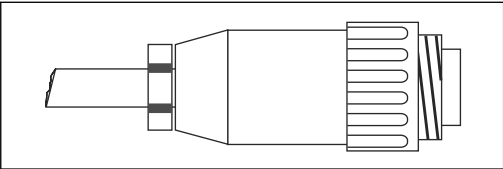


图 4 SXP 插头

连接至机柜盘装型设备

接线端子 COM223 变送器	传感器，整体电缆连接（OMK）		传感器，TOP68 插头连接（CYK71）	
	线芯	分配	线芯	分配
87	YE（黄）	+U _B	YE（黄）	+U _B
0	GN（绿）	0 V	WH（白）	0 V
96	PK（粉）	数字通信信号	GN（绿）	数字通信信号
97	BU（蓝）	数字通信信号	BN（棕）	数字通信信号
88	BN（棕）	-U _B	同轴（内部）	-U _B

1. 拆下电缆上的 SXP 插头（连接变送器的端口！）。
2. 参见电缆线芯分配和 Liquisys COM223-WX/WS 变送器的接线端子对应信息表。
 ↳ 注意：电缆分配取决于传感器型号（整体电缆连接或 TOP68 插头连接）。

性能参数

响应时间

在参考操作条件下，从空气到氮气：
t₉₀: 60 秒


最大测量误差 ¹⁾	COS61D	最大测量误差
	测量范围	0.01 mg/l 或读数值的±1 %
	< 12 mg/l	读数值的±2%
	12 mg/l...20 mg/l	
	COS61	最大测量误差
	测量范围	0.02 mg/l 或读数值的±1 %
	< 12 mg/l	读数值的±2%
	12 mg/l...20 mg/l	
重复性	最大量程的±0.5 %	
荧光帽使用寿命	超过两年（在参考操作条件下，采取直接日晒防护措施）	

安装

安装实例


浸入式安装

通用安装支架和链条式安装支架

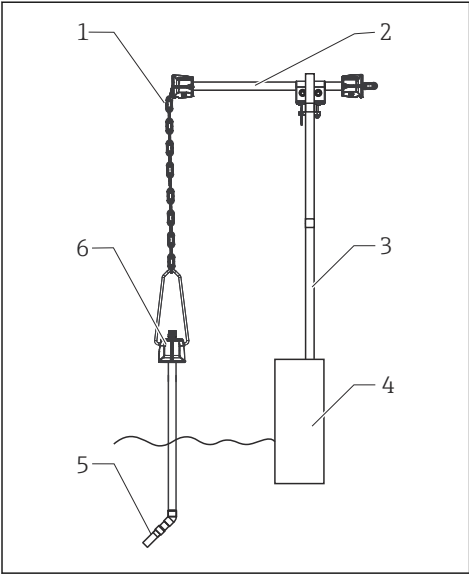

5 安装在护栏上的链条支架

- 1 链条
- 2 Flexdip CYH112 安装支架
- 3 护栏
- 4 池边
- 5 溶解氧传感器
- 6 Flexdip CYA112 安装支架（污水测量专用）

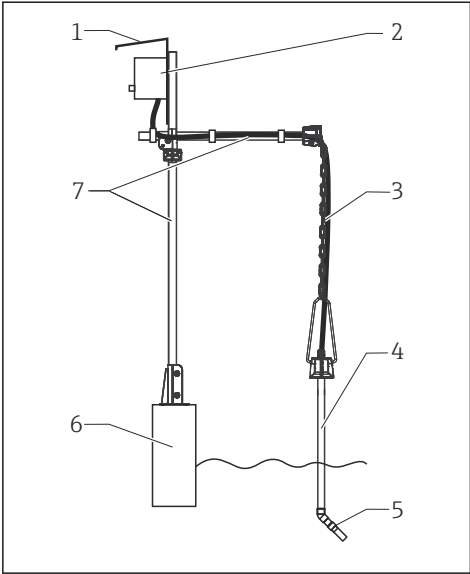


6 安装在立柱上的链条支架

- 1 CYY101 防护罩
- 2 变送器
- 3 链条
- 4 Flexdip CYA112 安装支架（污水测量专用）
- 5 溶解氧传感器
- 6 池边
- 7 Flexdip CYH112 安装支架

1) 在符合 IEC 60746-1 标准规定的标称操作条件下的测量数据

通用安装支座和固定浸入管

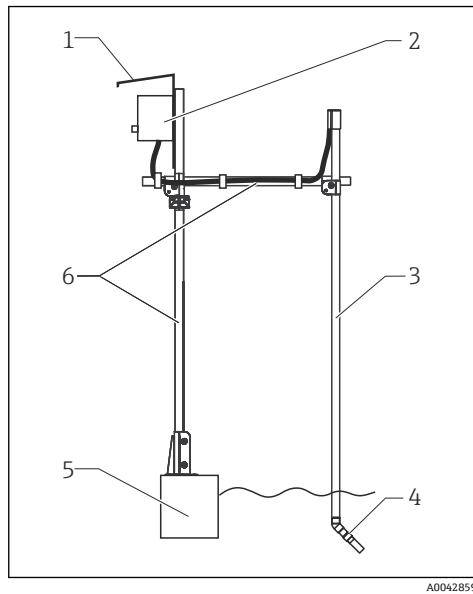


A0042859

图 7 带浸入管的浸入式支座

- 1 防护罩
- 2 变送器
- 3 Flexdip CYA112 浸入式安装支架
- 4 溶解氧传感器
- 5 池边
- 6 Flexdip CYH112 安装支座

使用浸入管在池边安装

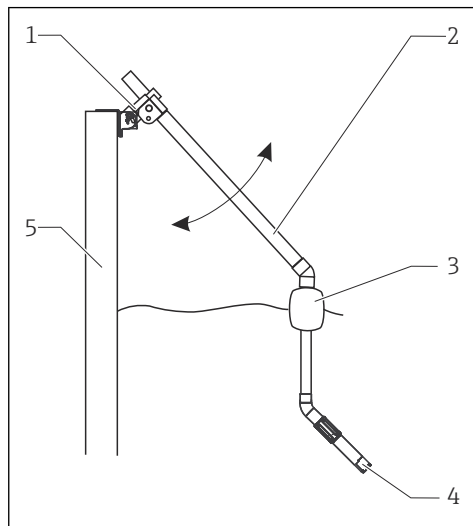


A0042860

图 8 池边安装

- 1 CYH112 悬摆基座
- 2 Flexdip CYA112 安装支架
- 3 浮球
- 4 溶解氧传感器
- 5 池边

浮子


CYA112 浮球型安装支架适用于水面波动剧烈的应用场合，例如河水中或湖中。

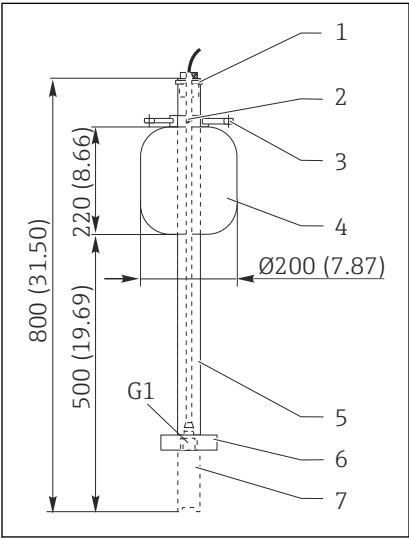


- 1 电缆，不受外力影响且防雨
- 2 固定环，用于缆绳和链条，带固定螺丝
- 3 Ø15 吊孔，3 x 120°定位
- 4 塑料浮球，耐盐水腐蚀
- 5 40 x 1 管道，1.4571 不锈钢
- 6 缓冲器和减震器
- 7 溶解氧传感器

9 单位: mm (inch)

流通式安装支架 COA250

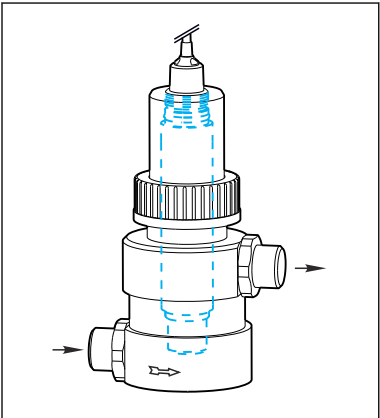

10 COA250

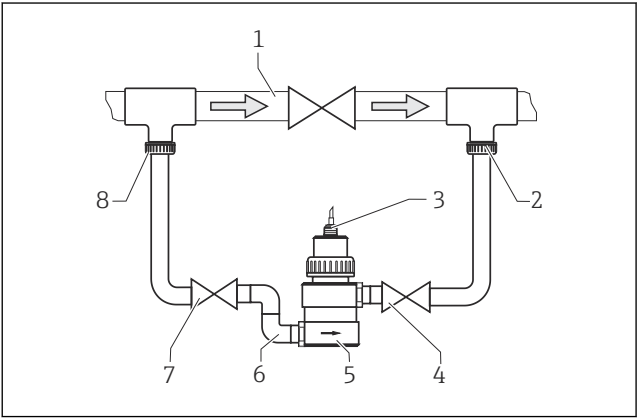

11 手动动作阀或电磁阀的旁路安装

- 1 主管道
- 2 介质回流
- 3 溶解氧传感器
- 4, 7 手动操作或电磁阀
- 5 流通式安装支架 COA250-A
- 6 90°管道弯头
- 8 排出介质

环境条件

环境温度范围 -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
相对湿度: 95%, 无冷凝

储存温度范围 -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
相对湿度: 95%, 无冷凝

防护等级 COS61D
IP 68 (测试条件: 10 m (33 ft) 水柱, 25 °C (77 °F) 时, 超过 30 天)

COS61

- 整体电缆型:
IP 68 (测试条件: 10 m (33 ft)水柱, 25 °C (77 °F)时, 超过 30 天)
- Top68 插头型:
IP 68 (测试条件: 1 m (3.3 ft)水柱, 50 °C (122 °F)时, 超过 7 天)

电磁兼容性

COS61D

干扰发射和抗干扰能力符合 EN 61326: 2005、Namur NE 21:2007 标准

COS61

干扰发射和抗干扰能力符合 EN 61326: 1997 / A1: 1998 标准

过程条件

过程温度范围


-5...+60 °C (20...140 °F)

过程压力范围

环境压力范围: 1...10 bar (14.5...145 psi) (绝压值)

机械结构


设计、外形尺寸 COS61D

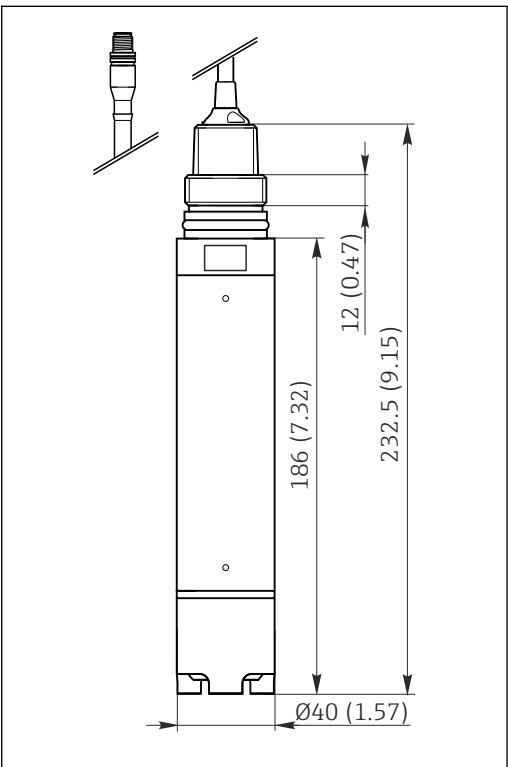

A0042896

12 带选配 M12 连接头

单位: mm (inch)

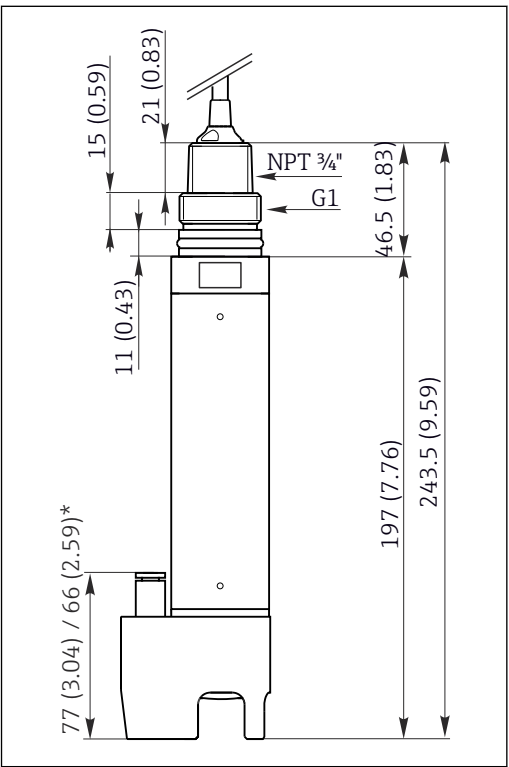

A0042897

13 带选配清洗单元

* 取决于清洗单元的具体型号

设计、外形尺寸 COS61

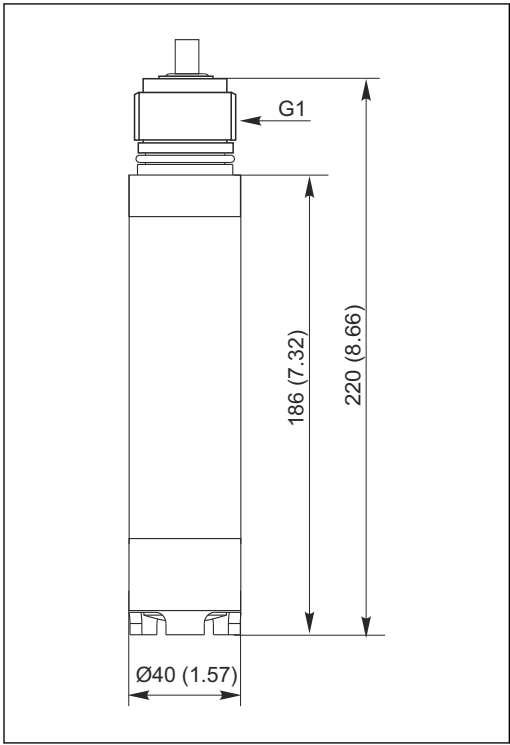


图 14 带整体电缆的型号
单位: mm (inch)

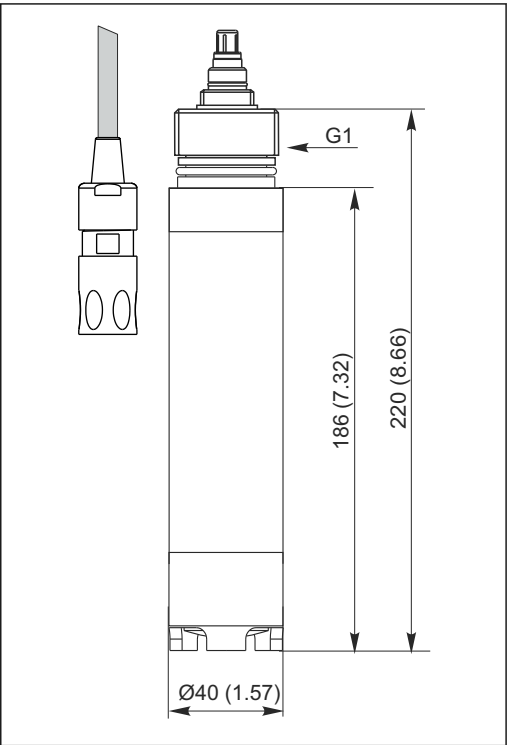


图 15 带 TOP68 插头的型号

清洗单元 (选配)

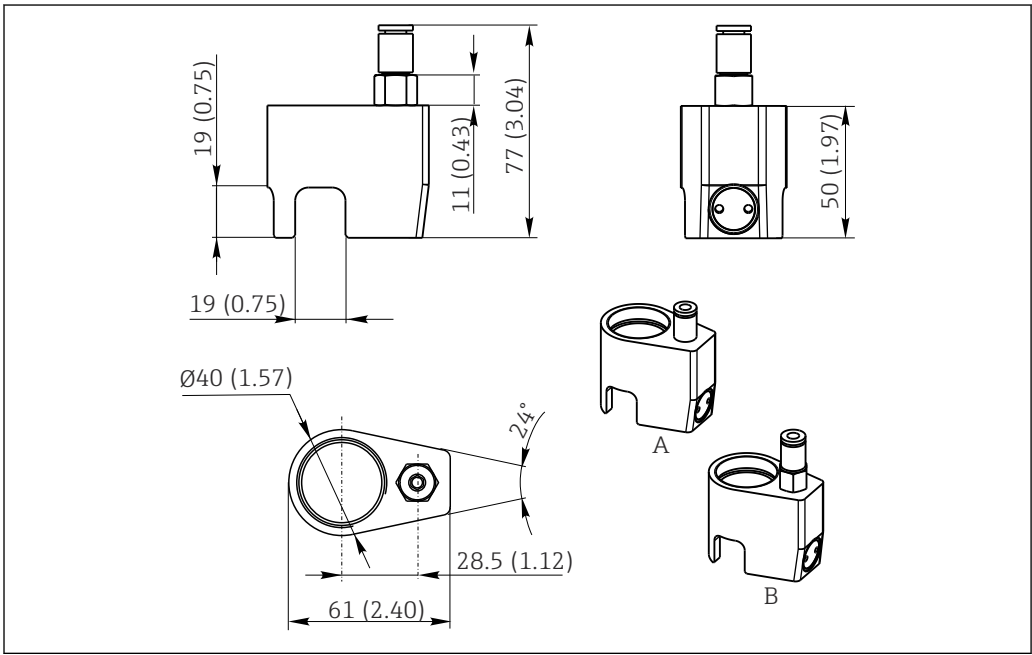


图 16 单位: mm (inch)
A 压缩空气清洗单元 (适用 COS61/61D) , 接口直径 6/8 mm (详细信息参见→ 图 14)
B 压缩空气清洗单元 (适用 COS61/61D) , 接口直径 6.35 mm (¼") (详细信息参见→ 图 14)

重量	带 7 m (23 ft) 电缆:	0.7 kg (1.5 lbs)
	带 15 m (49 ft) 电缆:	1.1 kg (2.4 lbs)
	带 TOP68 插头连接:	0.3 kg (0.66 lbs), 取决于型号

材质	接液部件	
	荧光帽	PVC / POM

	荧光层	硅
	孔板	PET
	O 型圈	EPDM
	荧光帽盖	1.4404
	传感器杆	1.4571
	接线盒	POM
	保护罩	POM
	空气吹扫单元外壳	POM
过程连接	COS61D G1、NPT 3/4" COS61 G1	
传感器电缆	COS61D 屏蔽四芯整体电缆 COS61 屏蔽七芯整体电缆，或带 4 根控制线芯的双层屏蔽同轴电缆（带 TOP68 插头）	
变送器连接电缆	COS61D ■ 接线端子连接、末端套圈 ■ 可选：M12 接头 COS61 ■ SXP 接头（现场设备） ■ 接线端子连接（盘装型仪表）	
最大电缆长度	最大 100 m (330 ft)，含延长电缆	
温度补偿	内部	

通信接口	COS61D Memosens 通信 COS61 RS 485
------	--

证书和认证

下文中列举了所有类型的认证。产品适用的认证类型取决于具体设备型号。

CE 认证	符合性声明 产品符合欧共体标准的一致性要求。因此，遵守 EU 准则的法律要求。制造商确保贴有 CE 标志的仪表均成功通过了所需测试。
EAC 认证 (仪表型号: COS61D-GR)	产品通过 TP TC 004/2011 和 TP TC 020/2011 准则的认证，可以在欧洲经济区 (EEA) 中使用。产品上带 EAC 一致性标签。
CSA GP 认证 (仪表型号: COS61D-CA)	通过 CSA GP 认证，符合下列要求： ■ 使用 2 类电源或有限能量电源，符合 CSA 61010-1-12 标准。 ■ 过电压等级：I ■ 环境条件：海拔不超过 2 000 m (6 560 ft)
CSAus NI Cl 1, Div 2 认证 (仪表型号: COS61D-CJ)	CSAus CL 1, DIV 2 防爆区应用²⁾ ■ 设备必须安装在外壳内或机柜中，需要使用工具或钥匙打开外壳或（安装）机柜后才能进行后续操作。 ■ 注意《操作手册》的“附录”章节中列举的《控制图示》、操作条件、说明以及指南要求。 防爆认证 Cl. 1, Divi. 2, Gr. A-D T6; IP67/IP68 ²⁾ 产品符合以下要求和标准： ■ ANSI/UL 61010-1 第 3 版 ■ ANSI/UL 121201-2017 ■ ANSI/IEC 60529 第 2.2 版（发布于 2013 年 8 月）：外壳防护等级（IP 代码） CL 1, DIV 2 防爆区中的安装与操作 本无火花型设备的防爆数据如下： ■ CSAus CL 1, DIV 2 ■ Gr. A-D ■ 温度等级 T6, $-20^{\circ}\text{C} (-4^{\circ}\text{F}) \leq T_a \leq 60^{\circ}\text{C} (140^{\circ}\text{F})$ ■ 防护等级：IP67/IP68 ■ 控制图示：211050778

订购信息

产品主页	www.endress.com/cos61 www.endress.com/cos61d
------	--

Configurator 产品选型软件	在产品主页上， 配置 按钮位于产品示意图右侧。 1. 点击按钮。 ↳ 在独立窗口中打开 Configurator 产品选型软件。 2. 按需选择所有选项，完成设备设置。 ↳ 生成有效完整的设备订货号。
----------------------------	--

2) 必须与 CM44x(R)-CD*配套使用

3. 以 PDF 或 Excel 文件输出订货号。正确点击选择窗口右上方的按钮操作。



许多产品还提供产品的 CAD 图或二维图形下载选项。点击 **CAD** 标签，并在下拉菜单中选择所需文件类型。

供货清单

传感器的供货清单

- 溶解氧传感器，带保护帽或已安装的清洗单元（选配）
- 《简明操作手册》

附件

以下为本文档发布时可提供的重要附件。

- 未列举附件的详细信息请联系 Endress+Hauser 当地销售中心。

安装支架（选配）

Flexdip CYA112

- 浸入式安装支架，用于水和污水测量
- 模块化安装支架系统，用于在敞口池、明渠和敞口罐中安装传感器
- 材质：PVC 或不锈钢
- 产品主页上的 Configurator 产品选型软件：www.endress.com/cya112



《技术资料》TI00432C

Flowfit COA250

- 流通式安装支架，适用于溶解氧测量
- 产品主页上的 Configurator 产品选型软件：www.endress.com/coa250



《技术资料》TI00111C

Cleanfit COA451

- 可伸缩式安装支架，手动操作，不锈钢材质，带截止球阀
- 用于安装溶解氧传感器
- 产品主页上的 Configurator 产品选型软件：www.endress.com/coa451



《技术资料》TI00368C

安装支座

Flexdip CYH112

- 模块化安装支座，用于在敞口池、明渠和水池中安装传感器和安装支架
- 用于安装 Flexdip CYA112 水和污水安装支架
- 可以随意选择固定位置：地面、石头、墙壁或直接安装在护栏
- 材质：塑料或不锈钢
- 产品主页上的 Configurator 产品选型软件：www.endress.com/cyh112



《技术资料》TI00430C

测量电缆

Memosens 电缆 CYK11

- 延长电缆，适用于 Memosens 数字式传感器
- 产品主页上的 Configurator 产品选型软件：www.endress.com/cyk11



《技术资料》TI00118C

零点凝胶

COY8

溶解氧传感器和消毒剂传感器用零点凝胶

- 无氧和无氯凝胶，用于对溶解氧和消毒剂测量单元进行验证、零点标定和调节
- 产品主页上的 Configurator 产品选型软件：www.endress.com/coy8



《技术资料》TI01244C

VS 接线盒 (适用 COS61)**VS 接线盒**

- 接线盒，用于延长带 SXP 连接插头的 COS61 传感器电缆
- 带插座和 7 针连接头
- 防护等级：IP 65
- 订货号：50001054

RM 接线盒 (适用 COS61D)**RM**

- 接线盒，用于连接带 Memosens 插接头的 COS61D 传感器的延长电缆
- 配备 2 个 PG 13.5 缆塞
- 防护等级：IP 65
- 订货号：51500832

保护罩**覆膜保护罩**

- 确保可以在渔场使用传感器
- 订货号：50081787

清洗单元**压缩空气清洗单元，适用 COSXX**

- 接口：直径 6/8 mm（包括缩径软管接头）或 6.35 mm (1/4")
- 材质：POM/V4A
- 订货号
 - 直径 6/8 mm：71110801
 - 直径 6.35 mm (1/4")：71110802

空气压缩机

- 适用压缩空气清洗
- 订货号
 - 230 V 交流电源：71072583
 - 115 V 交流电源：71194623

喷头清洗系统，适用 CYA112 安装支架

订货号

- 适用 600 mm (23.62 in) 安装支架长度：71158245
- 适用 1200 mm (47.42 in) 安装支架长度：71158246

Chemoclean CYR10B

- 传感器清洗喷头，安装在可伸缩式安装支架上使用
- 产品主页上的 Configurator 产品选型软件：www.endress.com/CYR10B



《技术资料》TI01531C

变送器**Liquiline CM44**

- 模块化多通道变送器，在危险区和非危险区中使用
- HART®、PROFIBUS、Modbus 或 EtherNet/IP 通信
- 订购信息参见产品选型表



《技术资料》TI00444C

标定帽 (适用 COS61)**标定容器**

- 适用于 COS61D/61
- 订货号：51518599



71554203

www.addresses.endress.com

中国E+H技术销售 www.ainstru.com
电话: 0755-82221901
邮箱: sales@ainstru.com