

技术资料

Deltabar PMD78B

液体的差压、液位和流量测量，以及气体的差压和流量测量

4...20mA HART, PROFINET + Ethernet-APL, PROFIBUS PA



数字式差压变送器，带金属膜片传感器

应用

- 最大压力：40 bar (600 psi)
- 最高过程温度：400 °C (752 °F) (隔膜密封)
- 最高耐压：160 bar (2 400 psi)
- 测量精度：测量量程的±0.075%

优势

新一代 Deltabar 压力变送器坚固耐用，功能先进：轻松实现现场或远程操作，支持按需维护，保证工艺过程智能安全。固件设计可以确保仪表的易操作性。操作向导直观清晰，帮助用户完成仪表调试和设备验证全过程。采用 **Bluetooth** 蓝牙接口通信协议，安全实现远程仪表操作。大屏背光显示，清晰显示测量值。采用 **Heartbeat Technology** 心跳技术应用软件包，配备心跳自校验和心跳自监测功能，能够及时检测出动态冲击压力或电源波动等异常工况。毛细管可以降低冲击压力。



目录

文档信息	4	海拔高度	30
信息图标	4	气候等级	30
图例说明	4	工作环境	30
缩写含义说明	5	防护等级	30
量程比计算	5	抗振性	31
		电磁兼容性 (EMC)	31
功能与系统设计	6	过程条件	32
设备结构	6	过程温度范围	32
测量系统	7	过程温度范围 (变送器温度)	33
通信和数据处理	8	隔膜密封系统的毛细管护套	34
HART、Bluetooth 蓝牙、PROFINET + Ethernet-APL、 PROFIBUS PA 通信型仪表的可靠性	8	过程压力范围	34
		保温层	35
输入	9	超纯气体应用	37
测量变量	9	氢气应用	37
测量范围	9		
		机械结构	38
输出	10	设计及外形尺寸	38
输出信号	10	外形尺寸	39
报警信号	10	带温度隔离器的仪表的过程连接	42
负载	10	带双侧毛细管隔膜密封系统的仪表的过程连接	46
阻尼时间	11	过程连接	50
防爆连接参数	11	重量	59
线性化功能	11	接液部件材质	62
通信协议规范	11	非接液部件材质	62
WirelessHART 通信	13	附件	65
		可操作性	66
电源	14	操作方式	66
接线端子分配	14	现场操作	66
仪表插头	14	现场显示单元	67
供电电压	15	远程操作	69
电气连接	16	系统集成	70
等电势连接	16	配套调试软件	71
接线端子	17	HistoROM	71
电缆入口	17		
电缆规格	17	证书和认证	72
过电压保护单元	17	CE 认证	72
		RCM-Tick 认证	72
性能参数	19	防爆认证	72
响应时间	19	腐蚀测试	72
参考操作条件	19	EAC 符合性声明	72
总体性能	19	溢出保护系统	72
分辨率	22	功能安全性 SIL/ IEC 61508 一致性声明	72
总体误差	22	船级社认证	72
长期稳定性	23	无线电认证	72
响应时间 (T63 和 T90)	24	CRN 认证	73
预热时间	24	测试报告	73
		压力设备指令 2014/68/EU	73
安装	25	氧气应用场合 (选配)	73
安装方向	25	中国 RoHS 认证	73
隔膜密封型仪表的安装说明	26	RoHS 认证	73
传感器选择和布置	27	PROFINET + Ethernet-APL 认证	74
特殊安装指南	28	其他认证	74
		订购信息	75
环境条件	30	订购信息	75
环境温度范围	30	供货清单	75
储存温度	30		

服务	75
测量点（位号）	75
测试报告、声明和检验证书	75
应用软件包	76
Heartbeat Technology 心跳技术	76
附件	77
设备专用附件	77
设备浏览器	77
文档资料	77
注册商标	77
隔膜密封系统（中国市场），订购选项 105	79
性能参数	79
过程条件	79
机械结构	80
证书和认证	93

文档信息

信息图标

警告图标



危险状况警示图标。若未能避免这种状况，可能导致人员严重或致命伤害。



潜在危险状况警示图标。若未能避免这种状况，可能导致人员严重或致命伤害。



潜在危险状况警示图标。若未能避免这种状况，可能导致人员轻微或中等伤害。



潜在财产损坏警示图标。若未能避免这种状况，可能导致产品损坏或附近的物品损坏。

电气图标

接地连接：⏏

接地端子，连接至接地系统。

特定信息图标

允许：☑

允许的操作、过程或动作。

禁止：☒

禁止的操作、过程或动作。

附加信息：ℹ

参见文档：📖

参考页面：📄

操作步骤：1, 2, 3

执行结果：➡

图中的图标

部件号：1、2、3 ...

操作步骤：1, 2, 3

视图：A、B、C ...

设备上的图标

安全指南：⚠ → 📖


遵守相关《操作手册》中的安全指南。

图例说明




- 安装图示、防爆区域划分图和电气连接图均采用简化格式
- 设备、安装支架、部件和外形尺寸示意图均采用简洁线条格式
- 外形尺寸示意图并非按比例绘制；图中标注尺寸精确到小数点后两位

缩写含义说明

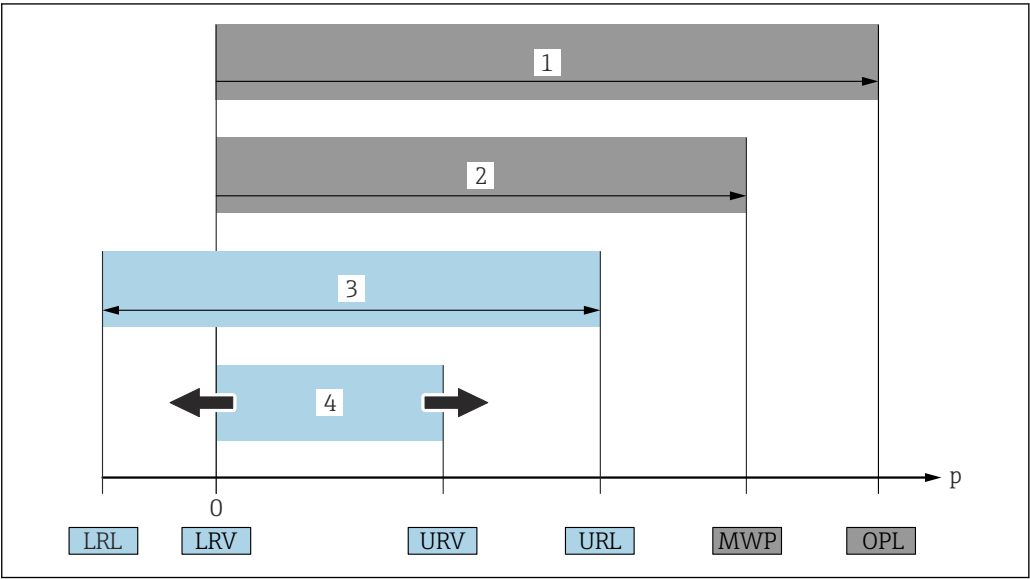

- 1 OPL: 仪表的过压限定值 (OPL, 即传感器过压限定值) 取决于承压能力最弱的部件; 因此除了传感器之外, 还必须考虑过程连接的承压能力。请注意压力-温度关系。OPL (过压限定值) 为测试压力。
- 2 MWP: 传感器的最大工作压力 (MWP) 取决于承压能力最弱的部件; 因此除了传感器之外, 还必须考虑过程连接的承压能力。请注意压力-温度关系。仪表可以持续承受 MWP。铭牌上标识有最大工作压力。
- 3 最大测量范围对应 LRL 和 URL 之间的范围, 即最大标定量程/最大调节量程。
- 4 标定量程/可调量程对应 LRV 和 URV 之间的范围。出厂设置: 0 至 URL。其他标定量程可以作为用户自定义量程订购。
- p 压力
- LRL 测量范围下限
- URL 测量范围上限
- LRV 量程下限
- URV 量程上限
- TD 量程比示例 - 参见以下章节。

量程比计算

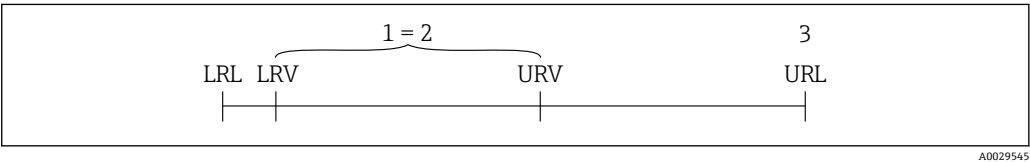

- 1 标定量程/调节量程
- 2 基于零点设定的量程
- 3 测量范围上限

实例:


- 传感器: 16 bar (240 psi)
- 测量范围上限 (URL) : 16 bar (240 psi)
- 标定量程/调节量程: 0 ... 8 bar (0 ... 120 psi)
- 量程下限值 (LRV) : 0 bar (0 psi)
- 量程上限值 (URV) : 8 bar (120 psi)

$$TD = \frac{URL}{|URV - LRV|}$$

因此在本例中, 量程比 (TD) 为 2:1。量程基于零点设定。

功能与系统设计


设备结构

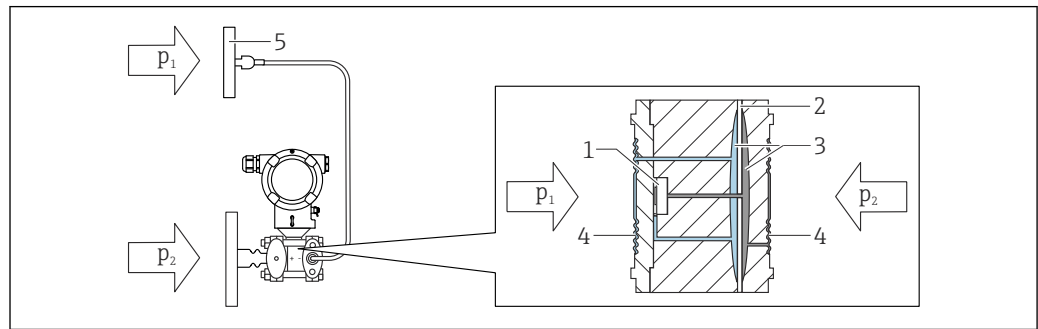

A0043081

图 1 可选二次侧毛细管 (P1)

- 1 测量部件
- 2 中间膜片
- 3 填充液
- 4 内置膜片
- 5 隔膜密封系统的膜片
- p_1 压力 1
- p_2 压力 2

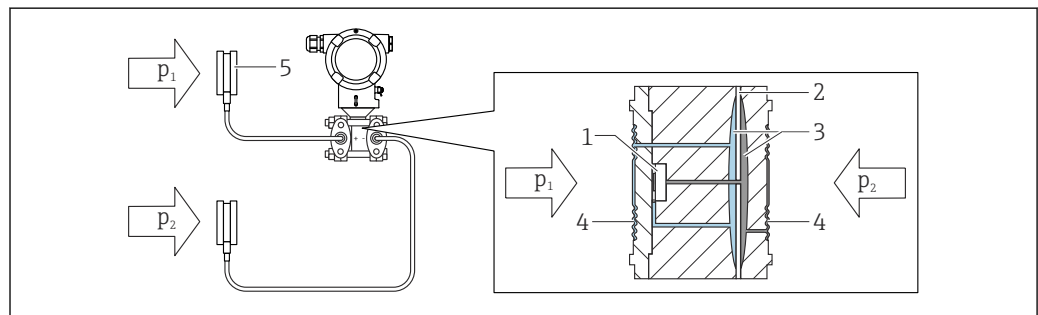

A0043082

- 1 测量部件
- 2 中间膜片
- 3 填充液
- 4 内置膜片
- 5 隔膜密封系统的膜片
- p_1 压力 1
- p_2 压力 2

不可压缩填充液将过程压力从隔膜密封系统的膜片传输至传感器的内置膜片，导致两侧的膜片发生形变。第二路填充液将压力传输至惠斯顿电阻桥路（半导体技术）上。测量与差压变化相关的桥路输出电压，并进行后续计算处理。


隔膜密封系统适用场合

如果仪表需要与工艺过程分离安装时，使用隔膜密封系统。隔膜密封系统特别适合下列应用场合：

- 极端工况（使用温度隔离器或毛细管）
- 强振动工况（使用毛细管实现过程与仪表的分离）
- 测量腐蚀性介质（使用高耐久度膜片材质）
- 测量结晶介质或含固介质（选用合适的涂层）
- 测量异质介质和纤维介质
- 有严格清洗要求的测量点，或安装位置十分潮湿
- 安装位置操作困难

测量系统

仪表类型

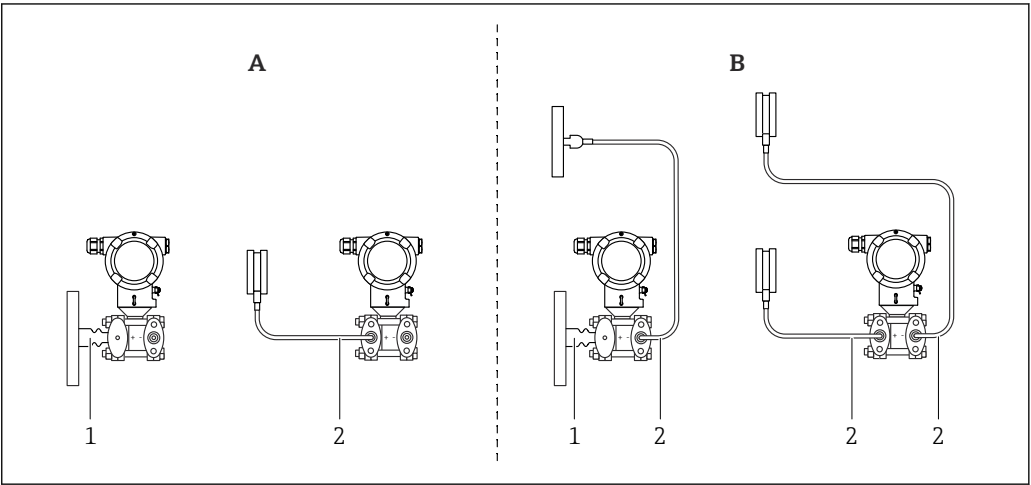


A0043595

- A 带单侧隔膜密封系统的仪表
1 高压侧温度隔离器
2 高压侧毛细管
B 带双侧隔膜密封系统的仪表
1 高压侧温度隔离器和低压侧毛细管
2 高压侧毛细管和低压侧毛细管

液位测量（体积和质量）：


带双侧温度隔离器隔膜密封系统的仪表

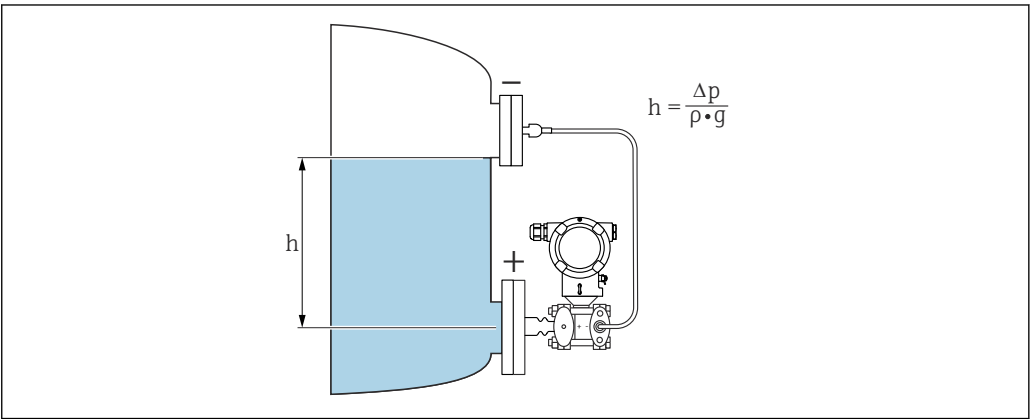

A0038339

- h 高度（液位）
 Δp 差压测量
 ρ 介质密度
 g 重力加速度

带双侧毛细管隔膜密封系统的仪表

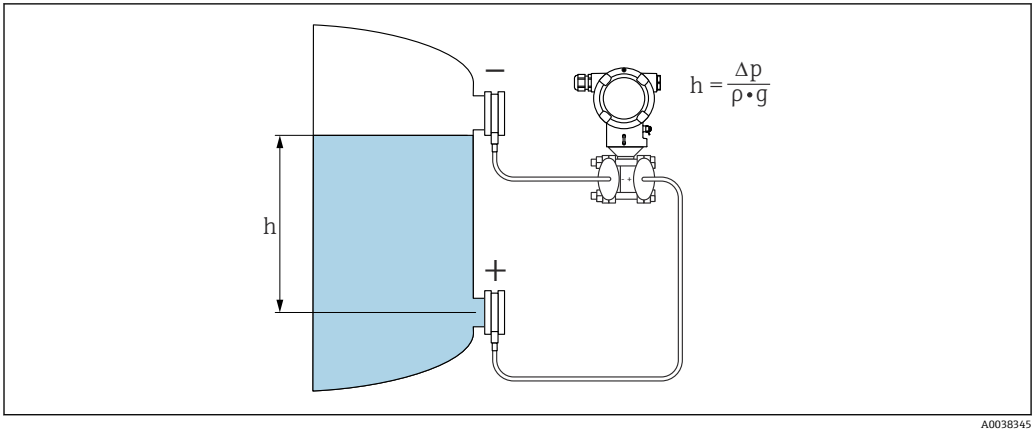

h 高度 (液位)
 Δp 差压测量
 ρ 介质密度
g 重力加速度

优势:

- 借助可任意设置的特征曲线，支持在任意形状的罐体中进行体积和质量测量
- 应用广泛，例如：
 - 超压罐中的液位测量
 - 测量起泡介质
 - 安装在配备搅拌器或筛管装置的罐体中使用
 - 测量液态气体介质
 - 标准液位测量

通信和数据处理

- 4...20 mA HART 通信 (选配)
- Bluetooth 蓝牙 (选配)
- PROFIBUS PA (选配)
- PROFINET + Ethernet-APL (选配) : 10BASE-T1L 通信

HART、Bluetooth 蓝牙、PROFINET + Ethernet-APL、PROFIBUS PA 通信型仪表的可靠性

IT 安全

Endress+Hauser 只对按照《操作手册》进行安装和使用的仪表提供质保。仪表自带安装保护功能，防止意外更改设置。IT 安全措施为仪表及仪表传输数据提供额外安全保护，必须操作员亲自遵照安全标准操作。

输入

测量变量	过程变量测量值
	差压测量

测量范围 取决于设备配置，最大工作压力（MWP）和过压限定值（OPL）与表中测定值存在偏差。

PN 160 / 16 MPa / 2400 psi

量程档	最大测量范围		最小标定量程（工厂预设置） ^{1) 2)}
	下限（LRL）	上限（URL）	
[mbar (psi)]	[mbar (psi)]	[mbar (psi)]	[mbar (psi)]
100 (1.5)	-100 (-1.5)	+100 (+1.5)	5 (0.075)
500 (7.5)	-500 (-7.5)	+500 (+7.5)	5 (0.075)
3000 (45)	-3000 (-45)	+3000 (+45)	30 (0.45)
16000 (240)	-16000 (-240)	+16000 (+240)	160 (2.4)
40000 (600)	-40000 (-600)	+40000 (+600)	400 (6)

1) 量程比大于 100:1: 特殊选型订购或在仪表上设置

2) 铂金型最大量程比: 5:1。

PN 160 / 16 MPa / 2400 psi

量程档	最大工作压力 MWP ¹⁾	过压限定值（OPL）		爆破压力 ^{2) 3)}
		单侧	双侧	
[mbar (psi)]	[bar (psi)]	[bar (psi)]	[bar (psi)]	[bar (psi)]
100 (1.5)	160 (2400)	160 (2400)	240 (3600)	690 (10005)
500 (7.5)	160 (2400)	160 (2400)	240 (3600)	690 (10005)
3000 (45)	160 (2400)	160 (2400)	240 (3600)	690 (10005)
16000 (240)	160 (2400)	160 (2400)	240 (3600)	690 (10005)
40000 (600)	160 (2400) ⁴⁾	正压侧: 160 (2400) 负压侧: 100 (1500)	240 (3600)	690 (10005)

1) MWP 值取决于过程连接。

2) 适用于 FKM、PTFE、FFKM、EPDM 材质的密封圈，以及两侧施加压力。

3) 如果选配侧面排气排液阀（sv）和 PTFE 密封圈，爆破压力为 600 bar (8 700 psi)

4) 仅在负压侧加压，MWP 为 100 bar (1 500 psi)。

最小静压力

- 最小静压力: 50 mbar (0.75 psi)_{abs}
注意填充液的允许压力和温度范围
- 注意填充液的允许压力和温度范围
- 真空应用场合: 遵守安装指南

输出

输出信号	电流输出 4...20 mA HART 数字量信号，两线制 提供三种不同的电流输出模式： ■ 4.0...20.5 mA ■ NAMUR NE 43: 3.8...20.5 mA（出厂设置） ■ US 模式: 3.9...20.8 mA 具有 Ethernet-APL 功能的 PROFINET 10BASE-T1L, 两线制, 10 Mbit PROFIBUS PA 符合 EN 50170 Volume 2、IEC 61158-2 标准 信号编码: 曼彻斯特总线电力传输 (MBP), 1 类 数据传输速率: 31.25 kBit/s, 电压模式 电气隔离: 是
报警信号	■ 4...20 mA HART: 选项: ■ 最大报警电流: 可以在 21.5...23 mA 之间设置 ■ 最小报警电流: < 3.6 mA（出厂设置） ■ 报警信号符合 NAMUR NE 43 标准。 ■ PROFINET + Ethernet-APL: ■ 符合“分布式外设的应用层协议”, 2.4 版 ■ 诊断符合 PROFINET PA Profile 4.02 规范 ■ PROFIBUS PA ■ 诊断符合 PROFIBUS PA Profile 3.02 标准 ■ 状态信号（符合 NAMUR NE 107 标准）纯文本显示
负载	4...20 mA HART 1 10.5 ... 30 V DC 电源 (Ex i 本安防爆) 2 10.5 ... 35 V DC 电源, 用于其他防爆型式的仪表以及非防爆仪表 3 最大负载阻抗 $R_{L,max}$ U_B 供电电压

 通过手操器或安装有调试软件的个人计算机操作：注意安装阻值不低于 250 Ω 的通信电阻。

阻尼时间	所有输出均受阻尼时间的影响（输出信号、显示单元）。阻尼时间的启用方式如下： - 通过现场显示单元、Bluetooth 蓝牙、手操器或安装有调试工具的个人计算机，在 0...999 秒之间连续设置 - 出厂设置：1 s
防爆连接参数	参见单独成册的《安全指南》（XA）文档： www.endress.com/download 。
线性化功能	仪表的线性化功能能够将测量值转换成高度或体积单位的数值。如需要，用户自定义线性化表中最多可以输入 32 对参数值。

通信协议规范

HART

- 制造商 ID: 17 (0x11{hex})
- 设备类型 ID: 0x1131
- 设备修订版本号: 1
- HART 版本号: 7
- DD 文件修订版本号: 1
- 设备描述文件 (DTM、DD) 信息和文件登陆以下网址查询：
 - www.endress.com
 - www.fieldcommgroup.org
- HART 负载: 最小 250 Ω

HART 设备参数（出厂预设）

出厂时，设备参数的测量值分配如下：

设备参数	测量值
PV 值 ¹⁾	压力 ²⁾
SV 值	传感器温度
TV 值	电子模块温度
QV 值	传感器压力 ³⁾

- 1) PV 值始终分配给电流输出。
- 2) 压力为进行阻尼时间处理和位置调整后的计算信号。
- 3) 传感器压力为进行阻尼时间处理和位置调整前的原始测量单元信号。

HART 设备变量选择

- 压力 选项（在执行位置校正和加入阻尼时间之后）
- 规模变量
- 传感器温度
- 传感器压力
Sensor Pressure is the raw signal from sensor before damping and position adjustment.
- 电子模块温度
- 端子电流
The terminal current is the read-back current on terminal block.
- 端子电压 1
显示与否却决于仪表选型和设置。
- Noise of pressure signal 选项和 Median of pressure signal 选项
仅订购心跳技术时才会显示此选项
- 量程百分比
- 回路电流
The loop current is the output current set by the applied pressure.

支持的功能

- Burst 模式
- 其他变送器状态
- 设备锁定

PROFINET + Ethernet-APL

协议	“外围分布设备和分布式自动化系统的应用层协议” (2.4 版)
通信类型	以太网高级物理层 10BASE-T1L
一致性等级	一致性等级 B
网络负载等级	II 级网络负载
波特率	自动 10 Mbit/s, 带全双工检测
周期时间	> 32 ms
极性	TxD 和 RxD 交叉连接线自动极性校正
媒体冗余协议 (MRP)	是
系统冗余支持	S2 系统冗余 (2 个 AR, 1 个 NAP)
设备类型	应用接口标识 0xB310 通用设备
制造商 ID	0x11
设备类型 ID	A231
设备描述文件 (GSD、FDI、DTM、DD)	登陆以下网址查询详细信息和文件: ■ www.endress.com 设备的产品主页: 文档/软件→设备驱动程序 ■ www.profibus.org
支持连接	■ 2 x AR (IO 控制器 AR) ■ 1 x AR (允许连接 IO 监管设备 AR) ■ 1 x 输入 CR (通信关系) ■ 1 x 输出 CR (通信关系) ■ 1 x 报警 CR (通信关系)
设备设置选项	■ 制造商软件 (FieldCare、DeviceCare) ■ 网页浏览器 ■ 设备数据库文件 (GSD), 可以通过测量设备内置网页服务器查看 ■ DIP 开关, 设置服务 IP 地址
设备名称设置	■ DCP 协议 ■ 过程设备管理器 (PDM) ■ 内置网页服务器
支持的功能	■ 标识和维护 通过下列方式简单标识设备: ■ 控制系统 ■ 铭牌 ■ 测量值状态 过程变量与测量值状态通信 ■ 闪烁功能, 通过现场显示简单设备识别和分配 ■ 通过调试软件 (例如 FieldCare、DeviceCare、SIMATIC PDM) 操作设备
系统集成	系统集成的详细信息参见  《操作手册》 ■ 循环数据传输 ■ 块概述和块说明 ■ 状态编码 ■ 启动参数设置 ■ 出厂设置

PROFIBUS PA**制造商 ID:**

17 (0x11)

识别码:

0x1574 或 0x9700

Profile 版本号:

3.02

GSD 文件和版本

登陆以下网址查询详细信息和文件:

- www.endress.com
设备的产品主页: 文档/软件→设备驱动程序
- www.profibus.com

输出参数

模拟量输入:

- 压力
- 规模变量
- 传感器温度
- 传感器压力
- 电子模块温度
- 压力信号中间值 选项 (只有选择“心跳自校验 + 心跳自监测”应用软件包时才会显示)。
- 压力信号噪声 选项 (只有选择“心跳自校验 + 心跳自监测”应用软件包时才会显示)。

数字量输入:

 只有选择“心跳自校验 + 心跳自监测”应用软件包时才会显示

Heartbeat Technology 心跳技术 → SSD: 统计传感器诊断信息

Heartbeat Technology 心跳技术 → 过程窗口

输入值

模拟量输出:

PLC 输出的模拟量 (在显示屏上显示)

支持的功能

- 标识和维护
通过控制系统和铭牌简便标识设备
- 自动适应识别码
通用配置文件 0x9700 “带 1 路模拟量输入的变送器”的 GSD 兼容模式
- 物理层诊断
通过端子电压和监测信息进行 PROFIBUS 段耦合器的安装检查
- PROFIBUS 上传/下载
通过 PROFIBUS 上传/下载, 参数的读取和写入速度最多可以提高 10 倍
- 简明状态
诊断信息清晰分类, 便捷查询故障信息


WirelessHART 通信

- 最小启动电压: 10.5 V
- 启动电流: 3.6 mA
- 启动时间: <5 s
- 最小工作电压: 10.5 V
- Multidrop 电流: 4 mA

电源

接线端子分配

双腔室外壳

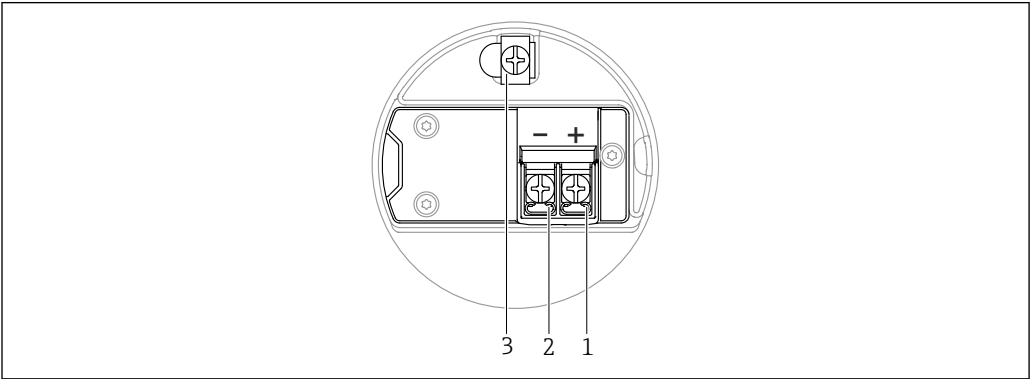


2 接线腔中的接线端子和接地端

- 1 “+”接线端
- 2 “-”接线端
- 3 内部接地端

仪表插头

i 带插头的仪表型号无需打开外壳即可接线。
使用随箱包装中的密封圈，防止水汽进入仪表内部。

带 M12 插头的仪表

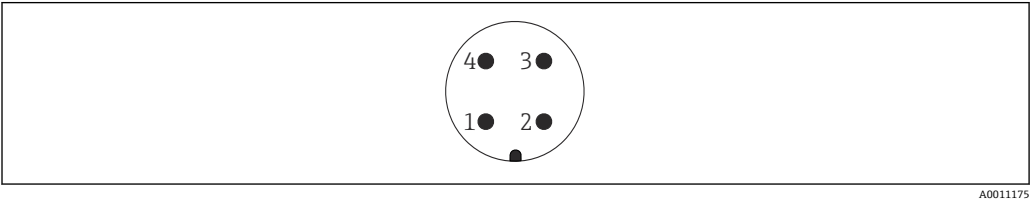

3 仪表上的连接插头

针脚	HART PROFIBUS PA
1	信号+
2	不使用
3	信号-
4	接地

针脚	PROFINET + Ethernet-APL
1	APL 信号-
2	APL 信号+
3	屏蔽层
4	不使用

对于带 M12 插头的仪表，Endress-Hauser 提供下列附件：

M 12x1 插头，直型

- 材质：
主体：PBT；管接螺母：镀镍压铸锌；密封圈：NBR
- 防护等级（锁紧状态）：IP67
- 订货号：52006263


M 12x1 插头，弯型（不适用 PROFINET + Ethernet-APL 通信型设备）

- 材质：
 - 主体：PBT；管接螺母：镀镍压铸锌；密封圈：NBR
- 防护等级（锁紧状态）：IP67
- 订货号：71114212

4x0.34 mm² (20 AWG) 电缆，带 M12 插槽，弯型，螺纹插头，长度为 5 m (16 ft)

- 材质：外壳：TPU；管接螺母：镀镍压铸锌；电缆：PVC
- 防护等级（全密封）：IP67/68
- 订货号：52010285
- 电缆线芯颜色
 - 1 = BN = 棕色
 - 2 = WT = 白色
 - 3 = BU = 蓝色
 - 4 = BK = 黑色

带 Harting Han7D 插头的仪表

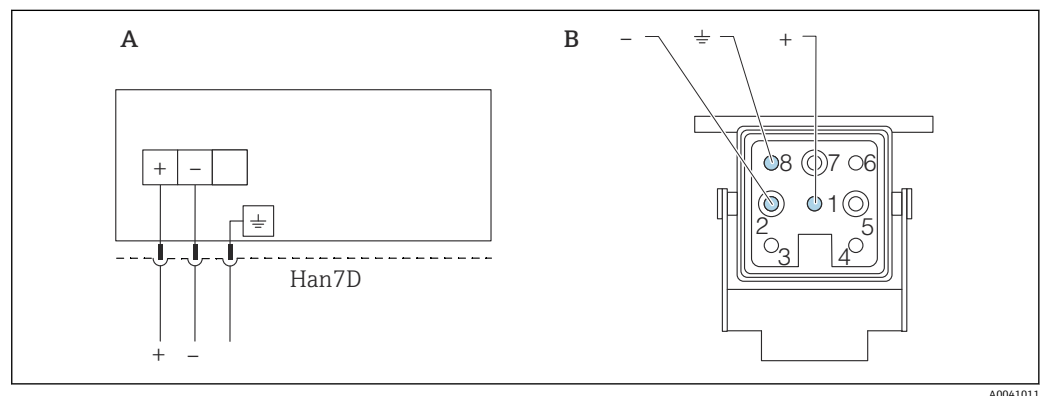

A 带 Harting Han7D 插头的仪表的电气连接

B 仪表上的连接插头

- 棕色

≡ 黄/绿相间

+ 蓝色

材质：镀镍黄铜（CuZn），插座和插头采用镀金触点

供电电压

- 模拟量/HART 通信：Ex d、Ex e 防爆场合、非防爆场合：供电电压 10.5 ... 35 V_{DC}
- 模拟量/HART 通信：Ex i 防爆场合：供电电压 10.5 ... 30 V_{DC}
- HART 通信：标称电流：4...20 mA HART
- PROFINET + Ethernet-APL 通信：APL A 类电源（9.6 ... 15 V_{DC}，540 mW）
- PROFIBUS PA
 - 非防爆场合、Ex d、Ex e 防爆场合：9 ... 32 V_{DC}
 - Ex i（FISCO 理念）：9 ... 17.5 V_{DC}
 - Ex i（整体本安认证）：9 ... 24 V_{DC}
 - 标称电流：14 mA
 - FDE 故障电流（电子模块的故障断开电流）：0 mA

IEC/EN 61010 标准规定需要安装专用断路保护器。

取决于通电时的供电电压：

- 背光显示关闭（供电电压 < 15 V 12 V）
- 蓝牙功能（订购选项）关闭（供电电压 < 12 V 10 V）。

i 模拟量/HART 通信：必须对供电单元进行测试，确保满足安全要求（例如 PELV、SELV、2 类电源）且必须符合相关的协议规范。4...20 mA 通信的要求与 HART 通信相同。

i PROFINET + Ethernet-APL 通信：必须对 APL 现场交换机进行测试，确保满足安全要求（例如 PELV、SELV、2 类电源）且必须符合相关的协议规范。


i PROFIBUS PA:

- 电源只能使用合适且经过认证的 PROFIBUS PA 部件（例如 DP/PA 段耦合器）。
- 基于 FISCO/FNICO 现场总线防爆技术，符合 IEC 60079-27 标准
- 电源不区分极性

电气连接

接线示例

PROFINET + Ethernet-APL

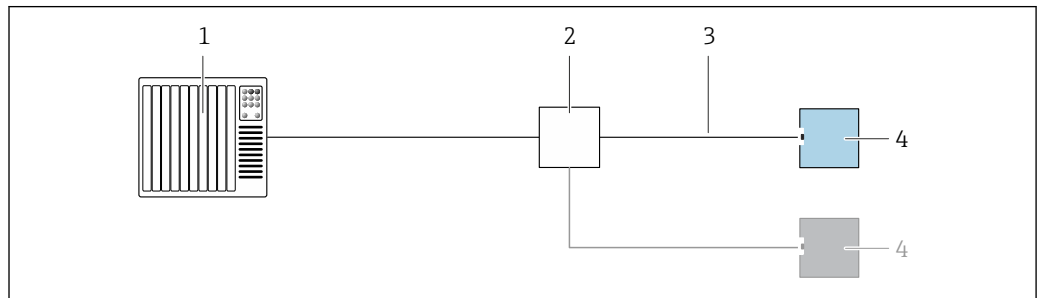


A0045802

图 4 接线示例: PROFINET + Ethernet-APL

- 1 自动化系统
- 2 APL 现场交换机
- 3 注意电缆规格
- 4 变送器

PROFIBUS PA

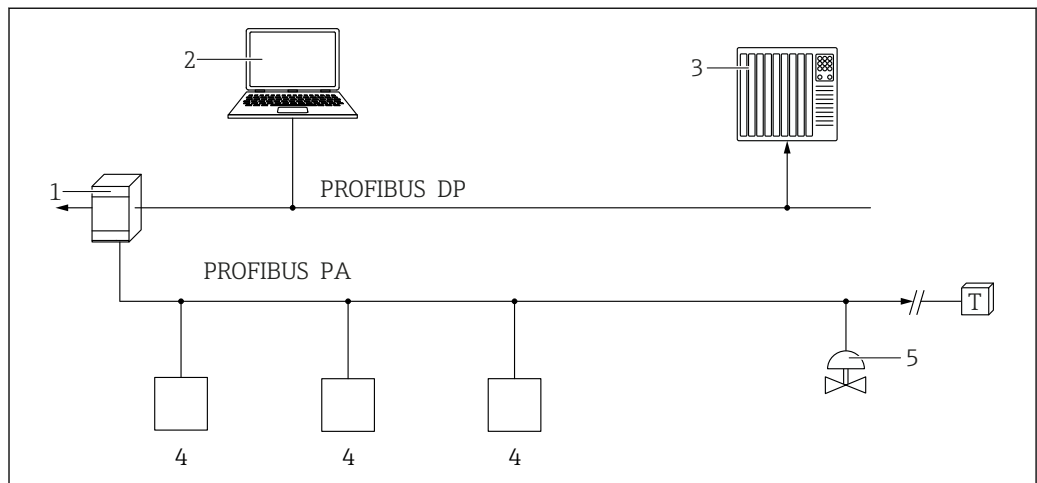

A0050944


- 1 段耦合器
- 2 计算机, 安装有 PROFIusb 和调试软件 (例如 DeviceCare/FieldCare)
- 3 PLC (可编程逻辑控制器)
- 4 变送器
- 5 附加功能部件 (阀等)

等电势连接

i 如需要, 仪表接线前将等电势线连接至变送器的外部接地端。

- i** 为实现最佳电磁兼容性:
- 等电势线应尽可能短。
 - 确保电缆横截面不小于 2.5 mm^2 (14 AWG)。

双腔室外壳

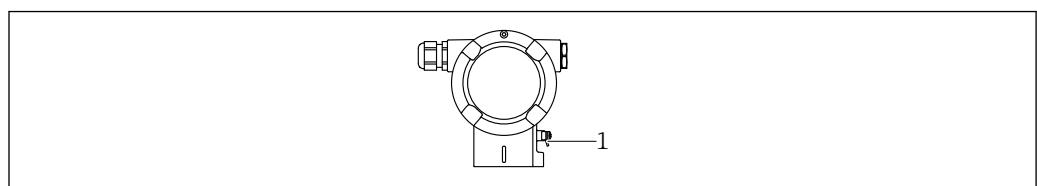

A0045412

- 1 接地端, 连接等电势线

接线端子


- 电源接线端和内部接地端
紧固线芯直径: 0.5 ... 2.5 mm² (20 ... 14 AWG)
- 外部接地端
紧固线芯直径: 0.5 ... 4 mm² (20 ... 12 AWG)

电缆入口

电缆入口类型与仪表型号相关。

-  连接电缆必须向下铺设，确保水汽不会进入接线腔。
如需要，建立排水回路或使用防护罩。

双腔室外壳

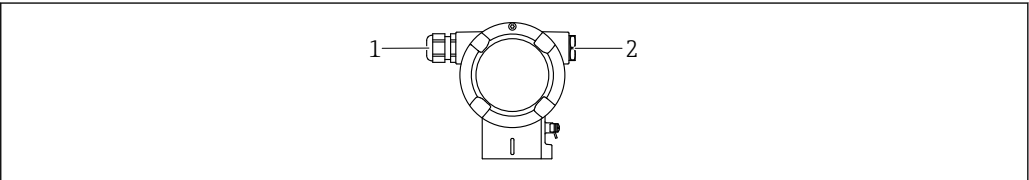

A0045414

- 1 电缆入口
- 2 堵头

电缆规格

- 电缆外径取决于所使用的电缆入口
- 电缆外径
 - 塑料缆塞: Ø5 ... 10 mm (0.2 ... 0.38 in)
 - 镀镍黄铜缆塞: Ø7 ... 10.5 mm (0.28 ... 0.41 in)
 - 不锈钢缆塞: Ø7 ... 12 mm (0.28 ... 0.47 in)
-  PROFIBUS PA: 使用屏蔽双芯双绞电缆，首选 A 类电缆。
电缆规格的详细信息:
 -  《操作手册》BA00034S “PROFIBUS DP/PA 规划和调试指南”
 -  PROFIBUS 安装指南 8.022
 -  IEC 61158-2 (MBP) 。

具有 Ethernet-APL 功能的 PROFINET

APL 层参考电缆类型是 Fieldbus 电缆类型 A、MAU 类型 1 和 3 (IEC 61158-2 中对此进行了规定)。该电缆符合 IEC TS 60079-47 标准对于本安型应用的要求，也可用于非本安型应用。

电缆类型	A
电缆电容	45 ... 200 nF/km
回路电阻	15 ... 150 Ω/km
电缆电感	0.4 ... 1 mH/km

Ethernet-APL 工程指导准则 (<https://www.ethernet-apl.org>) 中提供更多详情。

过电压保护单元

不带选配过电压保护单元的仪表

Endress+Hauser 设备符合 IEC / DIN EN 61326-1 (表 2: 工业环境) 产品标准的要求。
执行 IEC/DIN EN 标准规定的瞬态过电压测试，根据端口类型 (直流电、输入/输出端口) 施加不同的测试电压 (IEC/DIN EN 61000-4-5 浪涌抗扰度测试) :
直流电端口和输入/输出端口的测试电压为 1000 V 线对地

带选配过电压保护单元的仪表

- 击穿电压: 不小于 400 V_{DC}
- 根据 IEC / DIN EN 60079-14 第 12.3 节 (IEC / DIN EN 60060-1 第 7 章) 进行测试
- 标称放电电流: 10 kA

注意

电压过高会损坏仪表。
► 务必将内置过电压保护单元的设备接地。

过电压保护等级

II 级过电压保护

性能参数

响应时间	■ HART: ■ 非循环模式：最小值为 330 ms，典型值为 590 ms（取决于命令号和前导序数） ■ 循环模式（Burst）：最小值为 160 ms，典型值为 350 ms（取决于命令号和前导序数） ■ PROFINET + Ethernet-APL：循环模式：最小值为 32 ms ■ PROFIBUS PA: ■ 非循环模式：约 60...70 ms（取决于从站被主站轮询的最小间隔时间） ■ 循环模式：约 10...13 ms（取决于从站被主站轮询的最小间隔时间）
参考操作条件	■ 符合 IEC 62828-2 标准 ■ 环境温度 T_A 恒定；适用温度范围：+22 ... +28 °C (+72 ... +82 °F) ■ 湿度 ϕ 恒定，湿度范围：5...80 % rF $\pm$ 5 % ■ 环境压力 p_U 恒定，适用压力范围：860 ... 1060 mbar (12.47 ... 15.37 psi) ■ 传感器安装位置：水平方向偏差$\pm$1° ■ 膜片材质：AISI 316L (1.4435) ■ 在 LOW SENSOR TRIM 和 HIGH SENSOR TRIM 参数中，分别输入传感器量程下限值和上限值 ■ 供电电压：24 V DC $\pm$ 3 V DC ■ HART 负载：250 Ω ■ 量程比 TD= URL/ URV - LRV ■ 基于零点设定的量程
总体性能	性能参数即设备的测量精度。影响测量精度的因素可以分为以下两类。 ■ 设备的总体性能 ■ 安装条件 所有性能参数均符合$\pm 3\sigma$ 准则。 设备的总体性能包括参考测量精度和环境温度产生的测量误差，计算公式如下： $\text{总体性能} = \pm \sqrt{(E1)^2 + (E2)^2 + (E3)^2}$ E1 = 参考测量精度 E2 = 环境温度变化产生的测量误差 E3 = 静压力对测量误差的影响 隔膜密封系统的影响（进入 Applicator 仪表选型软件的“Sizing Diaphragm Seal”模块计算） 计算 E2： 环境温度每变化± 28 °C (50 °F)产生的测量误差 (对应温度范围：-3 ... +53 °C (+27 ... +127 °F)) $E2 = E2_M + E2_E$ E2_M = 主要温度误差 E2_E = 电子部件误差 ■ 数值仅适用于采用 316L (1.4435) 膜片的仪表 ■ 以上均为标定量程下的数值。

通过 Endress+Hauser Applicator 仪表选型软件计算整体性能

详细测量误差（例如用于其他温度范围的仪表）均可进入 Applicator 仪表选型软件的“[Sizing Pressure Performance](#)”计算。



A0038927

通过 Endress+Hauser Applicator 仪表选型软件计算隔膜密封系统误差

隔膜密封系统误差未考虑。在 Applicator 仪表选型软件的“[Sizing Diaphragm Seal](#)”模块中单独计算。



A0038925

参考测量精度[E1]

参考测量精度包括采用极限点法测定的非线性度、压力迟滞性和非重复性，符合[IEC62828-1]标准。列举的参考测量精度适用于量程比 TD 不超过 100:1 的标准型仪表。

带单侧温度隔离器隔膜密封系统的仪表

量程档	标准型	铂金型
100 mbar (1.5 psi)	TD 1:1...5:1 = $\pm 0.10\%$ TD > 5:1 = $\pm 0.02\% \cdot TD$	-
500 mbar (7.5 psi)	TD 1:1...15:1 = $\pm 0.075\%$ TD > 15:1 = $\pm (0.0015\% \cdot TD + 0.053\%)$	-
3 bar (45 psi) 16 bar (240 psi) 40 bar (600 psi)	TD 1:1...15:1 = $\pm 0.075\%$ TD > 15:1 = $\pm (0.0015\% \cdot TD + 0.053\%)$	-

带双侧毛细管隔膜密封系统的仪表，或带高压侧温度隔离器和低压侧毛细管隔膜密封系统的仪表

量程档	标准型	铂金型
100 mbar (1.5 psi)	TD 1:1...5:1 = ±0.15 % TD > 5:1 = ±0.03 % · TD	-
500 mbar (7.5 psi)	TD 1:1...5:1 = ±0.15 % TD > 5:1 = ±0.03 % · TD	-
3 bar (45 psi) 16 bar (240 psi) 40 bar (600 psi)	TD 1:1...15:1 = ±0.1 % TD > 15:1 = ±(0.006 % · TD + 0.01 %)	-

温度变化产生的测量误差[E2]**E2_M: 主要温度误差**

由于环境温度[IEC 62828-1]相对于参考温度[IEC 62828-1]的影响，输出发生变化。环境温度引起的测量误差[IEC62828-1 / IEC61298-3]定义为最低或最高环境或过程温度条件下的最大误差值。

100 mbar (1.5 psi)量程档

$\pm(0.07 \% \cdot TD + 0.07 \%)$

500 mbar (7.5 psi)量程档

$\pm(0.03 \% \cdot TD + 0.017 \%)$

3 bar (45 psi)、16 bar (240 psi)和 40 bar (600 psi)量程档

$\pm(0.012 \% \cdot TD + 0.017 \%)$

E2_E: 电子部件误差

- 4...20 mA: 0.05 %
- 数字量输出 (HART) : 0 %
- 数字量输出 (PROFINET) : 0 %
- 数字量输出 (PROFIBUS PA) : 0%

E3_M: 主要静压力误差

静压对测量误差的影响，即过程静压力变化对输出的影响（在不同静压下与大气压输出的差值[IEC 62828-2 / IEC 61298-3]，包含零点与满量程时工作压力影响）。

100 mbar (1.5 psi)量程档

标准型

- 对零点的影响: $\pm 0.203 \% \cdot TD / 70 \text{ bar (1050 psi)}$
- 对满量程的影响: $\pm 0.15 \% / 70 \text{ bar (1050 psi)}$

500 mbar (7.5 psi)量程档

标准型

- 对零点的影响: $\pm 0.07 \% \cdot TD / 70 \text{ bar (1050 psi)}$
- 对满量程的影响: $\pm 0.10 \% / 70 \text{ bar (1050 psi)}$

3 bar (45 psi)量程档

标准型

- 对零点的影响: $\pm 0.049 \% \cdot TD / 70 \text{ bar (1050 psi)}$
- 对满量程的影响: $\pm 0.05 \% / 70 \text{ bar (1050 psi)}$

16 bar (240 psi)和 40 bar (600 psi)量程档

标准型

- 对零点的影响: $\pm 0.049 \% \cdot TD / 70 \text{ bar (1050 psi)}$
- 对满量程的影响: $\pm 0.02 \% / 70 \text{ bar (1050 psi)}$

分辨率

电流输出: $<1 \mu\text{A}$

总体误差

仪表的总体误差包括总体性能和长期稳定性影响，计算公式如下：

总体误差 = 总体性能 + 长期稳定性

使用 Endress+Hauser Applicator 仪表选型软件计算总体误差

使用 Applicator 仪表选型软件的“[Sizing Pressure Performance](#)”模块计算具体测量误差（例如其他温度范围内的误差）。



A0038927

通过 Endress+Hauser Applicator 仪表选型软件计算隔膜密封系统误差

隔膜密封系统误差未考虑。在 Applicator 仪表选型软件的“[Sizing Diaphragm Seal](#)”模块中单独计算。



A0038925

长期稳定性

100 mbar (1.5 psi) 测量单元


- 1 年: $\pm 0.08 \%$
- 5 年: $\pm 0.12 \%$
- 10 年: $\pm 0.20 \%$
- 15 年: $\pm 0.28 \%$

500 mbar (7.5 psi)、3 bar (45 psi)、16 bar (240 psi) 和 40 bar (600 psi) 测量单元

- 1 年: $\pm 0.025 \%$
- 5 年: $\pm 0.05 \%$
- 10 年: $\pm 0.10 \%$
- 15 年: $\pm 0.15 \%$

响应时间 (T63 和 T90)**迟滞时间和时间常数**

迟滞时间和时间常数示意图，符合 IEC62828-1 标准：

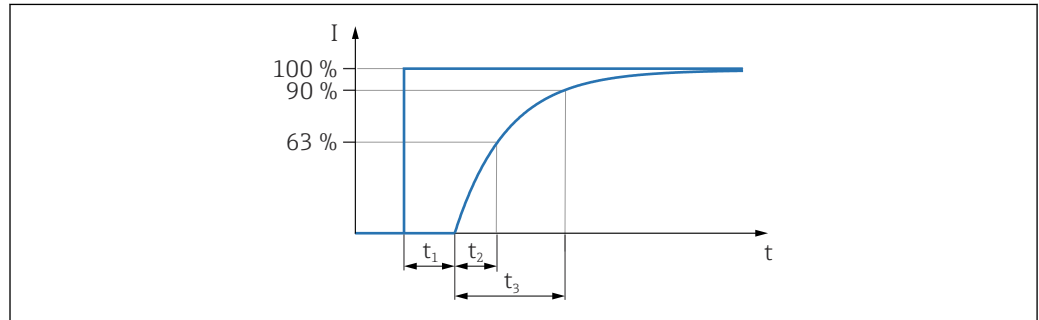

阶跃响应时间 = 迟滞时间 (t_1) + 时间常数 T90 (t_3) (符合 IEC62828-1 标准)

动态响应：电流输出

取决于隔膜密封系统。使用 **Applicator** 选型软件进行计算。

“宽温变送器”隔膜密封适用于高过程温度 and 低环境温度的极端工况。通过使用两种不同的填充液（主腔室中的填充液应对高过程温度，第二腔室中的填充液应对环境温度），仪表的应用范围得以扩大。


订购信息：Configurator 产品选型软件中的订购选项“应用软件包”，选型代号“宽温变送器”

预热时间

符合 IEC 62828-4 标准：≤5 s

安装

安装方向 带单侧或双侧隔热管隔膜密封系统的仪表

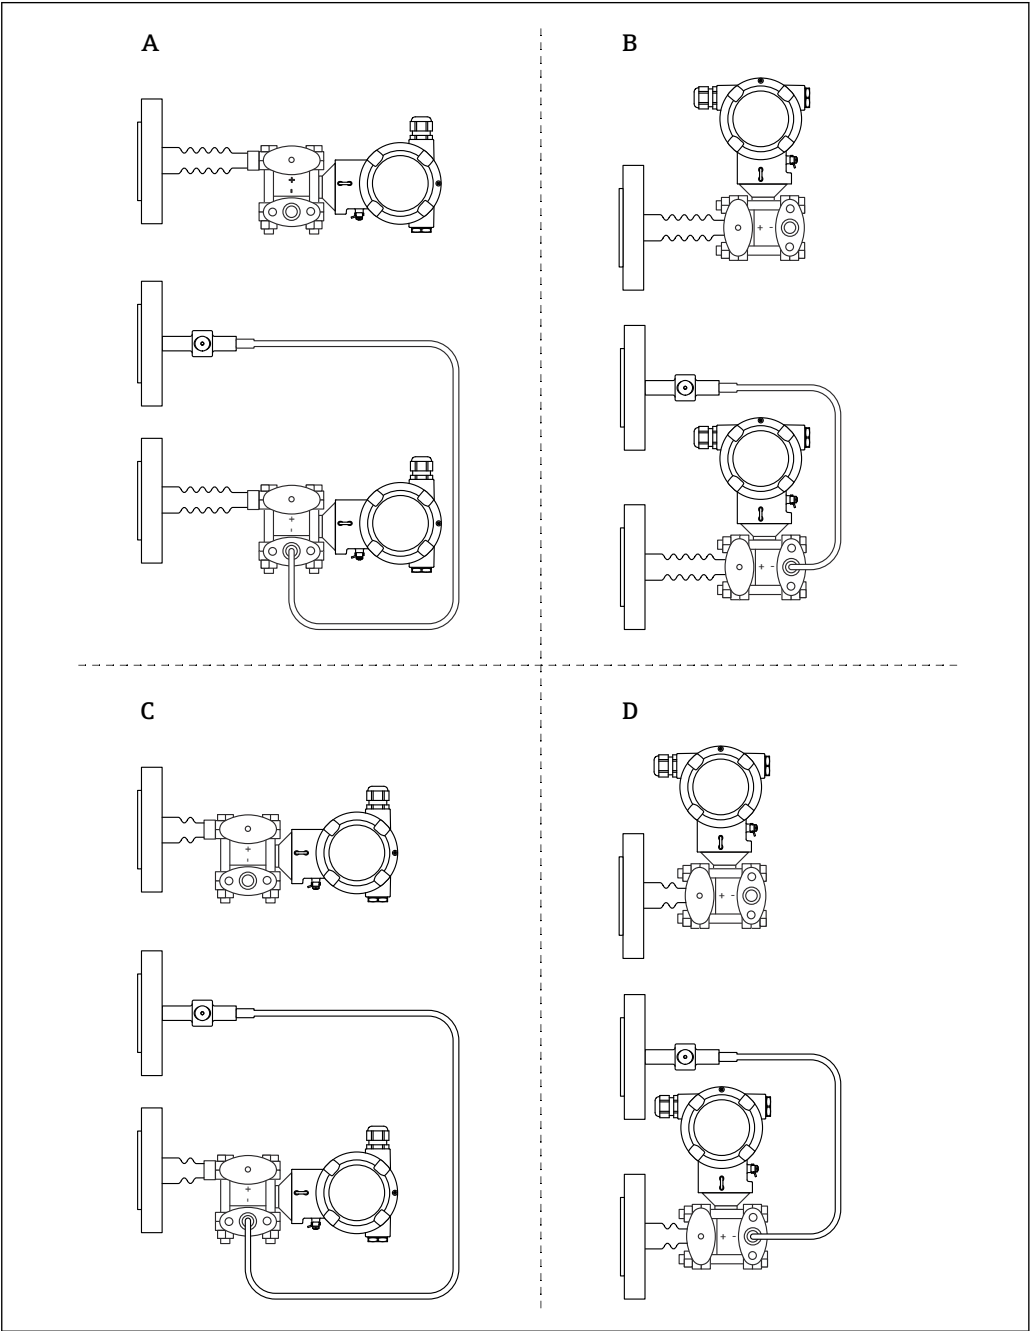


A0038658

- A 变送器水平安装，带长温度隔离器（高压侧）
- B 变送器垂直安装，带长温度隔离器（高压侧）
- C 变送器水平安装，带短温度隔离器（高压侧）
- D 变送器垂直安装，带短温度隔离器（高压侧）

带单侧或双侧毛细管隔膜密封系统的仪表

在真空应用场合中，压力变送器安装在下部隔膜密封系统下方。

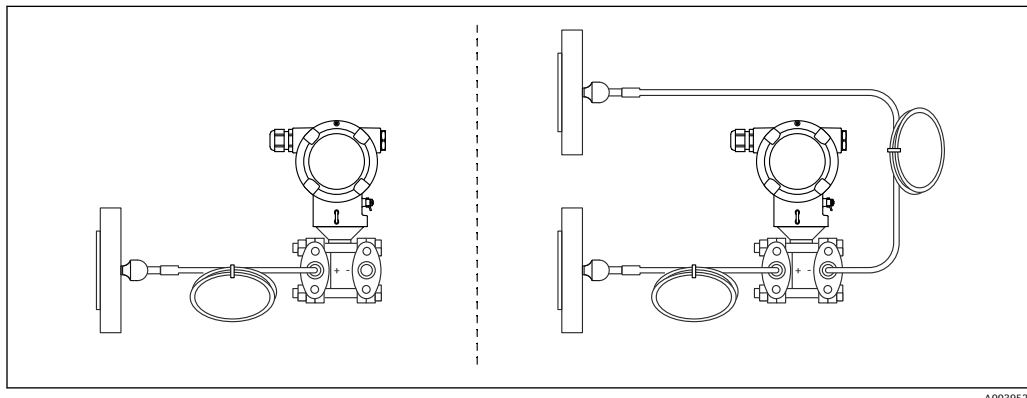

A0039528



如需进行安装检查，参见“[Sizing Diaphragm Seal](#)”模块。

订购选项：

- ...m 毛细管，316L，带标准护套
- ...m 毛细管，316L，带 PVC 涂层护套
- ...m 毛细管，316L，带 PTFE 护套
- ...ft 毛细管，316L，带标准护套
- ...ft 毛细管，316L，带 PVC 涂层护套
- ...ft 毛细管，316L，带 PTFE 护套

隔膜密封型仪表的安装说明

概述

隔膜密封系统与压力变送器共同组成封闭的已标定系统，通过隔膜密封系统和变送器测量系统中的充注口充注填充液。充注口已经密封，禁止打开。

对于带隔膜密封系统和毛细管的仪表，选择传感器时必须注意毛细管内部的填充液柱静压力引起的零点漂移。如需要，执行零点校正。如果选择小量程档传感器，零位调整会导致标称传感器超量程（零位调整的目的在于修正填充液柱方向引起的零点漂移）。

安装时，建议使用合适的固定装置（安装架）固定带毛细管的仪表。

安装期间，确保采取充分的应力消除措施，以防毛细管弯曲（毛细管的弯曲半径 $\geq 100 \text{ mm}$ (3.94 in)）。

安装毛细管，确保无振动影响（避免产生额外的压力波动）。


禁止在加热或冷却管道附近安装毛细管，同时采取遮阳保护措施。

详细安装说明参见 **Applicator** 仪表选型软件的“[Sizing Diaphragm Seal](#)”模块。

真空应用

在真空应用场合中，压力变送器安装在隔膜密封系统下方。防止毛细管中的填充液导致隔膜密封系统出现附加真空负载。

压力变送器安装在隔膜密封系统上方时，禁止超出最大高度差 h_1 。最大高度差 h_1 参见 **Applicator** 仪表选型软件的“[Sizing Diaphragm Seal](#)”模块。

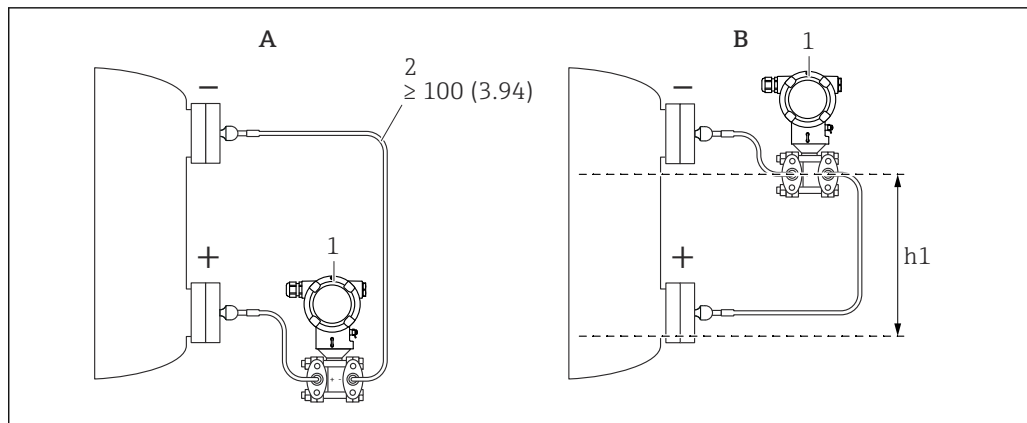

A0038720

测量单位 mm (in)

A 真空应用场合中的推荐安装位置

B 安装在下部隔膜密封系统上方

h1 高度差 (参见 Applicator 仪表选型软件的“Sizing Diaphragm Seal”模块)

1 仪表

2 弯曲半径 ≥ 100 mm (3.94 in)。确保消除外力影响, 防止毛细管出现弯曲。

最大高度差取决于填充液的密度和隔膜密封系统正压侧 (空罐) 的最小允许绝压。

清洗指南

Endress+Hauser 提供冲洗环 (作为附件订购), 无需从过程中取出变送器即可清洗膜片。



详细信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。

传感器选择和布置

液位测量

敞开式罐体中的液位测量: 使用带单侧温度隔离器隔膜密封系统的仪表

- 仪表直连安装至罐体
- 负压侧作为大气压参考端

密闭式罐体中的液位测量: 使用带单侧温度隔离器隔膜密封系统的仪表

- 仪表直连安装至罐体
- 通过引压管连接负压侧, 负压侧连接点始终高于最高液位

密闭式罐体中的液位测量: 使用带单侧或双侧毛细管隔膜密封系统的仪表

仪表安装在下部隔膜密封系统下方

下部隔膜密封系统顶端与上部隔膜密封系统底端之间的区域才能保证可靠测量液位。

含蒸汽的密封式罐体中的液位测量: 使用带单侧温度隔离器隔膜密封系统的仪表

- 仪表直连安装至罐体
- 通过引压管连接负压侧, 负压侧连接点始终高于最高液位
- 疏水阀确保负压侧压力恒定
- 测量含固介质时 (例如脏污液体), 安装分离器和排放阀有助于去除固体沉积物


差压测量

气体、蒸汽和液体的差压测量: 使用带单侧或双侧毛细管隔膜密封系统的仪表

- 毛细管隔膜密封系统安装在管道顶部或侧面
- 在真空应用场合中, 仪表安装在测量点下方

分离型外壳的安装架

分离型外壳通过安装架安装在墙壁或管道上 (适用管径 1 ¼"...2")。

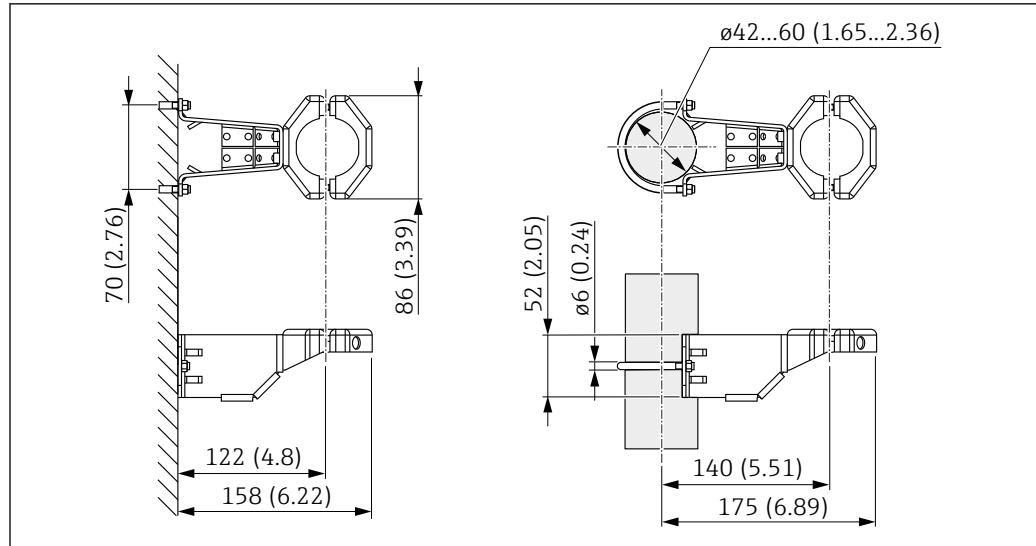

A0028493

测量单位 mm (in)

订购信息:


可以作为附件单独订购, 订货号: 71102216



如果分离型外壳随仪表一同订购, 随箱包装中提供安装架。

墙装和管装

Endress+Hauser 提供设备专用管装架和墙装架:

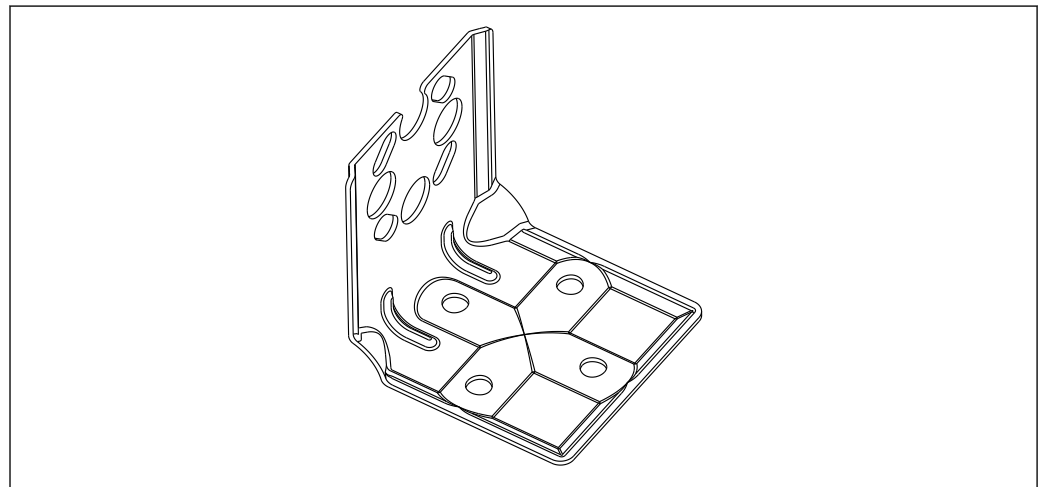

A0031326

- 墙装架和管装架 (包含管装安装架和两个螺母)
- 设备固定螺丝的材质取决于订购选项。



技术参数 (例如材质、外形尺寸或订货号) 参见《特殊文档》SD01553P。

特殊安装指南

分体式传感器 (分离型外壳)

仪表外壳 (包括电子插件) 与测量点分开安装。


这样仪表可以在下列工况下实现可靠测量:

- 在特别困难的测量条件下 (测量点安装空间狭小或操作困难)
- 测量点在强振动工况下工作时

电缆类型:

- PE 电缆: 2 m (6.6 ft)、5 m (16 ft) 和 10 m (33 ft) 长度
- FEP 电缆: 5 m (16 ft) 长度

传感器出厂前已预安装过程连接和电缆。仪表外壳（包括电子插件）与安装架分开包装。电缆两端均配备插座，用于连接仪表外壳（包括电子插件）和传感器。

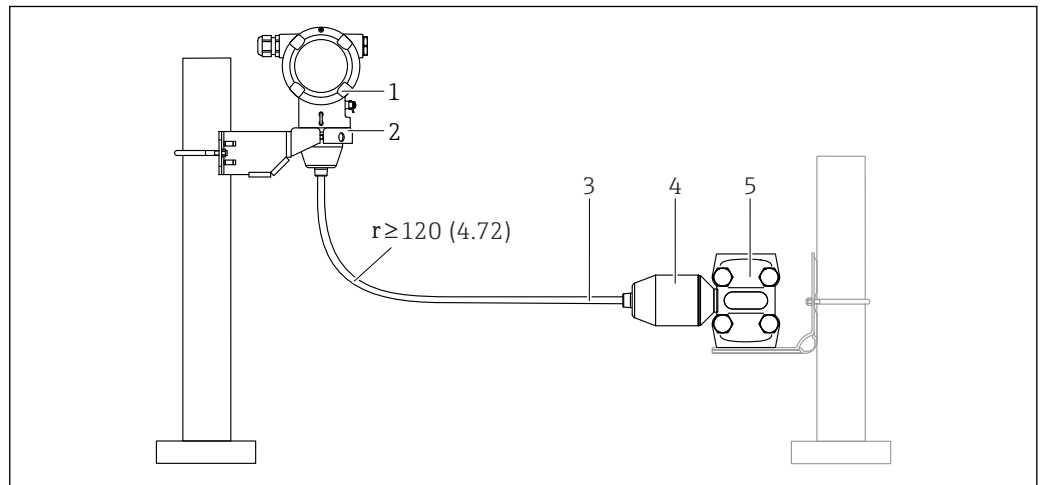

- 1 分体式传感器（包括电子插件）
- 2 随箱包装中的安装架，适用墙装或管装
- 3 电缆，两端均配备插座
- 4 过程转接头
- 5 过程连接和传感器

订购信息:

- 可通过 **Configurator** 产品选型软件订购分体式传感器（包括电子插件）和安装架
- 安装架可以作为附件单独订购，订货号：71102216

电缆规格参数:

- 最小弯曲半径: 120 mm (4.72 in)
- 电缆拉伸力: 最大 450 N (101.16 lbf)
- 抗 UV 紫外线

在防爆危险区中使用:

- 安装在本安防爆场合中 (Ex ia/IS)
- FM/CSA IS: 仅允许安装在 Div. 1 防爆场合中

降低安装高度

相比于标准型仪表，此类“分体型”仪表的过程连接的安装高度会降低。外形尺寸请参考“机械结构”章节。

环境条件

环境温度范围	以下列举的参数适用于过程温度不超过+85 °C (+185 °F)的数值。在更高过程温度下，允许环境温度范围会受到限制。 ■ 无段码显示屏和图形显示屏： ■ 标准温度范围：-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F) ■ 可选温度范围：-50 ... +85 °C (-58 ... +185 °F)，使用寿命缩短，性能降低 ■ 可选温度范围：-54 ... +85 °C (-65 ... +185 °F)；仪表在温度低于-50 °C (-58 °F)时受损 ■ 带段码显示屏或图形显示屏：-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)，显示单元可能无法正常工作，例如显示速度和显示对比度受影响。在-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)环境温度范围内，显示单元正常工作 ■ 段码显示屏：最高-50 ... +85 °C (-58 ... +185 °F)，使用寿命缩短，性能降低 ■ 带 PVC 涂层毛细管护套的仪表：-25 ... +80 °C (-13 ... +176 °F) ■ 带分离型外壳：-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F) 高温工况：使用带单侧温度隔离器隔膜密封系统的仪表，或带单侧或双侧毛细管隔膜密封系统的仪表。请使用安装架！ 振动工况：使用带毛细管的仪表。 防爆危险区 ■ 在防爆危险区中使用的设备时，参见《安全指南》和《安装或控制图示》 ■ 在-54 ... +85 °C (-65 ... +185 °F)环境温度范围内，防爆仪表（例如 ATEX/ IEC Ex 等认证）可以在爆炸性环境中工作（更低温度通过特殊选型订购）。Ex ia 防爆仪表要求环境温度不低于-50 °C (-58 °F)（更低温度通过特殊选型订购）。Ex d 防爆仪表在温度≤-50 °C (-58 °F)下工作，通过外壳保证仪表的防爆性能。无法完全保证变送器性能，也无法完全保证 Ex ia 的防爆等级。
储存温度	■ 无设备显示单元： ■ 标准：-40 ... +90 °C (-40 ... +194 °F) ■ 可选温度范围：-50 ... +90 °C (-58 ... +194 °F)，使用寿命缩短，性能降低 ■ 可选温度范围：-54 ... +90 °C (-65 ... +194 °F)；Ex d 防爆仪表在温度低于-50 °C (-58 °F)时受损 ■ 带设备显示单元：-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F) ■ 带分离型外壳：-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) 带 M12 插头，弯型：-25 ... +85 °C (-13 ... +185 °F) 带 PVC 涂层毛细管护套的仪表：-25 ... +90 °C (-13 ... +194 °F)
海拔高度	不超过海平面之上 5 000 m (16 404 ft)
气候等级	4K26 级（空气温度：-20 ... +50 °C (-4 ... +122 °F)，相对湿度：4...100 %），符合 IEC/EN 60721-3-4 标准。 允许冷凝。
工作环境	在强腐蚀性环境中工作 在腐蚀性环境中（例如海洋环境或沿海地区），Endress+Hauser 建议使用带 PVC 或 PTFE 护套的毛细管和不锈钢外壳。特殊涂层能够为变送器提供额外保护（TSP 特殊选型）。
防护等级	遵循 IEC 60529 和 NEMA 250-2014 标准测试。 外壳和过程连接 IP66/68 TYPE 4X/6P （IP68 测试条件：1.83 米水柱，持续 24 小时） 电缆入口 ■ M20 缆塞，塑料，IP66/68 Type 4X/6P ■ M20 缆塞，镀镍黄铜，IP66/68 Type 4X/6P ■ M20 缆塞，316L，IP66/68 Type 4X/6P ■ M20 螺纹，IP66/68 Type 4X/6P

- G1/2 螺纹, IP66/68 Type 4X/6P
如果选择 G1/2 螺纹接头, 设备出厂时标配 M20 螺纹接头, 随箱包装中提供 G1/2 螺纹转接头及配套文档资料
- NPT1/2 螺纹, IP66/68 Type 4X/6P
- 运输防护堵头: IP22 TYPE 2
- HAN7D 直角插头, IP65 NEMA Type 4X
- M12 插头
外壳关闭且连接连接电缆: IP66/67 NEMA 4X
外壳打开或未连接连接电缆: IP20 NEMA 1

注意**M12 插头和 HAN7D 插头: 安装不当将无法保证 IP 防护等级!**

- ▶ 插入并拧紧连接电缆, 才能确保仪表的 IP 防护等级。
- ▶ 使用 IP67 NEMA 4X 防护等级的连接电缆, 才能确保仪表的 IP 防护等级。
- ▶ 安装堵头或连接电缆, 否则无法保证设计 IP 防护等级。

使用分离型外壳的仪表的过程连接和转接头**FEP 电缆**

- IP69 (传感器端)
- IP66 TYPE 4/6P
- IP68 TYPE 4/6P (测试条件: 1.83 米水柱, 持续 24 小时)

PE 电缆

- IP66 TYPE 4/6P
- IP68 TYPE 4/6P (测试条件: 1.83 米水柱, 持续 24 小时)

抗振性**双腔室铝外壳**

说明	正弦波振动, 符合 IEC62828-1 标准	冲击
带温度隔离器隔膜密封系统的仪表	10...60 Hz: ± 0.075 mm (0.0030 in) 60...500 Hz: 1 g	15 g

不锈钢双腔室外壳和不锈钢精密铸造双腔室外壳

说明	正弦波振动, 符合 IEC62828-1 标准	冲击
带温度隔离器隔膜密封系统的仪表	10...60 Hz: ± 0.075 mm (0.0030 in) 60...500 Hz: 1 g	15 g

双腔室外壳, L 型

说明	正弦波振动, 符合 IEC62828-1 标准	冲击
带温度隔离器隔膜密封系统的仪表 ¹⁾	10...60 Hz: ± 0.075 mm (0.0030 in) 60...500 Hz: 1 g	15 g

- 1) 在高温工况中使用带温度隔离器隔膜密封系统或带毛细管隔膜密封系统的仪表。如果同时还存在振动, Endress+Hauser 建议使用带毛细管隔膜密封系统的仪表。必须使用安装架安装带温度隔离器隔膜密封系统或毛细管隔膜密封系统的仪表。

电磁兼容性 (EMC)

- 电磁兼容性符合 IEC 61326 标准和 NAMUR NE21 标准的所有要求
- 安全完整性等级 (SIL) 符合 IEC 61326-3-x 标准。
- 最大偏差: 小于满量程的 0.5% (量程比 TD 1:1)

详细信息参见欧盟符合性声明。

过程条件

过程温度范围

注意
允许过程温度与过程连接、环境温度和认证型式相关。
► 进行仪表选型时必须考虑文档中列举的温度参数。

隔膜密封系统的填充液

填充液	$P_{abs} = 0.05 \text{ bar (0.725 psi)}^{1)}$	$P_{abs} \geq 1 \text{ bar (14.5 psi)}^{2)}$
硅油	-40 ... +180 °C (-40 ... +356 °F)	-40 ... +250 °C (-40 ... +482 °F)
高温油	-20 ... +200 °C (-4 ... +392 °F)	-20 ... +400 °C (-4 ... +752 °F) ^{3) 4) 5)}
低温油	-70 ... +120 °C (-94 ... +248 °F)	-70 ... +180 °C (-94 ... +356 °F)
植物油	-10 ... +160 °C (+14 ... +320 °F)	-10 ... +220 °C (+14 ... +428 °F)
惰性油	-40 ... +100 °C (-40 ... +212 °F)	-40 ... +175 °C (-40 ... +347 °F) ^{6) 7)}

- 1) $P_{abs} = 0.05 \text{ bar (0.725 psi)}$ 时的允许温度范围（注意设备和系统的允许温度范围）
- 2) $P_{abs} \geq 1 \text{ bar (14.5 psi)}$ 时的允许温度范围（注意设备和系统的允许温度范围）
- 3) 325 °C (617 °F), $P_{abs} \geq 1 \text{ bar (14.5 psi)}$ 时
- 4) 350 °C (662 °F), $P_{abs} \geq 1 \text{ bar (14.5 psi)}$, 且不超过 200 小时
- 5) 400 °C (752 °F), $P_{abs} \geq 1 \text{ bar (14.5 psi)}$, 且不超过 10 小时
- 6) 150 °C (302 °F), $P_{abs} \geq 1 \text{ bar (14.5 psi)}$ 时
- 7) 175 °C (347 °F), $P_{abs} \geq 1 \text{ bar (14.5 psi)}$, 且不超过 200 小时

填充液	密度 ¹⁾ kg/m ³
硅油	970
高温油	995
低温油	940
植物油	920
惰性油	1900

- 1) 20 °C (68 °F)时的隔膜密封系统填充液密度

隔膜密封系统的工作温度范围取决于使用的填充液、毛细管长度和内径、过程温度，以及隔膜密封的充油量。进入 **Applicator** 仪表选型软件的“[Sizing Diaphragm Seal](#)”模块，可以详细计算温度范围以及真空压力和温度范围。



A0038925

氧气应用（气态）

- 氧气和其他气体可以与油、油脂和塑料发生爆炸性反应。因此必须采取以下预防措施：
- 必须遵照国家要求清洁所有系统部件（例如测量设备）。
 - 根据所用材料，氧气应用中禁止超出指定最高温度和最大压力。

可选购仪表（而非附件）清洗服务。

$T_{\max}$	$P_{\max}^{1)}$
80 °C (176 °F)	80 bar (1 200 psi)
> 80 ... 120 °C (176 ... 248 °F)	70 bar (1 050 psi)

1) 法兰标称压力

密封圈

低压侧 (-) 的密封圈	温度	压力规格参数
FKM	-20 ... +85 °C (-4 ... +185 °F)	-
FKM 除油脂清洗	-10 ... +85 °C (+14 ... +185 °F)	-
FKM 氧气应用	-10 ... +60 °C (+14 ... +140 °F)	-
FFKM	-10 ... +85 °C (+14 ... +185 °F)	MWP: 160 bar (2 320 psi)
	-25 ... +85 °C (-13 ... +185 °F)	MWP: 100 bar (1 450 psi)
EPDM	-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)	-
PTFE	-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)	PN > 160 bar (2 320 psi) 最低过程温度: -20 °C (-4 °F)
PTFE 氧气应用	-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)	PN > 160 bar (2 320 psi) 最低过程温度: -20 °C (-4 °F)

- 隔膜密封系统和焊接毛细管：注意填充液的允许温度范围。
- 通常，仪表的单侧 OPL 值为 160 bar (2 320 psi)，双侧 OPL 值为 240 bar (3 480 psi)
更低温度通过特殊选型订购

过程温度范围（变送器温度）

带单侧隔热管隔膜密封系统的仪表

- 取决于仪表设计（参见“机械结构”章节）
- 取决于隔膜密封系统和填充液：-70 ... +400 °C (-94 ... +752 °F)
- 注意填充液的允许温度范围。
- 注意最大允许表压和最高允许温度
- 注意密封圈的允许过程温度范围

安装方式：

- 变送器水平安装，带长温度隔离器：400 °C (752 °F)
- 变送器竖直安装，带长温度隔离器：300 °C (572 °F)
- 变送器水平安装，带短温度隔离器：200 °C (392 °F)
- 变送器竖直安装，带短温度隔离器：200 °C (392 °F)

带单侧或双侧毛细管隔膜密封系统的仪表

- 取决于隔膜密封系统和填充液：-70 °C (-94 °F)...+400 °C (+752 °F)
- 过程连接的 A4 螺丝、螺纹隔热管： $T_{\min} = -60$ °C (-76 °F)
- 注意最大允许表压和最高允许温度

带钽材质膜片的隔膜密封系统

-70 ... +300 °C (-94 ... +572 °F)

带 PTFE 涂层的隔膜密封系统隔膜的仪表


防粘涂层具备高抗摩擦性能，可以保护隔膜免受磨损性介质的影响。

注意

PTFE 涂层使用不当会导致仪表损坏！

- ▶ PTFE 涂层设计用于避免磨损性介质干扰隔膜密封系统正常工作，不耐受腐蚀性介质。

下图为带 0.25 mm (0.01 in) 厚度 PTFE 涂层的 AISI 316L (1.4404/1.4435) 隔膜的仪表适用温度范围:

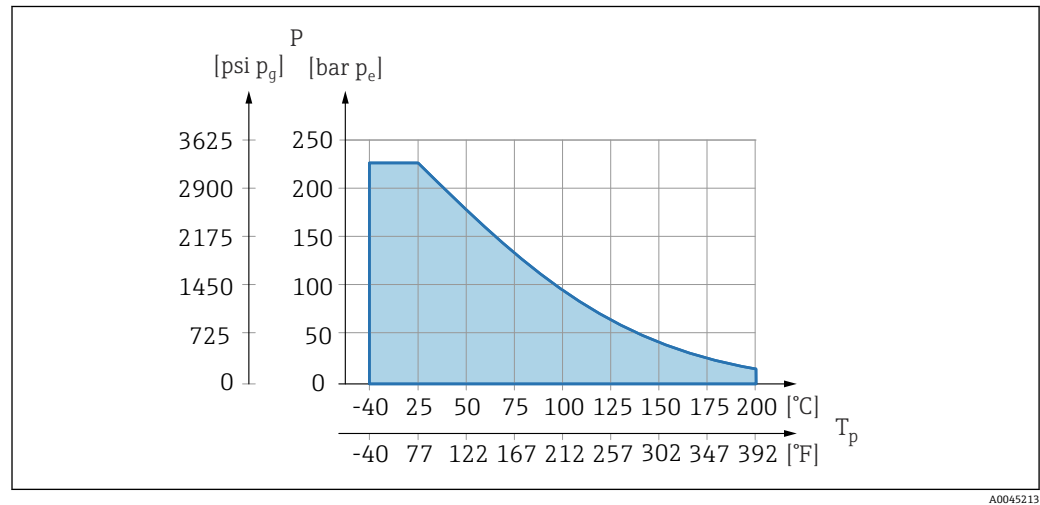


A0045213

i 在真空应用中: $p_{abs} \leq 1 \text{ bar (14.5 psi) ... 0.05 bar (0.725 psi)}$, 最高 +150 °C (302 °F)。
如果选择 PTFE 涂层, 则标配传统隔膜。

隔膜密封系统的毛细管护套

过程温度取决于环境温度。

- 316L: 无限制
- PTFE: 无限制
- PVC: 参见下图

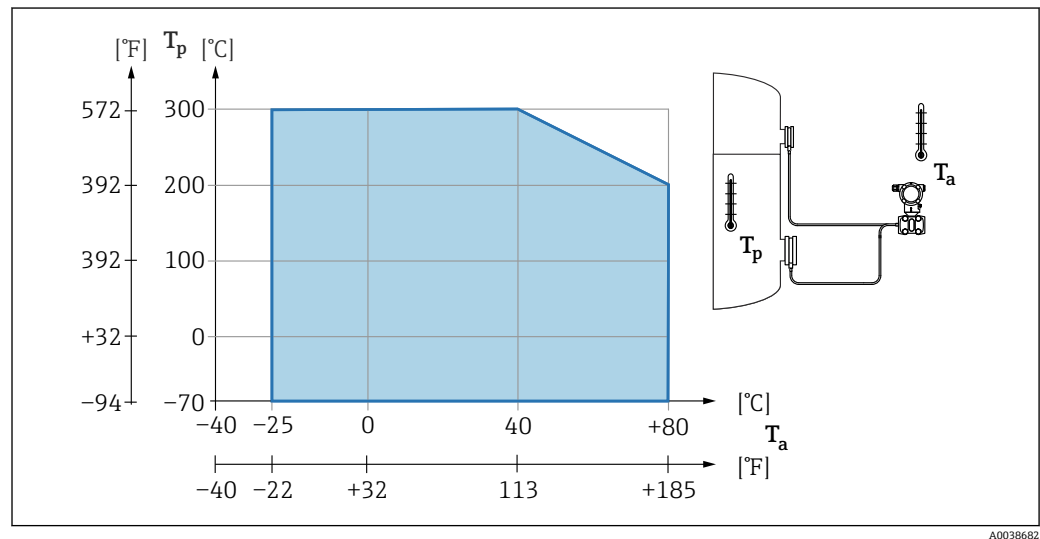

A0038682

过程压力范围

压力规格参数

i 仪表的最大压力取决于承压能力最弱部件的压力值。
部件包括过程连接、选配安装部件或附件。



警告

如果设备设计或使用不当，存在部件破裂导致人员受伤的风险！

- ▶ 仅允许在部件指定压力范围内使用设备！
- ▶ MWP（最大工作压力）：每个传感器的铭牌上均标识了最大工作压力。该压力为 +20 °C (+68 °F) 参考温度条件下，设备可持续承受的最大允许工作压力。注意最大工作压力 MWP 与温度的关系。在更高温度下使用法兰连接型仪表时，允许压力值参见下列标准：EN 1092-1 标准（就材质的温度稳定性而言，材料 1.4435 和 1.4404 的成分相同，均被列入 EN 1092-1 标准中）、ASME B 16.5a 标准、JIS B 2220 标准（始终以最新标准为准）。最大工作压力参数如有差异，参见《技术资料》的相关章节。
- ▶ 过压限定值是指设备在测试过程中可以持续承受的最大压力，过压限定值超出最大工作压力一定倍数。参考温度条件为 +20 °C (+68 °F)。
- ▶ 压力设备指令（2014/68/EU）的缩写代号为“PS”。“PS”代表设备的 MWP（最大工作压力）。
- ▶ 压力设备指令（2014/68/EU）的缩写代号为“PT”。“PT”代表设备的 OPL（过压限定值）。OPL（过压限定值）为测试压力。
- ▶ 传感器量程和过程连接的 OPL 小于传感器标称值时，仪表在工厂中按照过程连接 OPL 值设置。需要使用传感器的整个量程范围，应选择更高 OPL 值的过程连接（1.5 x PN；MWP = PN）。
- ▶ 氧气应用场合中不得超过 $P_{\max}$ 和 $T_{\max}$ 。



爆破压力

必须根据指定的爆破压力预估可能发生的承压部件完全损坏和/或设备泄漏情况。因此务必通过仔细的设备规划和标准制定避免此类操作条件。

保温层

温度隔离器隔膜密封系统的保温层

仪表有保温层厚度要求。最大允许保温层厚度的参考条件：保温材料的导热系数不超过 0.04 W/(m x K)，且满足最高允许环境温度和过程温度要求。上述数值在“静态空气”工况下测定。

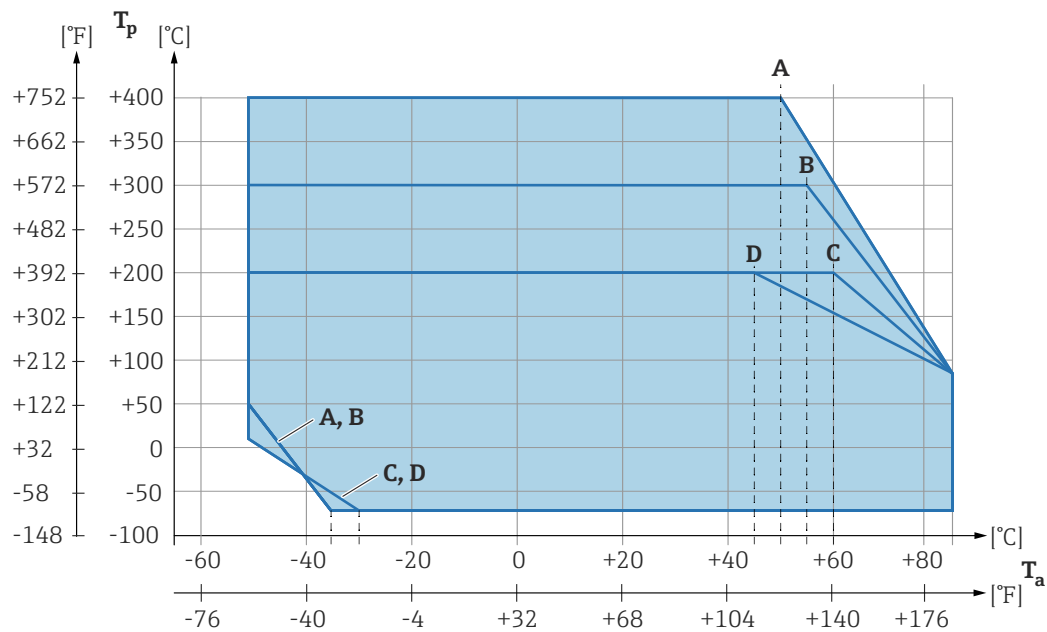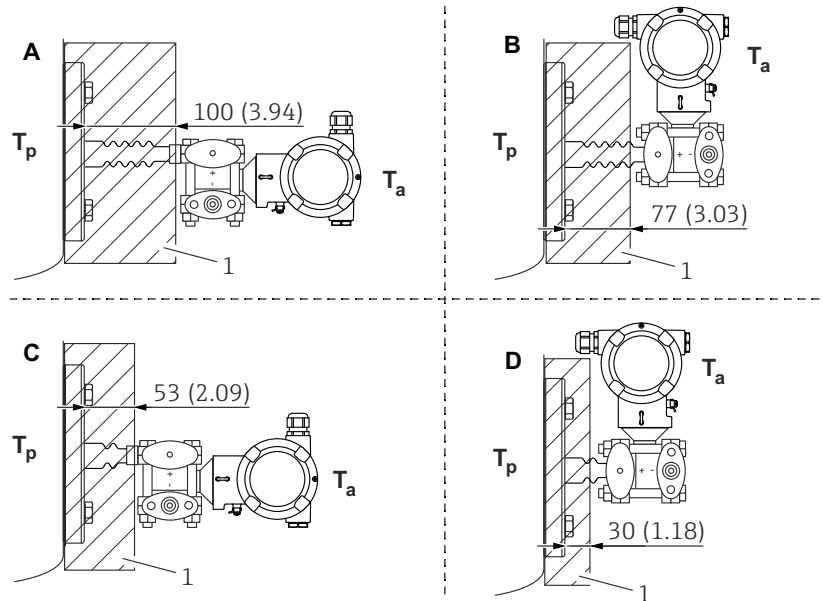

A0039331

- 1 保温材料
 A 变送器水平安装，带长温度隔离器
 B 变送器垂直安装，带长温度隔离器
 C 变送器水平安装，带短温度隔离器
 D 变送器垂直安装，带短温度隔离器

不使用保温层时环境温度降低 5 K。

图号	$T_a^{1)}$	$T_p^{2)}$
A	50 °C (122 °F)	400 °C (752 °F)
	85 °C (185 °F)	85 °C (185 °F) ³⁾
	-50 °C (-58 °F)	50 °C (122 °F)
	-35 °C (-31 °F)	-70 °C (-94 °F)
B	55 °C (131 °F)	300 °C (572 °F)
	85 °C (185 °F)	85 °C (185 °F)

图号	$T_a^{1)}$	$T_p^{2)}$
C	-50 °C (-58 °F)	50 °C (122 °F)
	-35 °C (-31 °F)	-70 °C (-94 °F)
	60 °C (140 °F)	200 °C (392 °F)
	85 °C (185 °F)	85 °C (185 °F)
D	-50 °C (-58 °F)	10 °C (50 °F)
	-30 °C (-22 °F)	-70 °C (-94 °F)
	67 °C (153 °F)	200 °C (392 °F)
	85 °C (185 °F)	85 °C (185 °F)


- 1) 变送器最高环境温度
- 2) 最高过程温度
- 3) 过程温度: 最高+400 °C (+752 °F), 取决于所用填充液。

宽温域隔膜密封系统

“宽温域”隔膜密封系统适用于高过程温度 and 低环境温度的极端工况。通过使用两种不同的填充液（主腔室中的填充液应对高过程温度，第二腔室中的填充液应对环境温度），仪表的应用范围得以扩大。

仪表有保温层厚度要求。最大允许保温层厚度的参考条件：保温材料的导热系数不超过 0.04 W/(m x K)，且满足最高允许环境温度和过程温度要求。上述数值在“静态空气”工况下测定。

订购信息：Configurator 产品选型软件中的订购选项“应用软件包”，选型代号“宽温域隔膜密封系统”

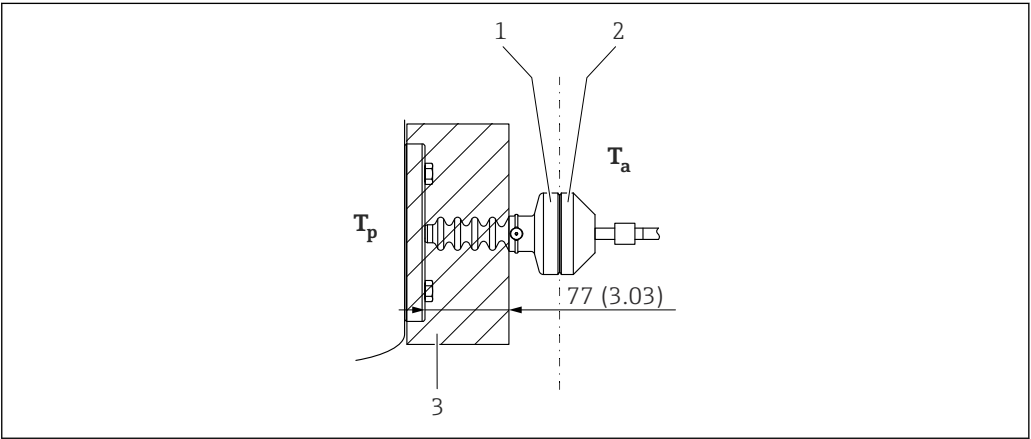

- 1 主腔室
- 2 第二腔室
- 3 保温材料

不使用保温层时环境温度降低 5 K。

超纯气体应用 Endress+Hauser 提供特殊应用场合中使用的仪表，例如超纯气体（经过除油脂清洗）。此类仪表对过程条件无特殊限制。

氢气应用 在气体测量和水溶液测量应用中，镀金金属隔膜能够防止氢气渗透。

机械结构


设计及外形尺寸

仪表高度

仪表高度包括


- 外壳高度
- 选配安装部件高度，例如温度隔离器或毛细管
- 不同过程连接的高度

以下章节中列举了各个部件的高度。将不同部件的高度相加，计算仪表高度。考虑安装间隙（安装仪表所需的空間）。

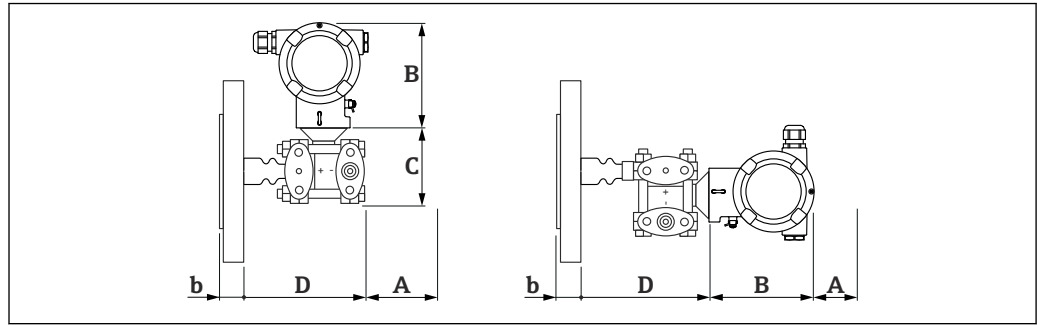

A0038403

- A 安装间隙
- B 外壳高度
- b 过程连接高度
- C 传感器组件高度
- D 安装部件宽度，包括传感器组件

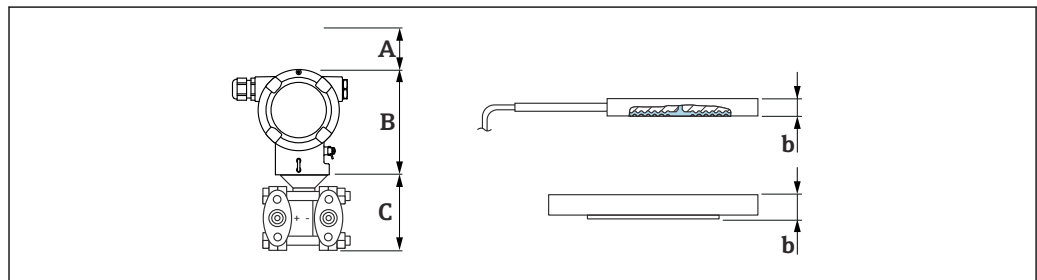


A0038655

- A 安装间隙
- B 外壳高度
- C 侧法兰
- b 过程连接

外形尺寸

双腔室外壳

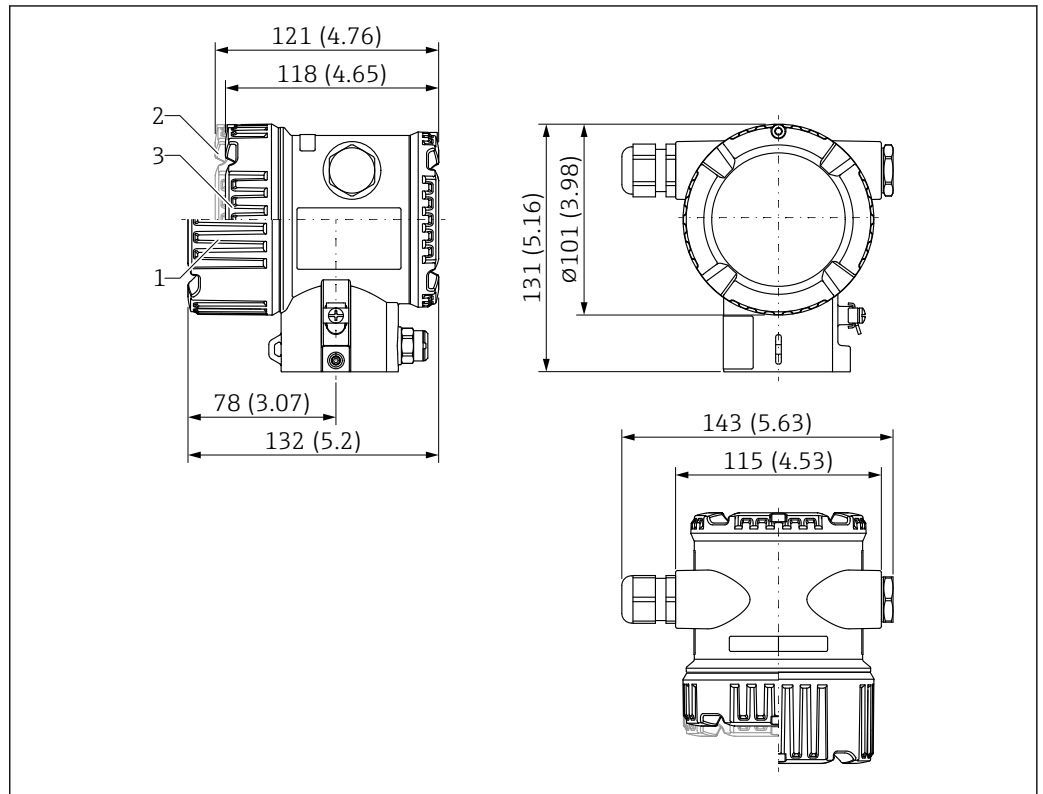

A0038377


测量单位 mm (in)

- 1 带显示单元的仪表，外壳盖带玻璃观察窗（适用 Ex d/XP 和粉尘防爆仪表）：132 mm (5.2 in)
- 2 带显示单元的仪表，外壳盖带塑料观察窗：121 mm (4.76 in)
- 3 不带显示单元的仪表，外壳盖不带观察窗：118 mm (4.65 in)



盖板可选配符合 ANSI 安全色标准的红色（RAL3002 色号）涂层。

双腔室不锈钢外壳（精密铸造）

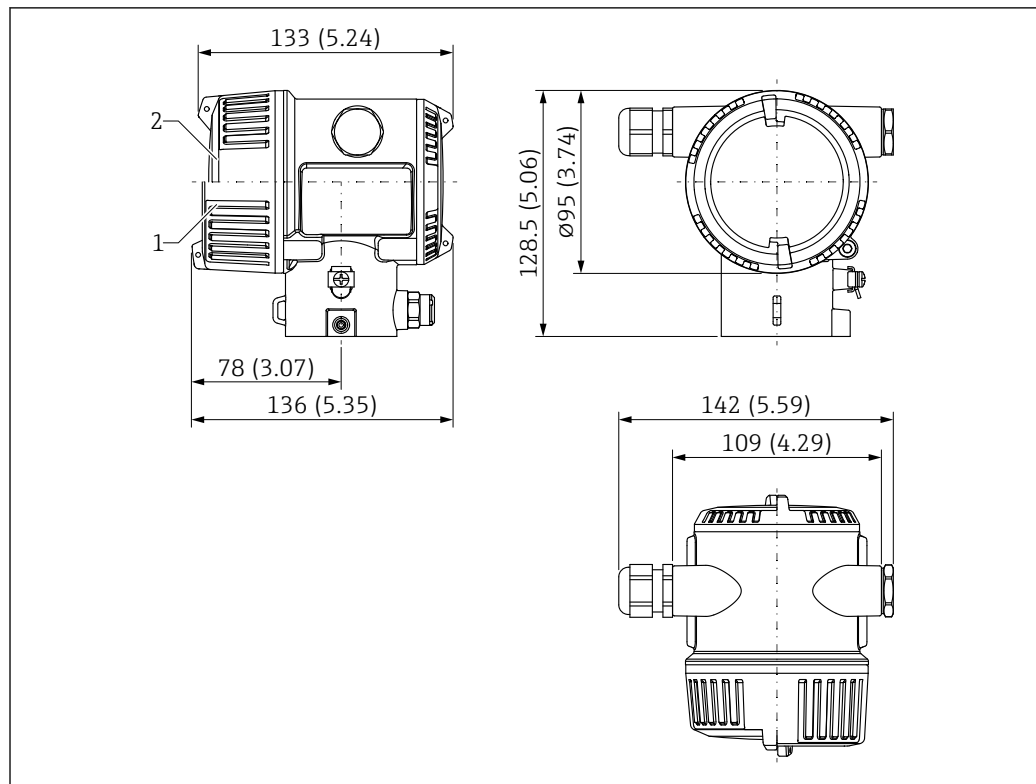


A0058028

测量单位 mm (in)

- 1 带显示单元的仪表，外壳盖带玻璃观察窗（适用 Ex d/XP 和粉尘防爆仪表）：136 mm (5.35 in)
- 2 不带显示单元的仪表，外壳盖不带观察窗：133 mm (5.24 in)

双腔室外壳, L 型

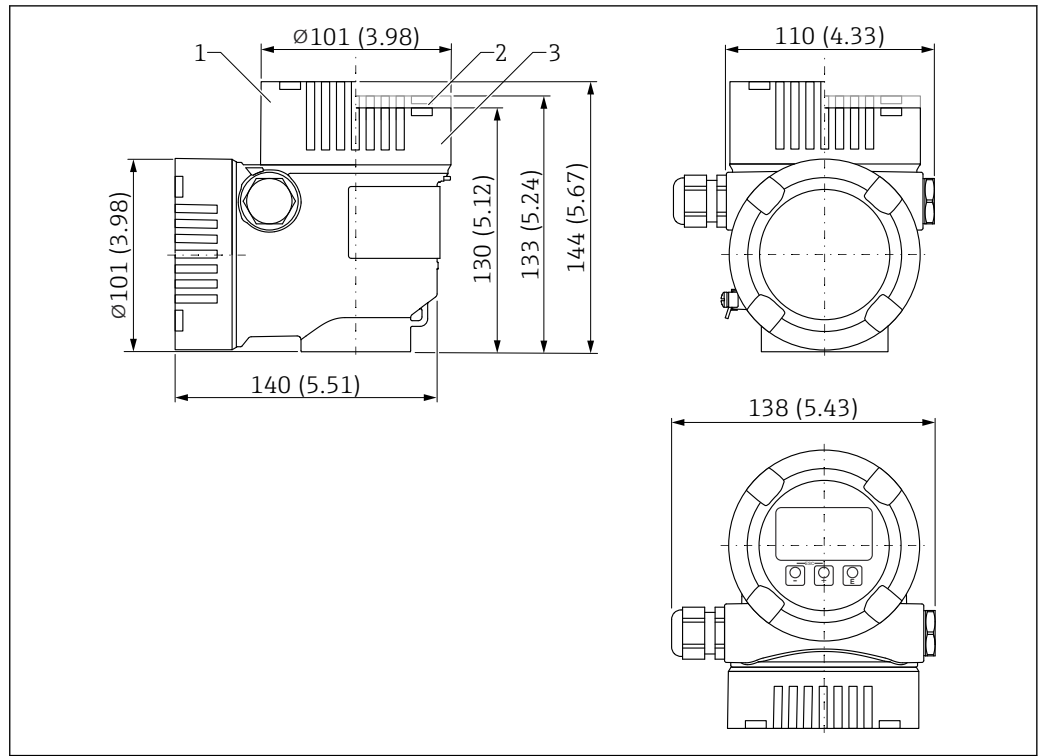

A0038381

测量单位 mm (in)

- 1 144 mm (5.67 in): 带玻璃观察窗的盖板高度 (适用 Ex d/XP 和粉尘防爆仪表)
- 2 133 mm (5.24 in): 带塑料观察窗的盖板高度
- 3 不带观察窗的盖板高度




盖板可选配符合 ANSI 安全色标准的红色 (RAL3002 色号) 涂层。




双腔室外壳 (L 型) 的两个部分 (顶部和侧面) 均可安装设备显示单元。

分体式传感器 (分离型外壳)

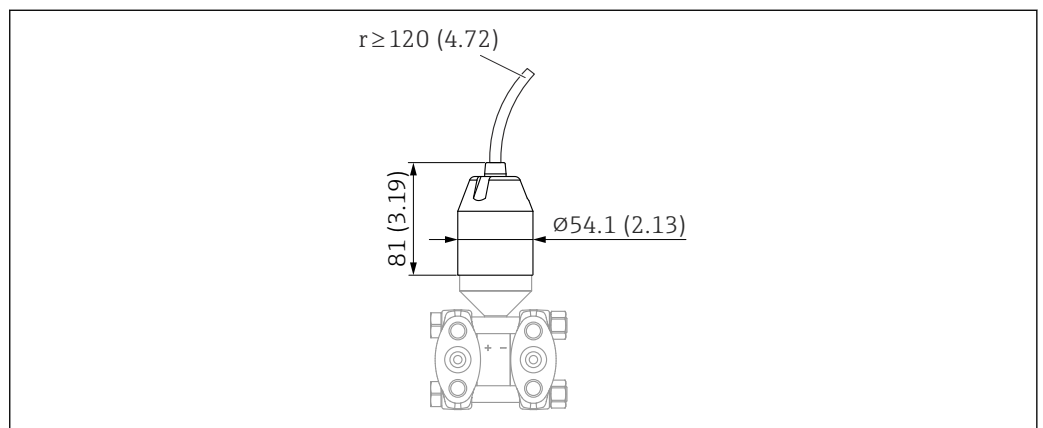

A0058870

安装架和电缆长度

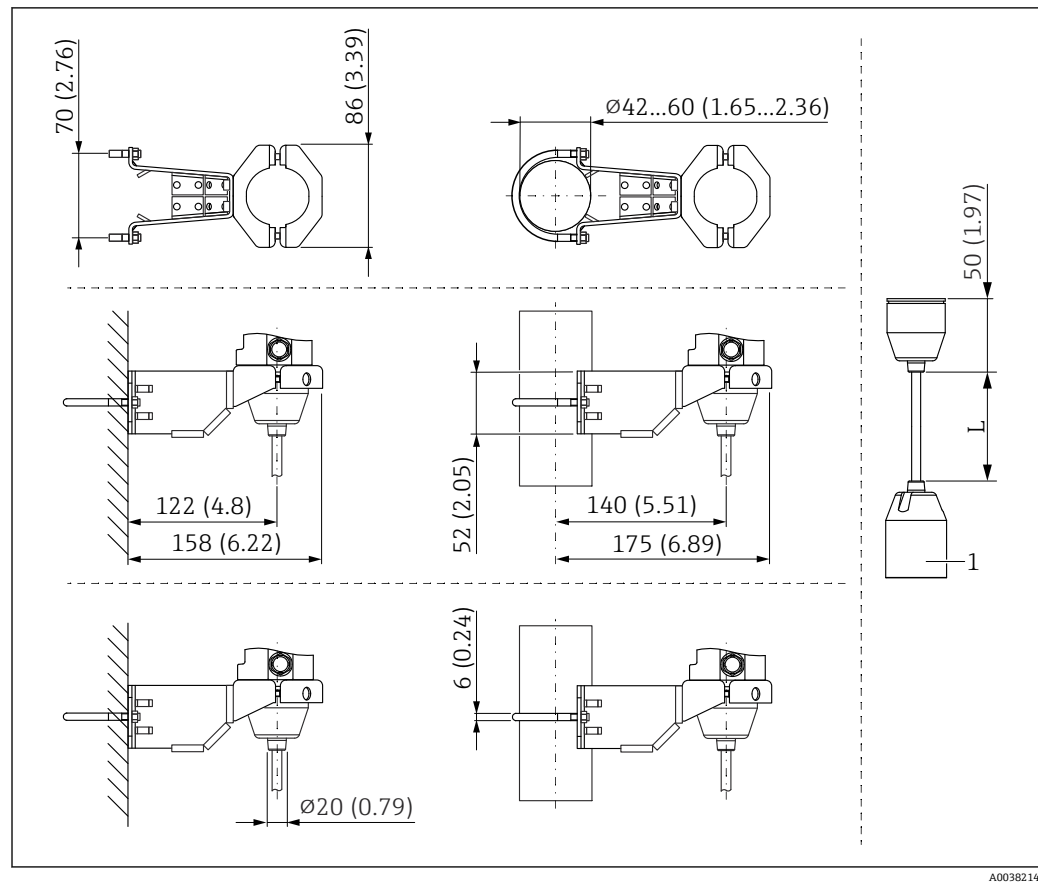

A0038214

测量单位 mm (in)

1 81 mm (3.19 in)

L 电缆长度

带温度隔离器的仪表的过程连接

选择过程连接和毛细管

仪表的高压侧 (HP) 和低压侧 (LP) 可以安装不同的过程连接。

还可在仪表的低压侧 (LP) 安装毛细管。


使用带毛细管的隔膜密封系统时必须允许充分消除应力的影响，以防毛细管过度弯曲（毛细管的弯曲半径: ≥ 100 mm (3.94 in)）。

实例:

- 高压侧的过程连接: DN80 法兰
- 低压侧的过程连接: DN50 法兰

优势:

- 提供多种订购选项，优化满足特定安装要求
- 最优系统设计，降低使用成本
- 毛细管长度可调节，安装更简便
- 轻松适应现有安装条件

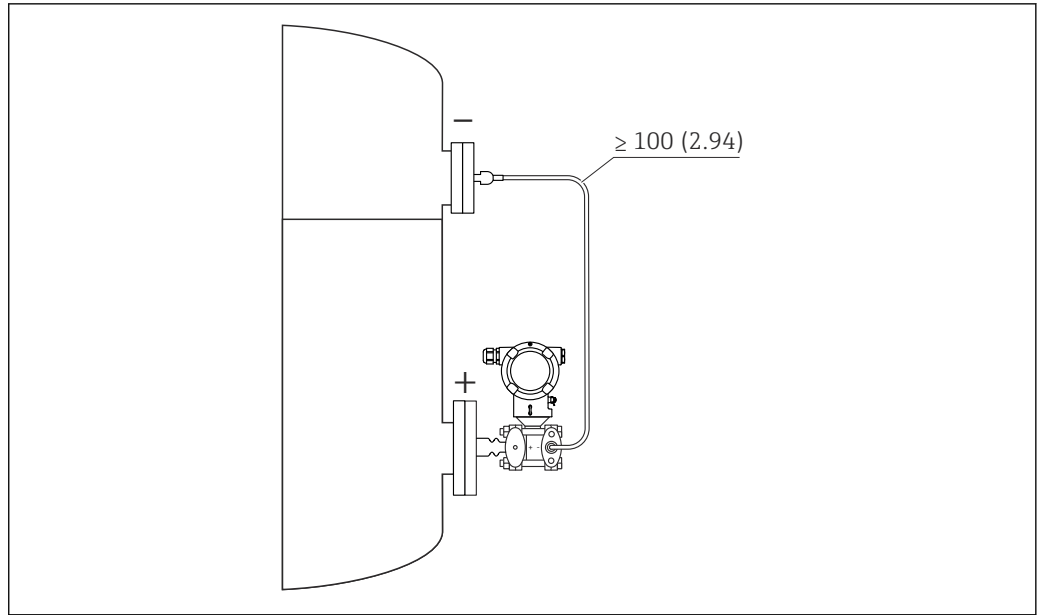


A0038657

测量单位 mm (in)



如果需要选择其他过程连接和毛细管长度，必须使用免费选型软件的“[Sizing Diaphragm Seal](#)”模块进行仪表选型和订购。

概览：带单侧或双侧温度隔离器隔膜密封系统的仪表

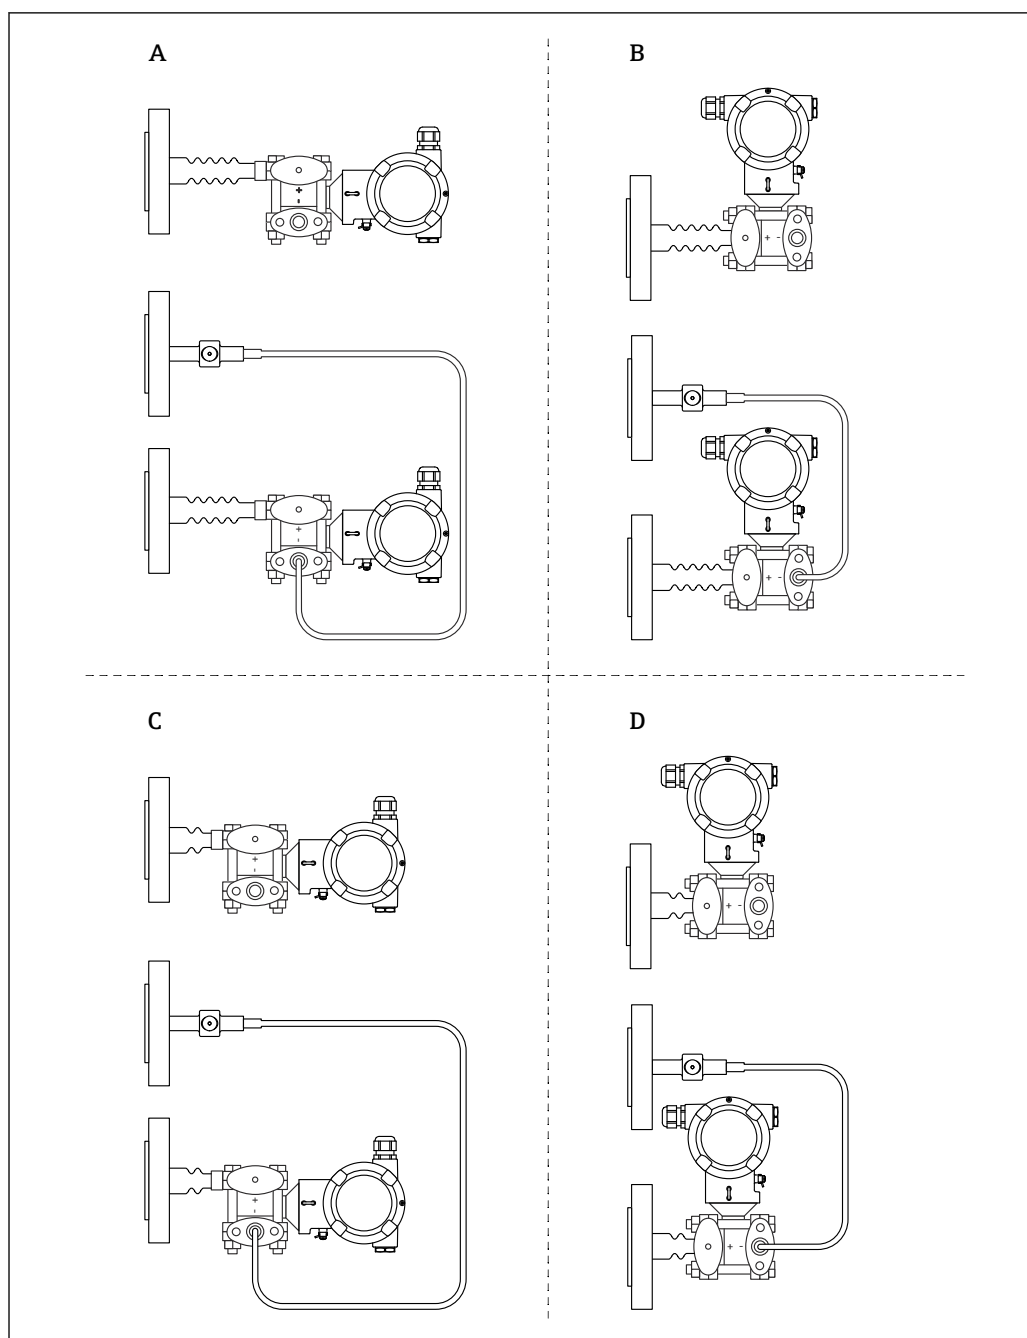


A0038658

- A 变送器水平安装，带长温度隔离器
- B 变送器垂直安装，带长温度隔离器
- C 变送器水平安装，带短温度隔离器
- D 变送器垂直安装，带短温度隔离器

带单侧隔膜密封系统（高压侧）的仪表的过程连接

带长温度隔离器的仪表

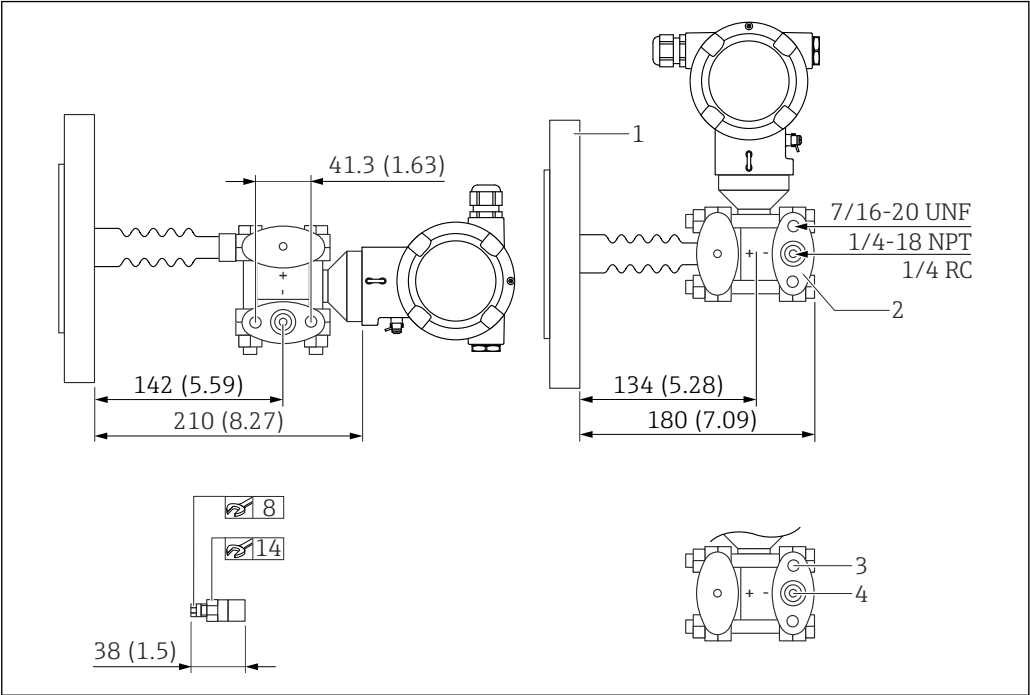


A0038662

测量单位 mm (in)

- 1 高压侧
- 2 低压侧
- 3 螺纹深度: 15 mm (0.59 in)
- 4 螺纹深度: 12 mm (0.47 in) (±1 mm (0.04 in))

带短温度隔离器的仪表

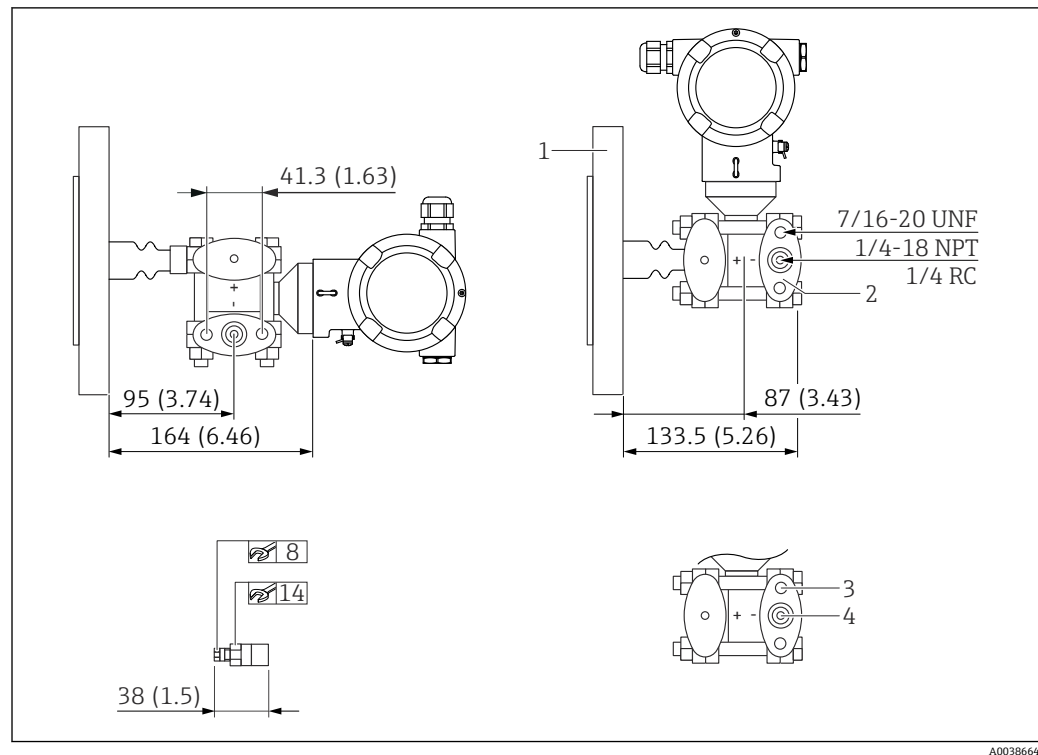

A0038664

测量单位 mm (in)

- 1 高压侧
- 2 低压侧
- 3 螺纹深度: 15 mm (0.59 in)
- 4 螺纹深度: 12 mm (0.47 in) (± 1 mm (0.04 in))

带双侧毛细管隔膜密封系统的
仪表的过程连接

选择过程连接和毛细管

仪表的高压侧 (HP) 和低压侧 (LP) 可以安装不同的过程连接。

仪表的高压侧 (HP) 和低压侧 (LP) 可以安装不同长度的毛细管。


使用带毛细管的隔膜密封系统时必须允许充分消除应力的影响, 以防毛细管过度弯曲 (毛细管的弯曲半径: ≥ 100 mm (3.94 in))。

实例:

- 高压侧的过程连接: DN80 法兰
- 低压侧的过程连接: DN50 法兰
- 高压侧的毛细管长度: 2 m (6.6 ft)
- 低压侧的毛细管长度: 5 m (16 ft)

优势:

- 提供多种订购选项, 优化满足特定安装要求
- 最优系统设计, 降低使用成本
- 低压侧和高压侧的毛细管长度可调节, 安装更简便
- 轻松适应现有安装条件

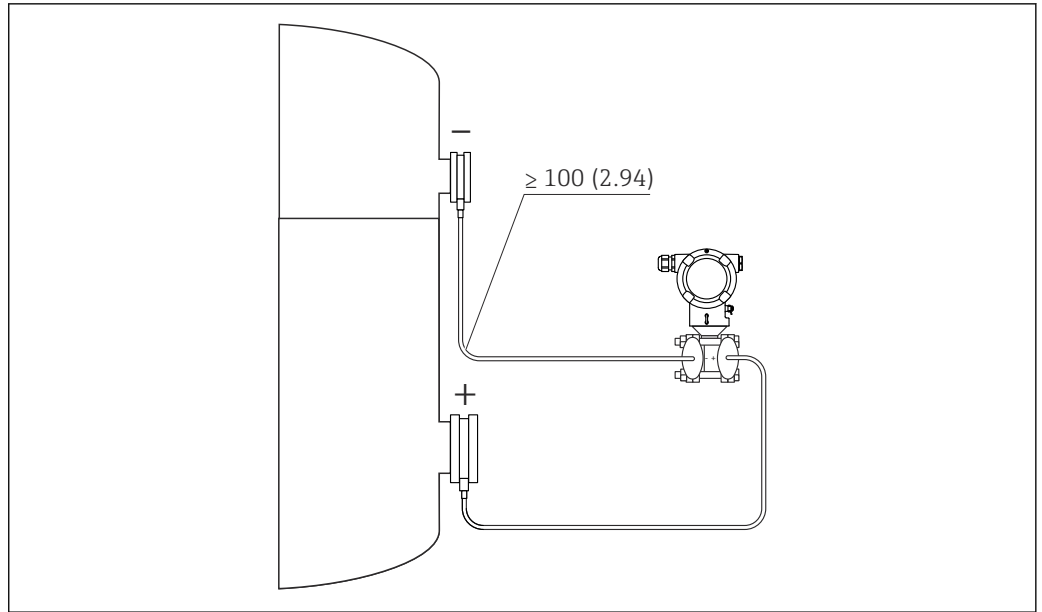

A0039308

测量单位 mm (in)



如果需要选择其他过程连接和毛细管长度，必须使用免费选型软件的“[Sizing Diaphragm Seal](#)”模块进行仪表选型和订购。


宽温域隔膜密封系统

“宽温域”隔膜密封系统适用于高过程温度和低环境温度的极端工况。通过使用两种不同的填充液（主腔室中的填充液应对高过程温度，第二腔室中的填充液应对环境温度），仪表的应用范围得以扩大。

优势：

- 响应时间极短
- 提高工厂安全性
- 无需加热毛细管系统
- 节省安装成本
- 节省操作成本

订购信息：Configurator 产品选型软件中的订购选项“应用软件包”，选型代号“宽温域隔膜密封系统”

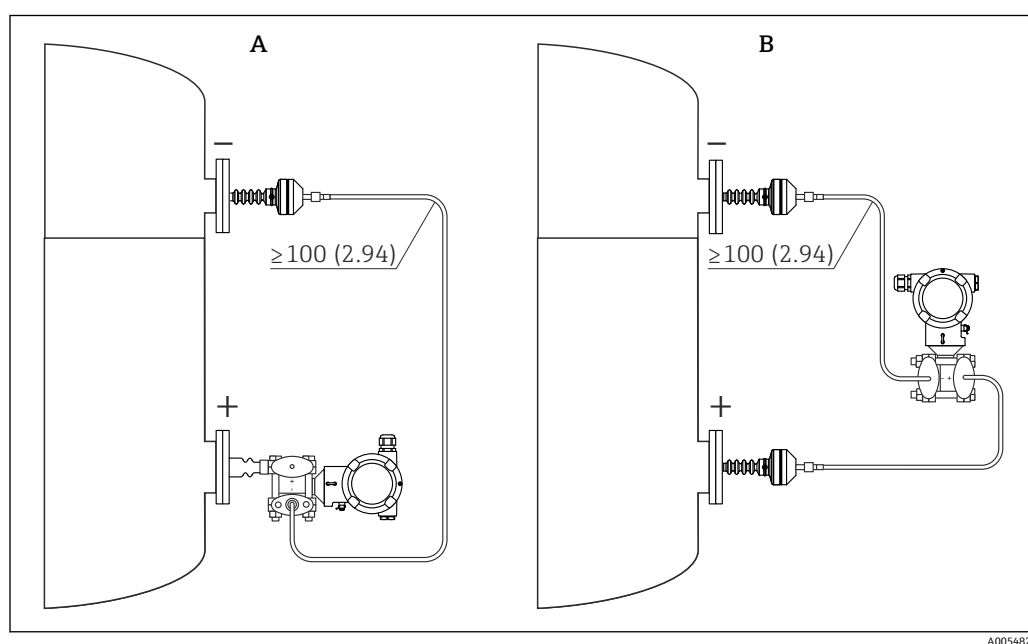

A0054827

测量单位 mm (in)

- A 带单侧毛细管的仪表
B 带双侧毛细管的仪表

主仪表

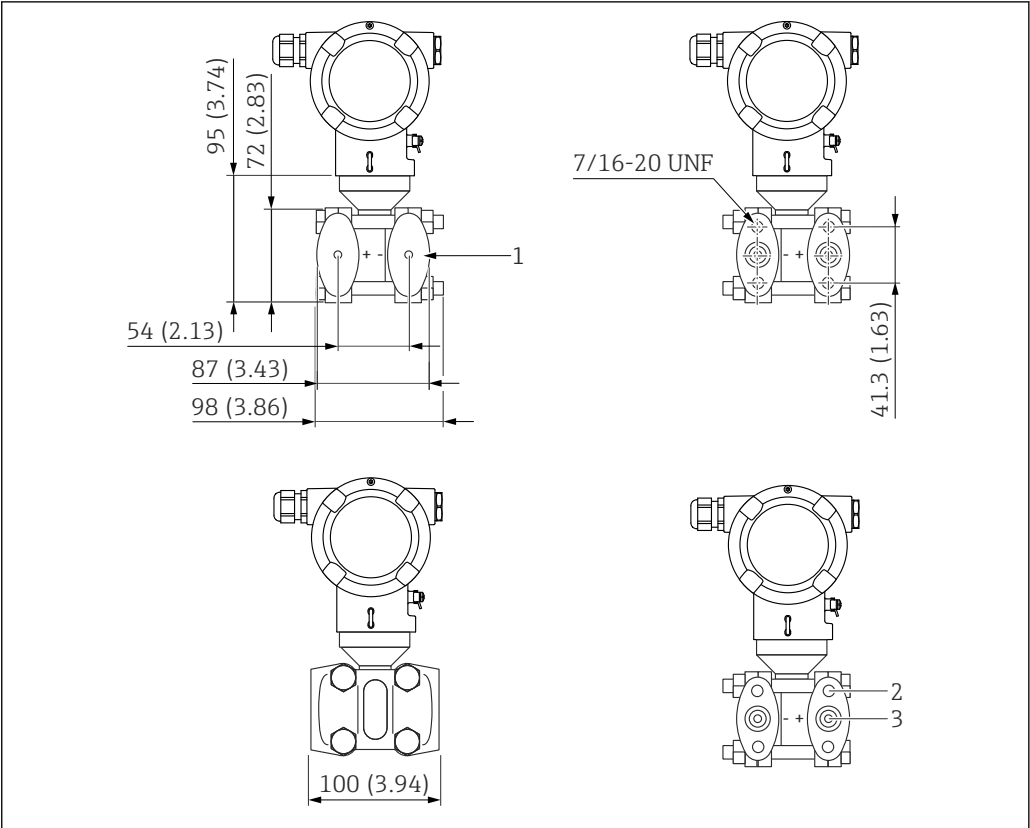


图 5 正视图、左视图、右视图。螺母始终安装在负压侧。测量单位 mm (in)

- 1 隔膜密封系统的安装位置
- 2 螺纹深度: 15 mm (0.59 in)
- 3 螺纹深度: 12 mm (0.47 in) (±1 mm (0.04 in))

毛细管长度

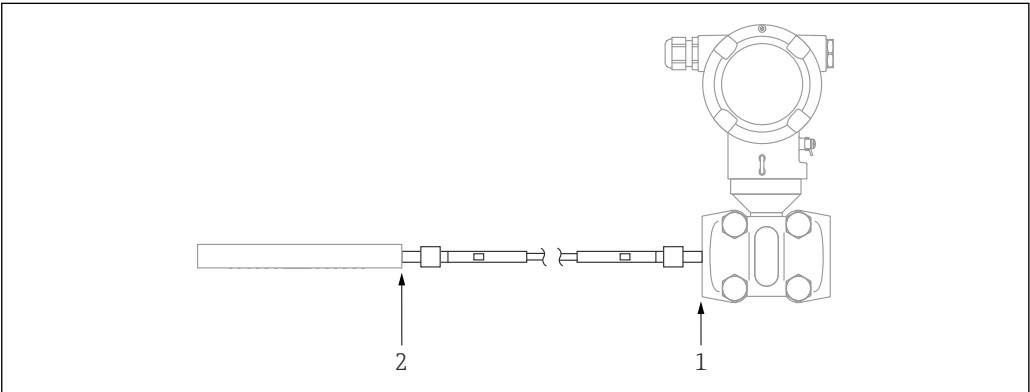


图 6 毛细管长度指椭圆形法兰和隔膜密封系统后部之间的距离。测量单位 mm (in)

- 1 椭圆形法兰
- 2 隔膜密封系统后部

带隔膜密封系统的仪表的过程连接

- 以下图纸均为示意图
- 随箱包装中的隔膜密封系统的实际尺寸可能与文档中列举的尺寸有所不同
- 详细信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心

过程连接


最大工作压力和过压限定值

传感器与过程连接的 MWP（最大工作压力）和 OPL（过压限定值）可能有所不同。

术语说明

- DN/NPS/A = 法兰口径的字母数字代号
- PN/Class/K = 部件压力等级的字母数字代号

扁平密封圈，齐平安装膜片

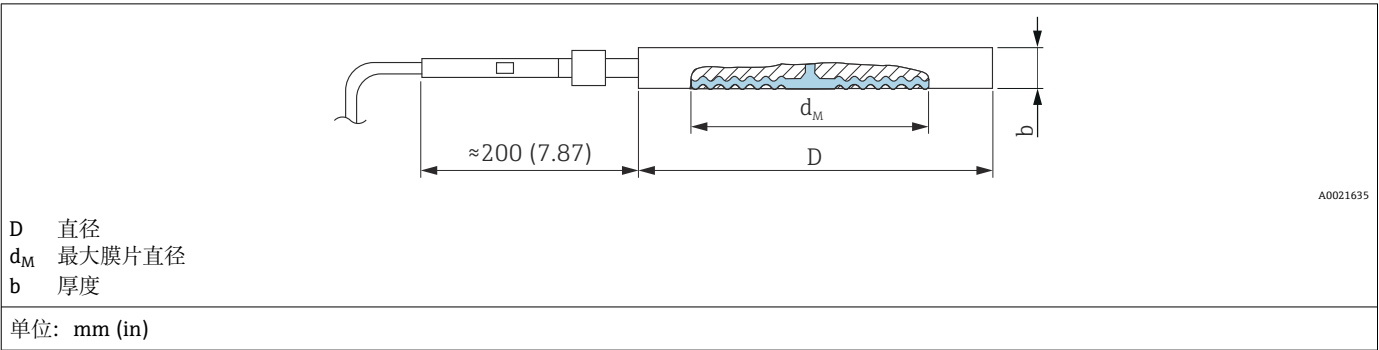

材质 ¹⁾	DN	PN ²⁾	D mm	b mm	选型代号 ³⁾
AISI 316L	DN 50	PN 16...400	102	20...22	NRJ
	DN 80	PN 16...400	138	20...22	NTJ
	DN 100	PN 16...400	162	20...22	NUJ

- 1) 如果选购 PTFE 涂层，标配常规材质膜片。
- 2) 隔膜密封系统的标称压力。仪表的最大压力取决于承压能力最弱的部件。
- 3) Configurator 产品选型软件，订购选项“过程连接”

材质	NPS	压力等级 Class ¹⁾	D in	b in	选型代号 ²⁾
AISI 316L	2	150...2500	3.62	0.79...0.87	N1J
	3	150...2500	5.00	0.79...0.87	N3J
	4	150...2500	6.22	0.79...0.87	N4J

- 1) 隔膜密封系统的标称压力。仪表的最大压力取决于承压能力最弱的部件。
- 2) Configurator 产品选型软件，订购选项“过程连接”


膜片最大直径 Ød_M

DN	PN	Ød _M (mm)					
		316L TempC	316L	Alloy C276 合金	钽	蒙乃尔 (Alloy 400 合金)	PTFE
50	16-400	61	-	62	60	59	52
80	16-400	89	-	90	92	89	80
100	16-400	-	89	90	92	89	-

NPS in	压力等级	Ød _M (in)					
		316L TempC	316L	Alloy C276 合金	钽	蒙乃尔 (Alloy 400 合金)	PTFE
2	150-2500	2.40	-	2.32	2.36	2.32	2.05
3	150-2500	3.50	-	3.54	3.62	3.50	3.14
4	150-2500	-	3.14	3.50	3.62	3.50	-

EN1092-1 法兰，齐平安装膜片，隔膜密封系统

连接尺寸符合 EN1092-1 标准。

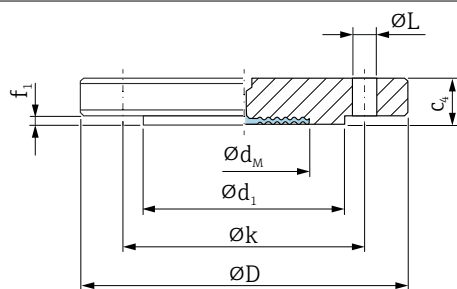

A0045226

$\varnothing D$ 法兰口径
 c_4 厚度
 $\varnothing d_1$ 突面
 f_1 突面
 $\varnothing k$ 节圆直径
 $\varnothing L$ 孔径
 $\varnothing d_M$ 最大膜片直径

单位: mm

法兰 ^{1) 2) 3) 4)}							螺栓孔			选型代号 ⁵⁾
DN	PN	型式	ØD	c ₄	Ød ₁	f ₁	数量	ØL	Øk	
			mm	mm	mm	mm		mm	mm	
DN 50	PN 10...40	B1	165	20	102	3	4	18	125	H3J
DN 50	PN 63	B2	180	26	102	3	4	22	135	FGJ
DN 50	PN 100...160	B2	195	30	102	3	4	26	145	MCJ
DN 80	PN 10...40	B1	200	24	138	3	8	18	160	H5J
DN 80	PN 100	B2	230	32	138	3	8	26	180	FPJ
DN 100	PN 10...16	B1	220	20	158	3	8	18	180	ETJ
DN 100	PN 25...40	B1	235	24	162	3	8	22	190	E5J
DN 100	PN 100	B2	265	36	162	3	8	30	210	FQJ


- 1) 材质: AISI 316L
- 2) 接液部件的表面光洁度为 $R_a < 0.8 \mu m$ ($31.5 \mu in$), 包括 Alloy C276 合金、Monel 蒙乃尔、钽、金 (> 316L) 或 PTFE 材质的法兰 (所有标准) 突面。更高表面光洁度可通过特殊选型订购。
- 3) 法兰突面材质与膜片材质相同。
- 4) 如果选购 PTFE 涂层, 标配常规材质膜片。
- 5) Configurator 产品选型软件, 订购选项“过程连接”

膜片最大直径 Ød_M

DN	PN	Ød _M (mm)					
		316L TempC	316L	Alloy C276 合金	钽	蒙乃尔 (Alloy 400 合金)	PTFE
DN 50	PN 10...40	61	-	57	60	59	52
DN 50	PN 63	-	52	62	60	59	-
DN 50	PN 100...160	-	52	62	60	59	-
DN 80	PN 10...40	89	-	89	92	89	80
DN 80	PN 100	-	80	90	92	90	-
DN 100	PN 10...16	-	80	90	92	89	-
DN 100	PN 25...40	-	80	90	92	89	-
DN 100	PN 100	-	80	90	92	89	-

EN1092-1 带颈法兰，齐平安装膜片，隔膜密封系统

连接尺寸符合 EN 1092-1 标准。

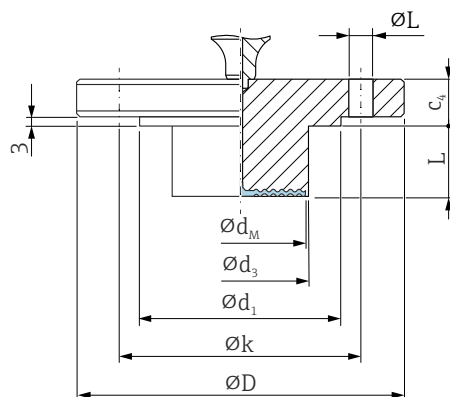

A0045227

$\varnothing D$ 法兰口径
 c_4 厚度
 $\varnothing d_1$ 突面
 $\varnothing k$ 节圆直径
 $\varnothing L_2$ 孔径
 $\varnothing d_M$ 最大膜片直径
 $\varnothing d_3$ 法兰颈直径
 L 法兰颈长度

单位: mm

法兰 ^{1) 2)}						螺栓孔			隔膜密封系统
DN	PN	型式	$\varnothing D$	c_4	$\varnothing d_1$	数量	$\varnothing L$	$\varnothing k$	$\varnothing d_M$ ³⁾
			mm	mm	mm		mm	mm	mm
DN 50	PN 10...40	B1	165	20	102	4	18	125	48
DN 80	PN 10...40	B1	200	24	138	8	18	160	73

1) 材质: AISI 316L

2) 使用 Alloy C276 合金材质的膜片时，法兰突面材质与法兰颈材质均为 316L


3) 最大膜片直径

法兰颈				
DN	PN	L	$\varnothing d_3$	选型代号 ¹⁾
		mm	mm	
DN 50	PN 10...40	50 / 100 / 150 / 200	48.3	JNJ、JPJ、JQJ、JRJ
DN 80	PN 10...40	50 / 100 / 150 / 200	76	JSJ、JTJ、JUT、JUV

1) Configurator 产品选型软件，订购选项“过程连接”

ASME B16.5 法兰，齐平安装膜片，隔膜密封系统

连接尺寸符合 ASME B 16.5 RF 标准

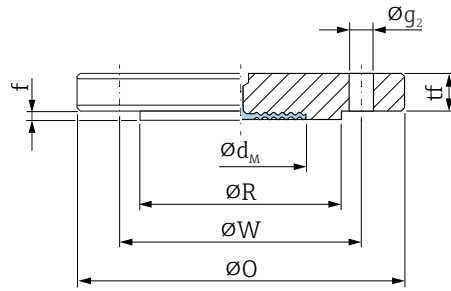

A0045230

ØO 法兰口径
 tf 厚度
 ØR 突面
 f 突面
 ØW 节圆直径
 Øg₂ 孔径
 Ød_M 最大膜片直径

单位: in


法兰 1) 2) 3)						螺栓孔			选型代号 4)
公称管道尺寸 NPS	压力等级 Class	ØO	tf	ØR	f	数量	Øg ₂	ØW	
in		in	in	in	in		in	in	
2	150	6	0.69	3.62	0.06	4	3/4	4.75	ADJ
2	300	6.5	0.81	3.62	0.06	8	3/4	5	AQJ
2	400/600	6.5	1	3.62	0.25	8	3/4	5	A0J
2	900/1500	8.5	1.5	3.62	0.25	8	1	6.5	BFJ
2	2500	9.25	2	3.62	0.25	8	1 1/8	6.75	BLJ
3	150	7.5	0.88	5	0.06	4	3/4	6	AFJ
3	300	8.25	1.06	5	0.06	8	7/8	6.62	ASJ
3	400/600	6.5	1.25	5	0.25	8	7/8	6.62	A1J
3	900	9.5	1.5	5	0.25	8	1	7.5	BAJ
4	150	9	0.88	6.19	0.06	8	3/4	7.5	AGJ
4	300	10	1.19	6.19	0.06	8	7/8	7.88	ATJ

- 1) 材质: AISI 316/316L; 结合 AISI 316 的承压能力和 AISI 316L 的耐化学腐蚀性能 (双重防护)
- 2) 接液部件的表面光洁度为 $R_a < 0.8 \mu\text{m}$ ($31.5 \mu\text{in}$), 包括 Alloy C276 合金、Monel 蒙乃尔、钽、金或 PTFE 材质的法兰 (所有标准) 突面。更高表面光洁度可通过特殊选型订购。
- 3) 法兰突面材质与膜片材质相同。
- 4) Configurator 产品选型软件, 订购选项“过程连接”

膜片最大直径 $\varnothing d_M$

公称管道尺寸 NPS	压力等级 Class	$\varnothing d_M$ (in)				
		316L TempC	316L	Alloy C276 合金	钽	蒙乃尔 (Alloy 400 合金)
2	150	2.40	-	2.44	2.44	2.44
2	300	2.40	-	2.44	2.44	2.44
2	400/600	-	2.05	2.44	2.44	2.44
2	900/1500	-	2.05	2.44	2.44	2.44
2	2500	-	2.05	2.44	2.44	2.44
3	150	3.50	-	3.62	3.62	3.62
3	300	3.50	-	3.62	3.62	3.62
3	400/600	-	3.15	3.62	3.62	3.62
3	900	-	3.15	3.62	3.62	3.62
4	150	-	3.15	3.62	3.62	3.62
4	300	-	3.15	3.62	3.62	3.62

ASME B16.5 带颈法兰，齐平安装膜片，隔膜密封系统
连接尺寸符合 ASME B 16.5 RF 标准

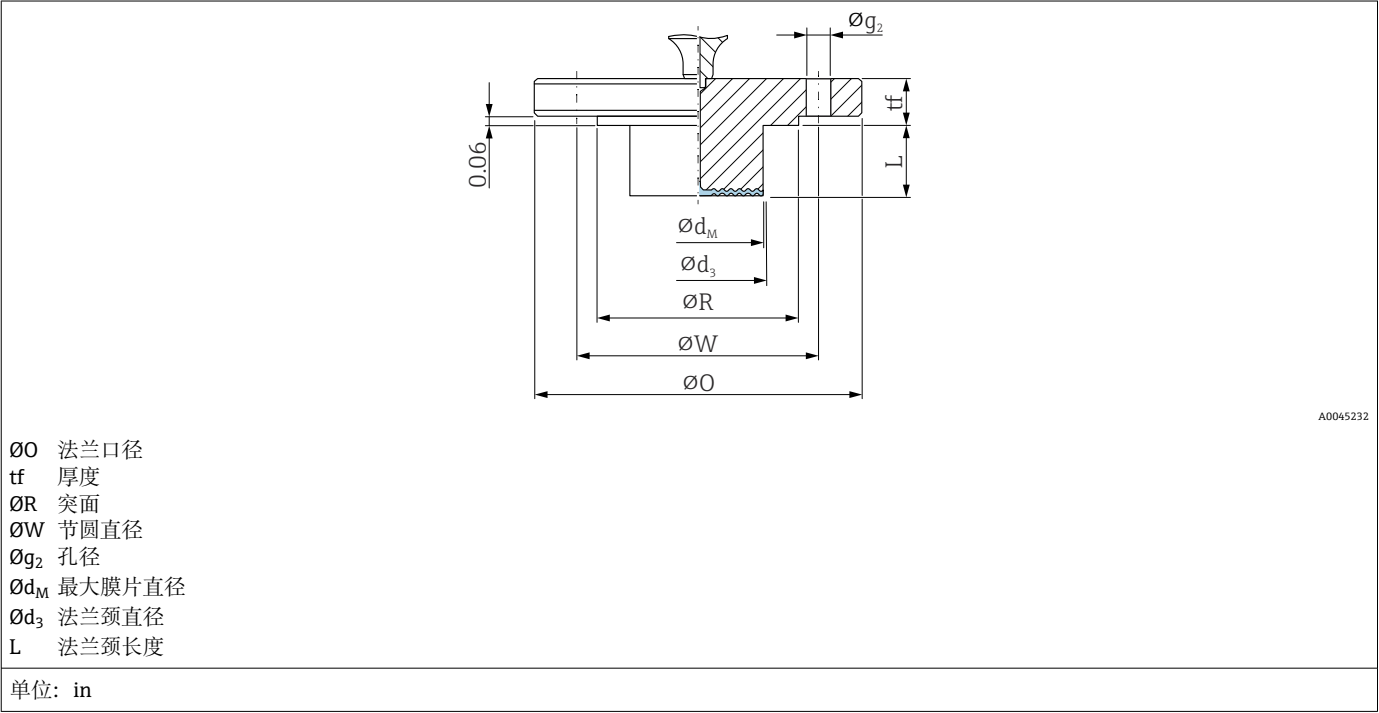

法兰 ^{1) 2) 3)}					螺栓孔		隔膜密封系统	
公称管道尺寸 NPS	压力等级 Class	ØO	tf	ØR	数量	Øg ₂	ØW	Ød _M ⁴⁾
in		in	in	in		in	in	in
2	150	6	0.69	3.62	4	3/4	4.75	1.9
3	150	7.5	0.88	5	4	3/4	6	2.87
4	150	9	0.88	6.19	8	3/4	7.5	3.5


- 1) 材质: AISI 316/316L。结合 AISI 316 的承压能力和 AISI 316L 的耐化学腐蚀性能 (双重防护)
2) 使用 Alloy C276 合金材质的膜片时, 法兰突面材质为 316L。
3) 如果选购 PTFE 涂层, 标配常规材质膜片。
4) 最大膜片直径

法兰颈				
公称管道尺寸 NPS	压力等级 Class	L	d ₃	选型代号 ¹⁾
in		in (mm)	in (mm)	
2	150	2 (50.8) / 4 (101.6) / 6 (152.4) / 8 (203.2)	1.9 (48.3)	CJJ、CKJ、CLJ、CMJ
3	150	2 (50.8) / 4 (101.6) / 6 (152.4) / 8 (203.2)	2.99 (76)	CSJ、CTJ、CUJ、CVJ
4	150	2 (50.8) / 4 (101.6) / 6 (152.4) / 8 (203.2)	3.7 (94)	CWJ、CXJ、CZJ、C0J

- 1) Configurator 产品选型软件, 订购选项“过程连接”

JIS 法兰, 齐平安装膜片, 隔膜密封系统

连接尺寸符合 JIS B 2220 BL RF 标准

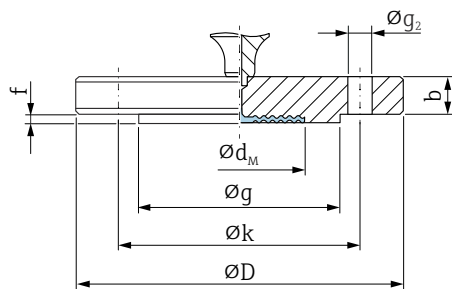

A0021680

D 法兰口径
b 厚度
g 突面
f 突面厚度
k 节圆直径
g₂ 孔径

单位: mm

法兰 ^{1) 2) 3)}						螺栓孔			选型代号 ⁴⁾
A ⁵⁾	K ⁶⁾	D	b	g	f	数量	g ₂	k	
		mm	mm	mm	mm		mm	mm	
50 A	10 K	155	16	96	2	4	19	120	PDJ
80 A	10 K	185	18	127	2	8	19	150	PFJ
100 A	10 K	210	18	151	2	8	19	175	PGJ


- 1) 材质: AISI 316L
- 2) 接液部件的表面光洁度为 $R_a < 0.8 \mu\text{m}$ ($31.5 \mu\text{in}$), 包括 Alloy C276 合金、Monel 蒙乃尔、钽、金或 PTFE 材质的法兰 (所有标准) 突面。更高表面光洁度可通过特殊选型订购。
- 3) 法兰突面材质与膜片材质相同。
- 4) Configurator 产品选型软件, 订购选项“过程连接”
- 5) 法兰尺寸的字母数字代号。
- 6) 部件压力等级的字母数字代号。

膜片最大直径: $\varnothing d_M$

A ¹⁾	K ²⁾	$\varnothing d_M$ (mm)					
		316L TempC	316L	Alloy C276 合金	钽	蒙乃尔 (Alloy 400 合金)	PTFE
50 A	10 K	-	52	62	60	59	-
80 A	10 K	-	80	-	-	-	-
100 A	10 K	-	80	-	-	-	-

- 1) 法兰尺寸的字母数字代号。
- 2) 部件压力等级的字母数字代号。

温度隔离器，ISO228 螺纹，ASME 螺纹，DIN13 螺纹，隔膜密封系统，316L 和 TempC 膜片材质

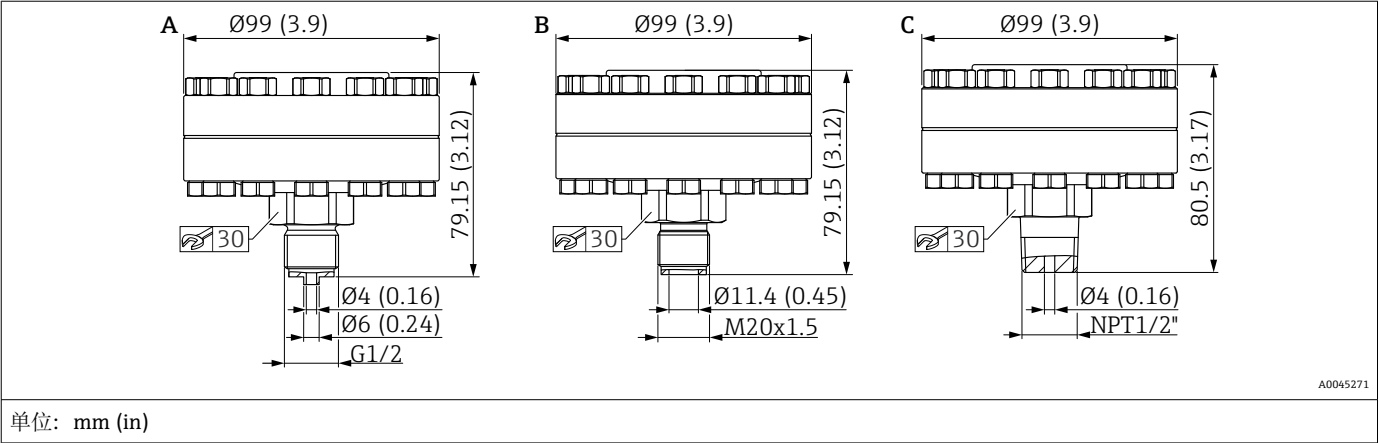

图号	说明	材质	测量范围	PN	选型代号 ¹⁾
			bar (psi)		
A	ISO 228 G $\frac{1}{2}$ EN 837 螺纹，带金属密封圈（镀银），-60 ... +400 °C (-76 ... +752 °F)	AISI 316L, A4 螺纹	≤ 100 (1450)	PN 100	W3J
B	DIN13 M20x1.5 螺纹，带金属密封圈（镀银），-60 ... +400 °C (-76 ... +752 °F)	AISI 316L, A4 螺纹	≤ 100 (1450)	PN 100	X4J
C	ASME MNPT $\frac{1}{2}$ 螺纹，带金属密封圈（镀银），-60 ... +400 °C (-76 ... +752 °F)	AISI 316L, A4 螺纹	≤ 100 (1450)	PN 100	V3J

1) Configurator 产品选型软件，订购选项“过程连接”

重量

外壳

重量参数包含电子部件和显示单元。

- 双腔室外壳
 - 铝: 1.4 kg (3.09 lb)
 - 不锈钢: 3.3 kg (7.28 lb)
- 双腔室外壳, L 型: 1.7 kg (3.75 lb)

分体式传感器（分离型外壳）

- 外壳: 参见“外壳”章节
- 外壳接头: 0.55 kg (1.21 lb)
- 过程转接头: 0.36 kg (0.79 lb)
- 电缆:
 - PE 电缆, 2 米长度: 0.18 kg (0.40 lb)
 - PE 电缆, 5 米长度: 0.35 kg (0.77 lb)
 - PE 电缆, 10 米长度: 0.64 kg (1.41 lb)
 - FEP 电缆, 5 米长度: 0.62 kg (1.37 lb)
- 安装架: 0.46 kg (1.01 lb)

传感器的主体重量（包括侧法兰和紧固部件）

3.3 kg (7.28 lb)

温度隔离器

- 短温度隔离器: 0.22 kg (0.49 lb)
- 长温度隔离器: 0.40 kg (0.88 lb)

毛细管

- 316L 材质标准毛细管护套:
0.16 kg/m (0.35 lb/m) + 0.2 kg (0.44 lb)
(每根毛细管的重量, 按 m 计算)
- 316 L 材质毛细管护套, 带 PVC 涂层:
0.21 kg/m (0.46 lb/m) + 0.2 kg (0.44 lb)
(每根毛细管的重量, 按 m 计算)
- 毛细管, 316 L, 带 PTFE 护套:
0.29 kg/m (0.64 lb/m) + 0.2 kg (0.44 lb)
(每根毛细管的重量, 按 m 计算)

过程连接

重量 ¹⁾		选型代号 ²⁾
标准型	隔膜密封系统	
2.40 kg (5.29 lb)	2.50 kg (5.51 lb)	ADJ
3.20 kg (7.06 lb)	3.40 kg (7.50 lb)	AQJ
4.90 kg (10.80 lb)	5.10 kg (11.25 lb)	AFJ
6.70 kg (14.77 lb)	7.00 kg (15.44 lb)	ASJ
7.10 kg (15.66 lb)	7.20 kg (15.88 lb)	AGJ
11.60 kg (25.88 lb)	11.70 kg (25.80 lb)	ATJ
-	4.30 kg (9.48 lb)	A0J
-	8.60 kg (18.96 lb)	A1J
-	13.30 kg (29.33 lb)	BAJ
-	10.30 kg (22.71 lb)	BFJ
-	15.80 kg (34.84 lb)	BLJ
-	12.40 kg (27.30 lb)	COJ
-	3.84 kg (8.47 lb)	CJJ
-	4.16 kg (9.17 lb)	CKJ
-	4.47 kg (9.86 lb)	CLJ
-	4.77 kg (10.52 lb)	CMJ
-	6.0 kg (13.20 lb)	CSJ
-	6.60 kg (14.50 lb)	CTJ
-	7.10 kg (15.70 lb)	CUJ
-	7.80 kg (17.20 lb)	CVJ
-	8.60 kg (19.00 lb)	CWJ
-	9.90 kg (21.80 lb)	CXJ
-	11.20 kg (24.70 lb)	CZJ
-	7.60 kg (16.76 lb)	E5J
-	5.65 kg (12.46 lb)	ETJ
-	4.52 kg (9.97 lb)	FGJ
-	8.85 kg (19.51 lb)	FPJ
-	13.30 kg (29.33 lb)	FQJ
2.35 kg (5.18 lb)	2.35 kg (5.18 lb)	H2J
3.20 kg (7.06 lb)	3.20 kg (7.06 lb)	H3J
5.54 kg (12.22 lb)	5.54 kg (12.22 lb)	H5J
-	3.44 kg (7.59 lb)	JNJ
-	3.80 kg (8.40 lb)	JPJ

重量 ¹⁾		选型代号 ²⁾
标准型	隔膜密封系统	
-	4.10 kg (9.04 lb)	JQJ
-	4.40 kg (9.70 lb)	JRJ
-	6.20 kg (13.70 lb)	JSJ
-	6.70 kg (14.80 lb)	JTJ
-	7.27 kg (16.03 lb)	JUJ
-	7.80 kg (17.20 lb)	JUV
-	6.07 kg (13.38 lb)	MCJ
-	1.30 kg (2.87 lb)	N1J
-	2.30 kg (5.07 lb)	N3J
-	3.10 kg (6.84 lb)	N4J
-	1.30 kg (2.87 lb)	NRJ
-	2.30 kg (5.07 lb)	NTJ
-	3.10 kg (6.84 lb)	NUJ
2.30 kg (5.07 lb)	-	PDJ
3.30 kg (7.28 lb)	-	PFJ
4.40 kg (9.70 lb)	-	PGJ
2.35 kg (5.18 lb)	-	V3J
0.38 kg (0.84 lb)	-	VJJ
0.41 kg (0.90 lb)	-	VJC
0.70 kg (1.54 lb)	-	VLJ
0.76 kg (1.68 lb)	-	VLC
2.35 kg (5.18 lb)	-	W3J
0.35 kg (0.77 lb)	-	WLJ
0.38 kg (0.84 lb)	-	WLC
0.73 kg (1.61 lb)	-	WNJ
0.79 kg (1.74 lb)	-	WNC
1.20 kg (2.65 lb)	-	WPJ
1.30 kg (2.87 lb)	-	WPC
1.10 kg (2.43 lb)	-	VMJ
1.19 kg (2.62 lb)	-	VMC
2.30 kg (5.07 lb)	-	X4J

1) 包括传感器组件和过程连接的总重量。

2) Configurator 产品选型软件，订购选项“过程连接”

附件

安装架: 0.5 kg (1.10 lb)

接液部件材质

膜片材质

- 316L (1.4435)
- 316L (1.4435) , TempC
TempC 膜片即“温度补偿膜片”
与常规系统相比, 此类膜片可以有效避免环境温度和过程温度变化对隔膜密封系统的影响
- Alloy C276 合金
法兰突面材质与膜片材质相同
对于带颈法兰连接型仪表, 法兰突面为 316L 材质
 - 使用 EN 1092-1 法兰时, 材质为 316L
 - 使用 ASME 法兰时, 材质为 F316/316L
- 钽
法兰突面材质与膜片材质相同
- Monel 蒙乃尔 (Alloy 400 合金)
法兰突面材质与膜片材质相同

膜片涂层

- PTFE, 0.25 mm (0.01 in)
PTFE 涂层仅适用常规膜片
- 金涂层, 厚度 25 µm
TempC 镀金膜片不提供防腐保护!
金涂层仅适用 TempC 膜片

密封圈

- PTFE
- FKM (FDA 21 CFR 177.2600)
- EPDM
- FFKM
- FFKM Chemraz

过程连接

参见具体过程连接。

附件

 技术参数 (例如材质、外形尺寸或订货号) 参见《特殊文档》SD01553P。

非接液部件材质

双腔室铝外壳 (带涂层)

- 外壳: 铝 (EN AC-43400)
- 外壳涂层、外壳盖: 聚酯
- EN AC-43400 铝外壳盖, 带 Lexan 943A PC 观察窗
EN AC-443400 铝外壳盖, 带硼硅酸盐观察窗; 适用粉尘防爆和 Ex d/XP 防爆场合
- 盲盖: 铝 (EN AC-43400)
- 外壳盖密封圈材质: 氢化丁腈橡胶 (HNBR)
- 外壳盖密封圈材质: 氟硅橡胶 (FVMQ), 仅适用低温型仪表
- 插头: PBT-GF30-FR 或铝
- 插头密封圈材质: EPDM
- 铭牌: 塑料膜
- 位号牌: 塑料膜、不锈钢或用户自备

 带材料号的电缆入口可在产品选型表的订购选项“电气连接”中订购。

双腔室 316L 外壳

- 外壳: AISI 316L 不锈钢 (1.4409)
不锈钢 (ASTM A351: CF3M (铸钢等同于 AISI 316L 材质) / DIN EN 10213: 1.4409)
- 盲盖: AISI 316L (1.4409) 不锈钢
- 外壳盖: 不锈钢 AISI 316L (1.4409), 带硼硅酸盐观察窗
- 盖板密封圈材质: 氢化丁腈橡胶 (HNBR)
- 盖板密封圈材质: 氟硅橡胶 (FVMQ), 仅适用低温型仪表
- 插头: 不锈钢

- 插头密封圈材质: EPDM
- 铭牌: 不锈钢
- 位号牌: 塑料膜、不锈钢或用户自备



带材料号的电缆入口可在产品选型表的订购选项“电气连接”中订购。

L 型双腔体铝外壳 (带涂层)

- 外壳: 铝 (EN AC-43400)
- 外壳涂层、外壳盖: 聚酯
- EN AC-43400 铝外壳盖, 带 Lexan 943A PC 观察窗
- EN AC-443400 铝外壳盖, 带硼硅酸盐观察窗; 适用粉尘防爆和 Ex d/XP 防爆场合
- 盲盖: 铝 (EN AC-43400)
- 外壳盖密封圈材质: 氢化丁腈橡胶 (HNBR)
- 外壳盖密封圈材质: 氟硅橡胶 (FVMQ), 仅适用低温型仪表
- 插头: PBT-GF30-FR 或铝
- 插头密封圈材质: EPDM
- 铭牌: 塑料膜
- 位号牌: 塑料膜、不锈钢或用户自备



带材料号的电缆入口可在产品选型表的订购选项“电气连接”中订购。

电气连接

M20 接头 (塑料)

- 材质: PA
- 缆塞密封圈: EPDM
- 堵头: 塑料

M20 接头 (镀镍黄铜)

- 材质: 镀镍黄铜
- 缆塞密封圈: EPDM
- 堵头: 塑料

M20 接头 (316L)

- 材质: 316L
- 缆塞密封圈: EPDM
- 堵头: 塑料

M20 接头 (316L), 卫生型

- 材质: 316L
- 缆塞密封圈: EPDM

M20 螺纹

设备标配 M20 螺纹接头。

运输堵头: LD-PE

G ½ 螺纹

设备标配 M20 螺纹接头, 随箱包装中提供 G ½ 螺纹转接头及配套文档资料 (铝外壳、316L 外壳、卫生型外壳), 或已安装 G ½ 螺纹转接头 (塑料外壳)。

- 转接头: PA66-GF、铝或 316L (取决于订购的外壳类型)
- 运输堵头: LD-PE

NPT ½ 螺纹

设备标配 NPT ½ 螺纹接头 (铝外壳、316L 外壳), 或已安装 NPT ½ 螺纹转接头 (塑料外壳、卫生型外壳)。

- 转接头: PA66-GF 或 316L (取决于订购的外壳类型)
- 运输堵头: LD-PE

NPT ¾ 螺纹

设备标配 NPT ¾ 螺纹接头。

运输堵头: LD-PE

M20 接头 (塑料, 蓝色)

- 材质: PA (蓝色)
- 缆塞密封圈: EPDM
- 堵头: 塑料

M12 插头

- 材质: 镀镍 CuZn 或 316L (取决于订购的外壳类型)
- 运输防护帽: LD-PE

HAN7D 插头

材质：铝、压铸锌、钢

ISO44000 M16 霍斯曼插头

- 材质：PA6
- 运输堵头：LD-PE

分离型外壳

- 安装架
 - 安装架：AISI 316L (1.4404)
 - 螺丝和螺母：A4-70
 - 半壳：AISI 316L (1.4404)
- 分离型外壳上的电缆密封圈：EPDM
- 分离型外壳上的缆塞：AISI 316L (1.4404)
- 分离型外壳上的 PE 电缆：耐磨损电缆，采用可消除应力的 Dynema 材质；铝箔屏蔽层；聚乙烯 (PE-LD) 绝缘层，黑色；铜双绞线，抗 UV 紫外老化
- 分离型外壳上的 FEP 电缆：耐磨损电缆；镀锌钢丝网屏蔽；氟化乙烯丙烯 (FEP) 绝缘层，黑色；铜双绞线，抗 UV 紫外老化
- 分离型外壳上的过程转接头：AISI 316L (1.4404)

填充液

填充液（隔膜密封系统）：

- 硅油，FDA 21 CFR 175.105 认证
- 植物油，FDA 21 CFR 172.856 认证
- 高温油
- 低温油
- 惰性油

压力传感器的填充液

PMD78B	说明	选型代号 ¹⁾
毛细管安装在低压侧 (LP)	硅油	标准型（不选择选型代号）。
	惰性油，去除水性油漆干扰物 (PWIS)	HC
毛细管未安装在低压侧 (LP)	硅油	标准型（不选择选型代号）。
	惰性油，氧气清洗	HB
	惰性油，去除水性油漆干扰物 (PWIS)	HC

1) Configurator 产品选型软件，订购选项“服务”

连接部件

- 外壳与过程连接的连接部件：AISI 316L (1.4404)
- 螺丝和螺母
 - PN 160: DIN 931-M12x90-A4-70 六角螺栓
 - PN 160: DIN 934-M12-A4-70 六角螺母
- 传感器主体：AISI 316L (1.4404)
- 温度隔离器：AISI 316L (1.4404)
- 侧法兰：AISI 316/316L (1.4408) / CF3M（相当于 AISI 316L 材质的铸件）
- 热缩护套管（仅适用带 PVC 涂层或 PTFE 护套的毛细管）：聚烯烃

毛细管护套**AISI 316L**

- 毛细管：AISI 316 Ti (1.4571)
- 毛细管保护软管：AISI 316L (1.4404)

PVC 涂层

- 毛细管：AISI 316 Ti (1.4571)
- 毛细管保护软管：AISI 316L (1.4404)
- 涂层：PVC
- 毛细管接合点的热缩管：聚烯烃

PTFE 护套

- 毛细管: AISI 316 Ti (1.4571)
- 毛细管保护软管: AISI 316L (1.4404)
- 护套: PTFE
- 单耳卡箍: 1.4301

附件



技术参数（例如材质、外形尺寸或订货号）参见《特殊文档》SD01553P。

可操作性

操作方式

针对用户特定测量任务的操作菜单结构

- 设置向导
- 诊断
- 应用
- 系统

调试快速安全

- 提供带图形用户界面的交互式设置向导，通过 FieldCare、DeviceCare 或基于 DTM、AMS 和 PDM 的工具或 SmartBlue 引导用户完成调试
- 引导式菜单，内置各个参数的简要说明
- 在设备上操作和通过调试软件操作的方法相同
- PROFINET + Ethernet-APL 通信：通过网页服务器访问设备

内置 HistoROM 数据存储单元

- 即使更换电子模块也能保证转移各项参数设置
- 设备中最多记录 100 条事件信息

高效诊断提高测量的可靠性

- 纯文本显示的补救措施
- 多种仿真选项


蓝牙模块（可选安装在现场显示单元中）

- 使用 SmartBlue app 或安装有 DeviceCare（版本 1.07.00 或更高版本）或 FieldXpert SMT70 的个人计算机简单快速设置设备
- 无需使用其他工具或转接头
- 使用 Bluetooth® 蓝牙无线技术，实现加密点对点单向数据传输（通过 Fraunhofer 研究所测试）和带密码保护的通信

现场操作

电子插件上的操作按键和 DIP 开关

HART

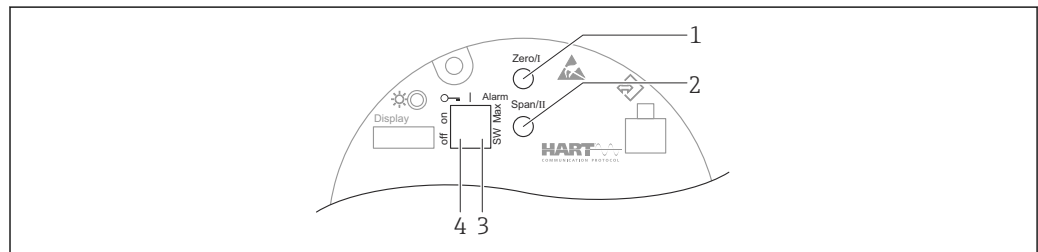


A0039285

- 1 操作按键，量程下限（Zero）设置
- 2 操作按键，量程上限（Span）设置
- 3 DIP 开关，报警电流设置
- 4 DIP 开关，锁定和解锁仪表

i 相对于其他操作方式（例如 FieldCare/DeviceCare），通过 DIP 开关进行的设置具有最高优先级。


具有 Ethernet-APL 功能的 PROFINET

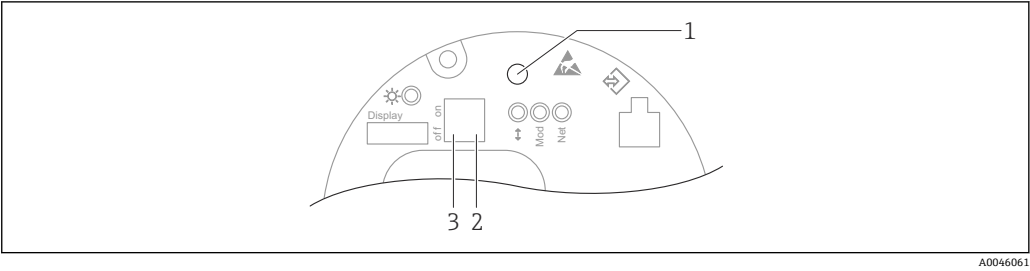

- 1 操作按键，位置调整（调零）和设备复位
- 2 DIP 开关，设置服务 IP 地址
- 3 DIP 开关，锁定和解锁仪表

i 相对于其他操作方式（例如 FieldCare/DeviceCare），通过 DIP 开关进行的设置具有最高优先级。

PROFIBUS PA

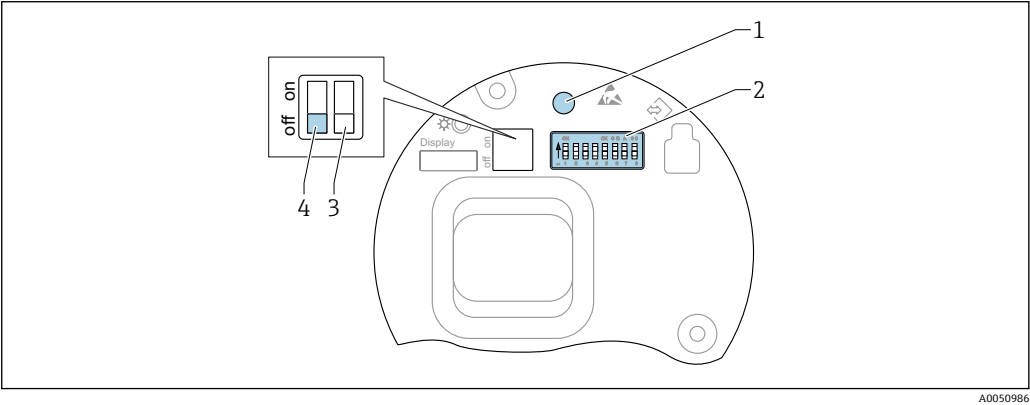

- 1 操作按键，用于零位调整（调零）、复位设备（复位）和密码（Bluetooth 蓝牙登陆和用户角色切换）
- 2 DIP 开关，用于地址设置
- 3 DIP 开关，无功能
- 4 DIP 开关，锁定和解锁仪表

i 相对于其他操作方式（例如 FieldCare/DeviceCare），通过电子插件上的 DIP 开关进行的设置具有最高优先级。


现场显示单元

设备显示单元（可选）

功能:

- 显示测量值、故障信息和提示信息
- 发生故障时背光显示从绿色切换至红色
- 设备显示单元可以拆除，方便后续操作
- 双腔室外壳（L 型）的两个部分（顶部和侧面）均可安装设备显示单元。

i 可以在仪表显示单元的附加选项中选择 Bluetooth® 蓝牙无线技术。

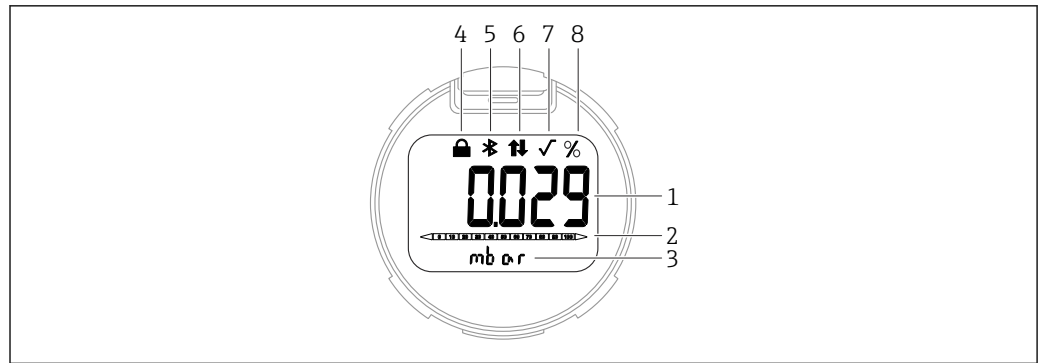


A0047143

图 7 段码显示屏

- 1 测量值 (最多 5 位)
- 2 与电流输出成正比的棒图 (指设计压力范围) (不适用 PROFINET+Ethernet-APL 或 PROFIBUS PA)
- 3 测量值单位
- 4 锁定 (仪表锁定时显示此图标)
- 5 蓝牙功能 (蓝牙连接时此图标闪烁)
- 6 HART 通信、PROFINET + Ethernet-APL 通信或 PROFIBUS PA 通信 (开启通信时出现此图标)
- 7 开平方 (使用开平方输出测量值时出现此图标) PROFINET + Ethernet-APL 或 PROFIBUS PA 不支持此功能
- 8 电流输出测量值 (百分比单位)

下图为示例。显示内容取决于实际设置。

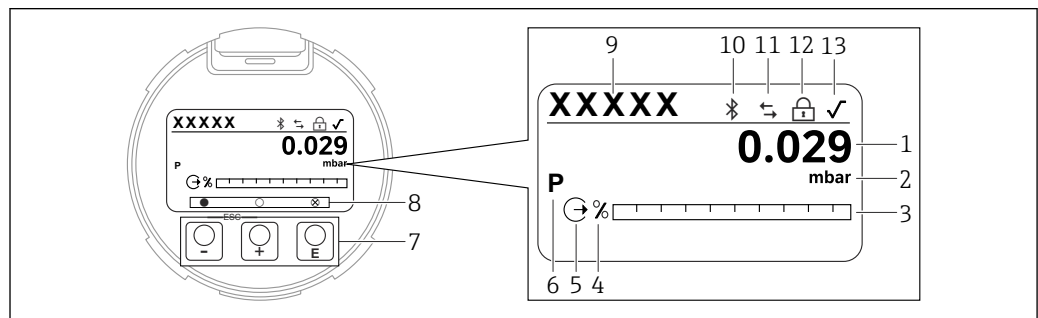


A0047141

图 8 图形显示屏，带光敏键。

- 1 测量值 (最多 12 位)
- 2 测量值单位
- 3 与电流输出成正比的棒图 (指设计压力范围) (不适用 PROFINET+Ethernet-APL 或 PROFIBUS PA)
- 4 棒图单位
- 5 电流输出图标 (不适用 PROFINET + Ethernet-APL 或 PROFIBUS PA)
- 6 显示测量值图标 (例如 p = 压力)
- 7 光敏键
- 8 按键反馈图标。可选不同显示图标: 圆圈 (空心) = 短按按键; 圆圈 (实心) = 长按按键; 圆圈 (带 X) = 蓝牙连接状态下无法操作
- 9 设备位号
- 10 蓝牙功能 (蓝牙连接时此图标闪烁)
- 11 HART 通信、PROFINET + Ethernet-APL 通信或 PROFIBUS PA 通信 (开启通信时出现此图标)
- 12 锁定 (仪表锁定时显示此图标)
- 13 开平方 (使用开平方输出测量值时出现此图标) PROFINET + Ethernet-APL 或 PROFIBUS PA 不支持此功能

远程操作

通过 HART 通信或蓝牙

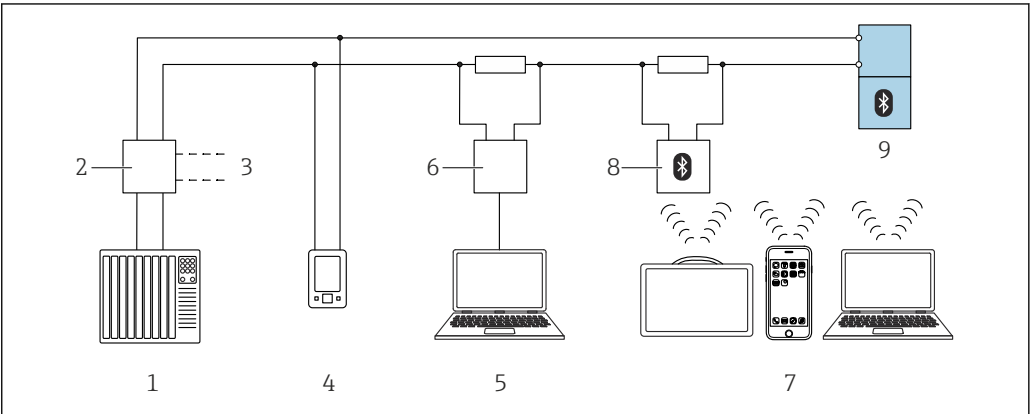


A0044334

图 9 通过 HART 通信进行远程操作

- 1 PLC (可编程逻辑控制器)
- 2 变送器供电单元, 例如 RN221N (含通信电阻)
- 3 连接 Commubox FXA195 和 AMS Trex™ 设备通讯器
- 4 AMS Trex™ 设备通讯器
- 5 计算机, 安装有调试软件 (例如 DeviceCare/FieldCare、AMS Device View、SIMATIC PDM)
- 6 Commubox FXA195 (USB)
- 7 Field Xpert SMT70/SMT77、智能手机或计算机, 安装有调试软件 (例如 DeviceCare/FieldCare、AMS Device View、SIMATIC PDM)
- 8 蓝牙调制解调器, 带连接电缆 (例如 VIATOR)
- 9 变送器

通过 PROFINET + Ethernet-APL 网络

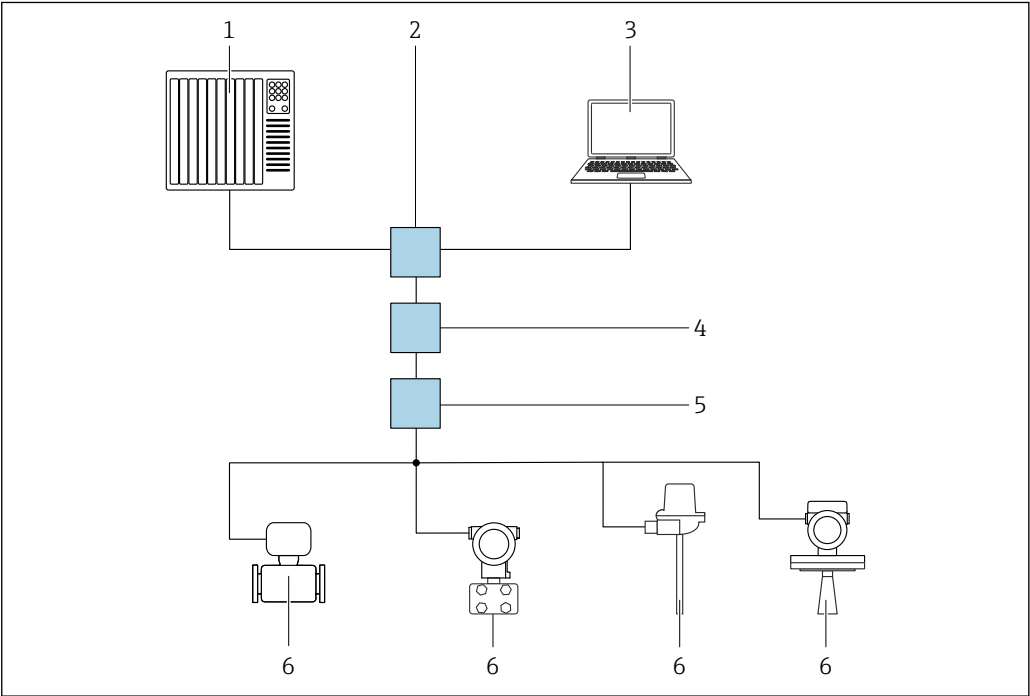

A0046097

图 10 通过 PROFINET + Ethernet-APL 网络实现远程操作: 星形拓扑结构

- 1 自动化系统, 例如 Simatic S7 (西门子)
- 2 以太网交换机
- 3 计算机, 安装有网页浏览器 (例如 Microsoft Edge), 用于访问设备自带网页服务器; 或安装有调试软件 (例如 FieldCare、DeviceCare、SIMATIC PDM), 带 iDTM PROFINET 通信
- 4 APL 电源交换机 (选配)
- 5 APL 现场交换机
- 6 APL 现场设备


通过联网计算机进入网站。必须知晓仪表的 IP 地址。

可以选择其他方式将 IP 地址分配至仪表：

- 动态配置协议（DHCP），出厂设置
自动化系统（例如 Siemens S7）自动为仪表分配 IP 地址。
- 软件地址设定
在 IP 地址参数中输入 IP 地址。
- 服务 DIP 开关
仪表固定 IP 地址为 192.168.1.212。
 重启后才会应用 IP 地址。
现在可以使用 IP 地址建立网络连接。

默认设置：仪表使用动态配置协议（DHCP）。自动化系统（例如 Siemens S7）自动为仪表分配 IP 地址。

通过 PROFIBUS PA 通信

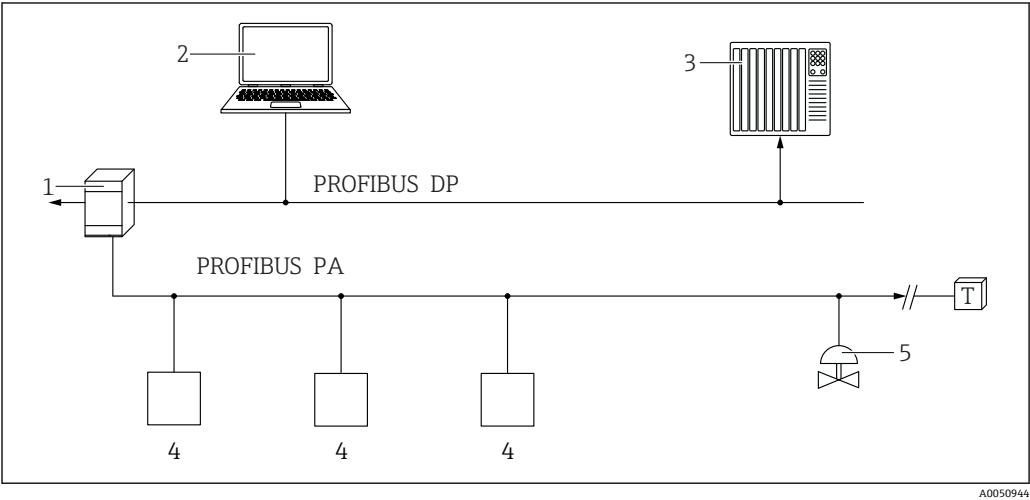

- 1 段耦合器
- 2 计算机，安装有 PROFIusb 和调试软件（例如 DeviceCare/FieldCare）
- 3 PLC（可编程逻辑控制器）
- 4 变送器
- 5 附加功能部件（阀等）

通过网页浏览器（适于带 PROFINET 的设备）

功能范围

通过内置网页服务器的网页浏览器操作和设置设备。操作菜单的结构与现场显示单元菜单结构相同。除了显示测量值外，还显示设备状态信息，用户可以监测设备状态。此外还可以管理设备参数和设置网络参数。

通过服务接口（CDI）

使用 Commubox FXA291 将仪表 CDI 接口连接至 Windows 个人计算机或笔记本电脑的 USB 端口。

通过 Bluetooth® 蓝牙无线技术操作（可选）

前提条件

- 仪表，安装有带 Bluetooth 蓝牙功能的显示单元
- 智能手机或平板电脑（安装有 Endress+Hauser SmartBlue App）、个人计算机（安装有 1.07.00 或更高版本的 DeviceCare）或 FieldXpert SMT70

蓝牙有效传输范围为 25 m (82 ft)。传输范围取决于环境条件，例如固定装置、墙壁或天花板。

 设备通过蓝牙连接后，显示单元上的操作按键即被锁定。

PROFINET + Ethernet-APL

PROFINET Profile 4.02

PROFIBUS PA

PROFIBUS PA Profile 3.02

配套调试软件	安装有 Endress+Hauser SmartBlue (app)、DeviceCare (1.07.00 或更高版本) 、FieldCare、DTM、AMS 和 PDM 的智能手机或平板电脑。 安装有网页服务器的个人计算机，通过现场总线操作。
HistoROM	更换电子插件时，可通过重新连接 HistoROM 传输存储数据。没有 HistoROM 模块，设备将无法工作。 设备序列号保存在 HistoROM 模块中。电子模块序列号保存在电子模块中。

证书和认证

产品证书与认证的最新信息进入产品主页查询 (www.endress.com)：

1. 点击“产品筛选”按钮，或在搜索栏中直接输入基本型号，选择所需产品。
2. 打开产品主页。
3. 选择**资料下载**。

CE 认证	仪表符合相关 EC 指令的法律要求。Endress+Hauser 确保贴有 CE 标志的仪表均成功通过了所需测试。
RCM-Tick 认证	随箱包装中的产品或测量系统符合 ACMA（澳大利亚通讯及媒体局）制定的网络完整性、互操作性、性能参数以及健康与安全法规要求。同时还满足电磁兼容性要求。产品铭牌上带有 RCM-Tick 标志。  A0029561
防爆认证	■ ATEX ■ CSA ■ NEPSI ■ UKCA ■ INMETRO ■ KC ■ EAC ■ JPN ■ 组合认证 防爆参数单独成册，用户可按需索取。防爆手册是所有防爆型设备的标准随箱资料。其他认证申请中。 防爆型智能手机和平板电脑 在防爆危险区中仅允许使用防爆型移动终端设备。
腐蚀测试	标准和测试方法： ■ 316L 不锈钢：ASTM A262 Practice E 和 ISO 3651-2 Method A ■ Alloy C22 合金和 Alloy C276 合金：ASTM G28 Practice A 和 ISO 3651-2 Method C ■ 22Cr 双相不锈钢、25Cr 双相不锈钢：ASTM G48 Practice A 或 ISO 17781 和 ISO 3651-2 Method C 接液部件和承压部件均通过腐蚀测试。 必须订购 3.1 材料检测证书，作为通过测试的凭证。
EAC 符合性声明	设备符合 EAC 准则的法律要求。详细信息参见相应 EAC 符合性声明和适用标准。 Endress+Hauser 确保贴有 EAC 标志的设备均成功通过了所需测试。
溢出保护系统	仪表遵循德国水资源法 (WHG) 第 63 节规定的溢出保护装置认证指南 (ZG-US:2012-07) 测试。
功能安全性 SIL/ IEC 61508 一致性声明	带 4...20 mA 输出信号的仪表遵循 IEC 61508 标准设计。仪表用于过程液位和压力监测，最高可实现 SIL 3 功能安全等级。安全功能、设置和功能安全参数的详细信息参见《功能安全手册》。
船级社认证	■ ABS (美国航运局) ■ LR (英国船级社) ■ BV (法国船级社) ■ DNV GL (挪威船级社/德国船级社)
无线电认证	带 Bluetooth 蓝牙功能 (低功耗) 的显示单元已通过无线电认证，符合 CE 和 FCC 法规。显示单元上提供相关认证信息及标签。

CRN 认证	部分设备型号通过 CRN 认证（加拿大认证号）。CRN 认证型设备带有专用铭牌，上面标识有认证号 CRN 0F24854.5C。如需 CRN 认证设备，请同时订购 CRN 认证过程连接，并在“其他认证”中选择订货号 CRN。
测试报告	测试、证书、声明 ■ EN 10204 - 3.1 材质证书（金属接液部件材质证书） 此选型代号针对带涂层膜片/过程连接，表示金属基材。 ■ NACE MR0175 / ISO 15156（金属接液部件）、声明 ■ NACE MR0103 / ISO 17945（金属接液部件）、声明 ■ AD 2000（金属接液部件）、声明，不包括膜片 ■ ASME B31.3 过程管道、声明 ■ ASME B31.1 动力管道、声明 ■ 变送器环境温度（-50 ... +85 °C (-58 ... +185 °F)）；传感器部分参见规格参数 ■ 变送器环境温度（-54 ... +85 °C (-65 ... +185 °F)）；传感器部分参见规格参数 ■ 压力测试、内部程序、测试报告 ■ 氮气泄漏测试、内部程序、测试报告 ■ 光谱现场测试 (PMI)、内部程序（接液金属部件）、测试报告 ■ 焊接文档、接液/压缝、声明 进入设备浏览器查询所有电子版测试报告、声明和检测证书：输入铭牌上的序列号（https://www.endress.com/de/pages/supporting-tools/device-viewer）。 适用订购选项“标定”和“测试、证书”。 印刷版产品文档 可以订购印刷版测试报告、声明和检验证书（订购选项“印刷版产品文档”）。这些文档可随产品一同订购。 标定 五点标定证书 十点标定证书，ISO/IEC 17025 溯源认证 制造商声明 登陆 Endress+Hauser 公司网站可下载多种制造商声明。其他制造商声明可通过 Endress+Hauser 当地销售中心订购。 下载符合性声明 www.endress.com → 资料下载
压力设备指令 2014/68/EU	最大允许压力不超过 200 bar (2 900 psi) 的压力设备 压力设备指令 2014/68/EU 规定：最大工作压力 PS 不超过 200 bar (2 900 psi) 的压力设备被列为压力组件。如果设备的最大工作压力不超过 200 bar (2 900 psi)，且设备体积不超过 0.1 L，压力设备需要符合压力设备指令的要求（参见压力设备指令 2014/68/EU 4.3 条款）。压力设备指令要求压力设备必须基于成员国的工程实践经验设计和制造。 参考标准： ■ 压力设备指令 (PED) 2014/68/EU 4.3 条款 ■ 压力设备指令 2014/68/EU，欧盟委员会“压力设备”工作组发布的 A-05 和 A-06 准则 注意： 安装在安全仪表系统中的压力仪表需要单独检查，保护管道或罐体，防止压力超出允许范围（压力设备指令 2014/68/EU 2.4 条款列举的安全功能设备）。
氧气应用场合（选配）	已通过验证和清洗，适用氧气 (O ₂) 应用场合（接液部件）
中国 RoHS 认证	仪表带有明确标识，符合 SJ/T 11363-2006 法规（中国 RoHS 认证）。
RoHS 认证	测量系统符合危险物质限制准则 2011/65/EU (RoHS 2) 的要求。

PROFINET + Ethernet-APL 认证

PROFINET + Ethernet-APL 接口

设备通过 PROFIBUS 用户组织 (PNO) 的认证和注册。完全符合以下标准的要求:

- 认证符合:
 - PROFINET 设备的测试规范
 - PROFINET 安全等级 – 网络负载等级
- 设备可以与其他供应商生产的认证型设备配套使用 (互操作性)

其他认证

电气系统和 (可燃和易燃) 过程流体间的过程密封件的等级符合 UL 122701 标准 (前身为 ANSI/ISA 12.27.01 标准)

Endress+Hauser 设备符合 UL 122701 标准 (旧标准名称: ANSI/ISA 12.27.01), 这表示用户无需为管道提供二次过程密封, 满足 ANSI/NFPA 70 (NEC) 和 CSA 22.1 (CEC) 要求, 节约安装成本。设备符合北美安装使用要求, 是安全经济的危险介质带压应用的安装方案。设备采用“单层密封”, 通过下列认证:

CSA C/US IS, XP, NI:

最高 160 bar (2 400 psi)。

详细信息参见相关设备的控制图示。

计量认证

如果选择“中国”订购选项, 设备出厂时带中文铭牌, 符合《中华人民共和国产品质量法》。

订购信息

订购信息

详细订购信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心 (www.addresses.endress.com)，或登陆网站 www.endress.com 进入 Product Configurator 产品选型软件查询：

1. 点击“产品筛选”按钮，或在搜索栏中直接输入基本型号，选择所需产品。
2. 打开产品主页。

点击配置按钮，打开 Configurator 产品选型软件。



Product Configurator: 产品选型工具

- 最新设置参数
- 取决于设备型号：直接输入测量点参数，例如测量范围或显示语言
- 自动校验排他选项
- 自动生成订货号及其明细，PDF 文件或 Excel 文件输出
- 通过 Endress+Hauser 在线商城直接订购

供货清单

供货清单包括：

- 仪表
- 选配附件

相关文档资料：

- 《简明操作指南》
- 《出厂检测报告》
- 防爆仪表（例如 ATEX、IECEX、NEPSI 等）的《附加安全指南》
- 可选：出厂标定表格、测试证书



登陆网站下载《操作手册》：

www.endress.com → 资料下载

服务

可通过 Configurator 产品选型软件选择以下服务。

- 除油脂清洗（接液部件）
- 已通过验证和清洗，适用氧气（O₂）应用场合（接液部件）
- 除油脂清洗（免油漆损伤物质）
（塑料防护罩不进行 PWIS 清洗）
- 外壳盖可选 ANSI 安全色（红色）涂层
- 设置 HART 突发模式（PV 值）
- 设置最大报警电流
- 出厂时关闭蓝牙通信
- 印刷版产品文档
可以订购印刷版测试报告、符合性声明和检测证书（订购选项服务，选型代号印刷版产品文档）。设备出厂后，随箱包装中提供在订购选项“测试、证书、声明”中选择的文档资料。

测量点（位号）

- 订购选项：认证图标
- 选型代号：Z1，位号（TAG），参见附加选项
- 位号牌位置：在附加选项中选择
 - 不锈钢悬挂式位号牌
 - 自粘纸标签
 - 补充位号牌
 - RFID TAG（无线射频识别标签）
 - 无线射频识别标签（RFID TAG）+ 不锈钢悬挂式位号牌
 - RFID TAG（无线射频识别标签）+ 自粘纸标签
 - 无线射频识别标签（RFID TAG）+ 随箱标签/铭牌
- 位号说明：在附加选项中选择
3 行，每行最多 18 个字符
指定位号显示在所选标签和/或无线射频识别标签（RFID TAG）中。
- 电子铭牌（ENP）标识：32 位

测试报告、声明和检验证书

在设备浏览器中查询电子版测试报告、符合性声明和检测证书：

输入铭牌上的序列号 (<https://www.endress.com/de/pages/supporting-tools/device-viewer>)



印刷版产品文档

可以订购印刷版测试报告、符合性声明和检测证书（订购选项 570 “服务”，选型代号 I7 “印刷版产品文档”）。出厂时仪表随箱包装中提供相关文档资料。

应用软件包

Heartbeat Technology 心跳技术

适用范围

适用于所有设备版本。

可选心跳自校验和心跳自监测功能。

心跳自诊断

- 设备连续自监测
- 诊断信息输出至：
 - 现场显示单元
 - 资产管理系统（例如 FieldCare 或 DeviceCare）
 - 自动化系统（例如 PLC）
 - 网页服务器

心跳自校验

- 无需中断过程即可监测已安装的设备，包括校验报告
- 清晰评估测量点（通过/未通过），测试覆盖率高，保证符合制造商规格参数
- 可以用于归档记录规范要求
- 满足 ISO 9001（ISO9001:2015 第 7.1 条款）（（HART：固件版本不低于 01.01.xx）（PROFIBUS PA：固件版本不低于 01.00.xx））标准中规定的测量溯源性要求。通过 Bluetooth 蓝牙和数字通信接口生成校验报告。

心跳自监测

- 传感器统计诊断：对压力信号（包括信号噪声）进行统计分析和评估，以检测过程是否出现异常（例如引压管堵塞）
- 回路诊断：检测测量回路电阻值升高或供电电压下降（仅带电流输出）
- 过程容限：设置用户自定义压力和温度限值，检测动态压力冲击或跟踪加热系统或保温层故障
- 向外部状态监测系统持续提供附加监测数据，用于预维护或过程监测

详细信息



参见 Heartbeat Technology 心跳技术的《特殊文档》。

附件

设备专用附件

机械附件

- 外壳安装架
- 冲洗环
- 防护罩



技术参数（例如材质、外形尺寸或订货号）参见《特殊文档》SD01553P。

插头

- M12 直角插头，5 米电缆（IP67 防护等级），接头螺母，Cu Sn/Ni
- M12 插头，接头螺母（IP67 防护等级），Cu Sn/Ni
- M12 直角插头，接头螺母（IP67 防护等级），Cu Sn/Ni



安装堵头或连接电缆，否则无法保证设计 IP 防护等级。

焊接安装附件



详细信息参见焊座、过程转接头和法兰的《技术资料》TI00426F。

设备浏览器

设备浏览器（<https://www.endress.com/de/pages/supporting-tools/device-viewer>）中列举了设备的所有备件及其订货号。

文档资料

根据具体设备型号，在 Endress+Hauser 网站的下载区（www.endress.com/downloads）中下载下列文档资料：

文档类型	文档用途和内容
《技术资料》（TI）	设备规划指南 文档包含设备的所有技术参数，以及可以随设备一起订购的附件和其他产品的简要说明。
《简明操作指南》（KA）	引导用户快速获取第一个测量值 文档包含从到货验收到初始调试的所有必要信息。
《操作手册》（BA）	参考文档资料 文档包含设备生命周期各个阶段所需的所有信息：从产品标识、到货验收和储存，至安装、电气连接、操作和调试，以及故障排除、维护和废弃。
《仪表功能描述》（GP）	菜单参数说明 文档详细介绍各个菜单参数。适用对象是在设备整个生命周期内执行操作和特定仪表设置的人员。
安全指南（XA）	取决于认证类型，还会随箱提供防爆电气设备《安全指南》。《安全指南》是《操作手册》的组成部分。  设备铭牌上标识有配套《安全指南》（XA）的文档资料代号。
设备补充文档资料（SD/FY）	必须始终严格遵守相关补充文档资料中的各项说明。补充文档是整套设备文档的组成部分。

注册商标

HART®

现场通信组织的注册商标（美国德克萨斯州奥斯汀）

PROFINET®

PROFIBUS 用户组织的注册商标（德国卡尔斯鲁厄）

PROFIBUS®

PROFIBUS 及其相关商标（协会商标、技术商标、认证商标和 PI 认证商标）是 PROFIBUS User Organization e.V.（Profibus 用户组织）（德国卡尔斯鲁厄）的注册商标

Bluetooth®蓝牙

Bluetooth®文字和图标是 Bluetooth SIG 公司的注册商标，Endress+Hauser 获得准许使用权。其他注册商标和商标名分别归相关公司所有。

Apple®

Apple、Apple 图标、iPhone 和 iPod touch 是苹果公司的注册商标，已在美国和其他国家注册登记。App Store 是苹果公司的服务商标。

Android®

Android、Google Play 和 Google Play 图标是谷歌公司的注册商标。

隔膜密封系统（中国市场），订购选项 105

本章节介绍了选择订购选项 105，选型代号“8A”...“8N”的隔膜密封型仪表的所有技术信息。未涵盖的所有其他技术信息参见本文档的其余章节。

性能参数	总体性能
	主仪表性能
	主仪表整体性能的计算方法保持不变。
	计算隔膜密封系统误差：所产生的隔膜密封系统误差与 Applicator 选型计算软件“ Sizing Diaphragm Seal ”中的数据不同。隔膜密封系统误差的影响未作进一步说明。此仪表型号无法进行特定选型计算。
	长期稳定性
	主仪表长期稳定性的影响可通过 Applicator 选型计算软件“ Sizing Pressure Performance ”确定。隔膜密封系统的影响未作进一步说明。
	总体误差
	只有在未安装隔膜密封系统的情况下，才能确定主仪表的总体误差。
	响应时间
	只有在未安装隔膜密封系统的情况下，才能确定主仪表的响应时间。隔膜密封系统的影响未作进一步说明。
过程条件	连续和交变负载能力
	此仪表型号的设计和验证符合 EN 837 的规范和要求。与 IEC 62828 相反，必须假定较低的负载电阻（温度和压力）。
	抗振性
	此仪表型号的设计和验证符合 EN 837 的规范和要求。
过程温度范围	氧气应用
	此仪表型号不得用于氧气应用。


填充液	P _{abs} = 0.05 bar (0.725 psi) ¹⁾	P _{abs} ≥ 1 bar (14.5 psi) ²⁾
硅油	-40 ... +180 °C (-40 ... +356 °F)	-40 ... +250 °C (-40 ... +482 °F)
高温油	-10 ... +200 °C (+14 ... +392 °F)	-10 ... +360 °C (+14 ... +680 °F)
低温油	-98 ... +60 °C (-144 ... +140 °F)	-98 ... +100 °C (-144 ... +212 °F)
植物油	-10 ... +160 °C (+14 ... +320 °F)	-10 ... +220 °C (+14 ... +428 °F)
惰性油	-40 ... +100 °C (-40 ... +212 °F)	-40 ... +175 °C (-40 ... +347 °F)

1) P_{abs} = 0.05 bar (0.725 psi)时的允许温度范围（注意设备和系统的允许温度范围）
2) P_{abs} ≥ 1 bar (14.5 psi)时的允许温度范围（注意设备和系统的允许温度范围）

机械结构

设计及外形尺寸

带长温度隔离器的仪表

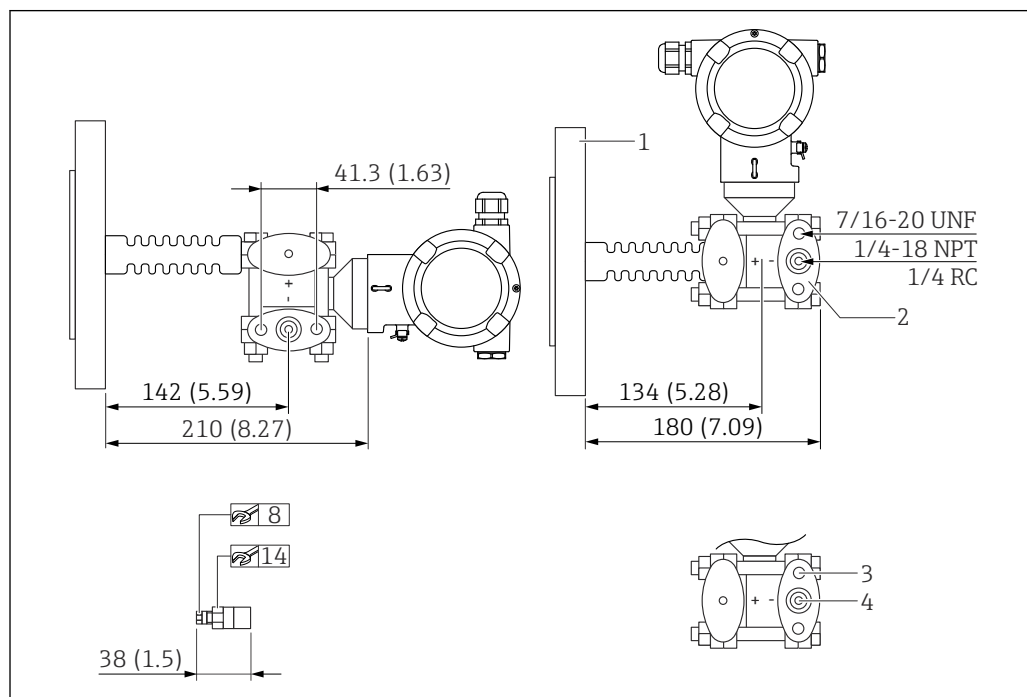


A0059261

测量单位 mm (in)

- 1 高压侧
- 2 低压侧
- 3 螺纹深度: 15 mm (0.59 in)
- 4 螺纹深度: 12 mm (0.47 in) (± 1 mm (0.04 in))

带短温度隔离器的仪表

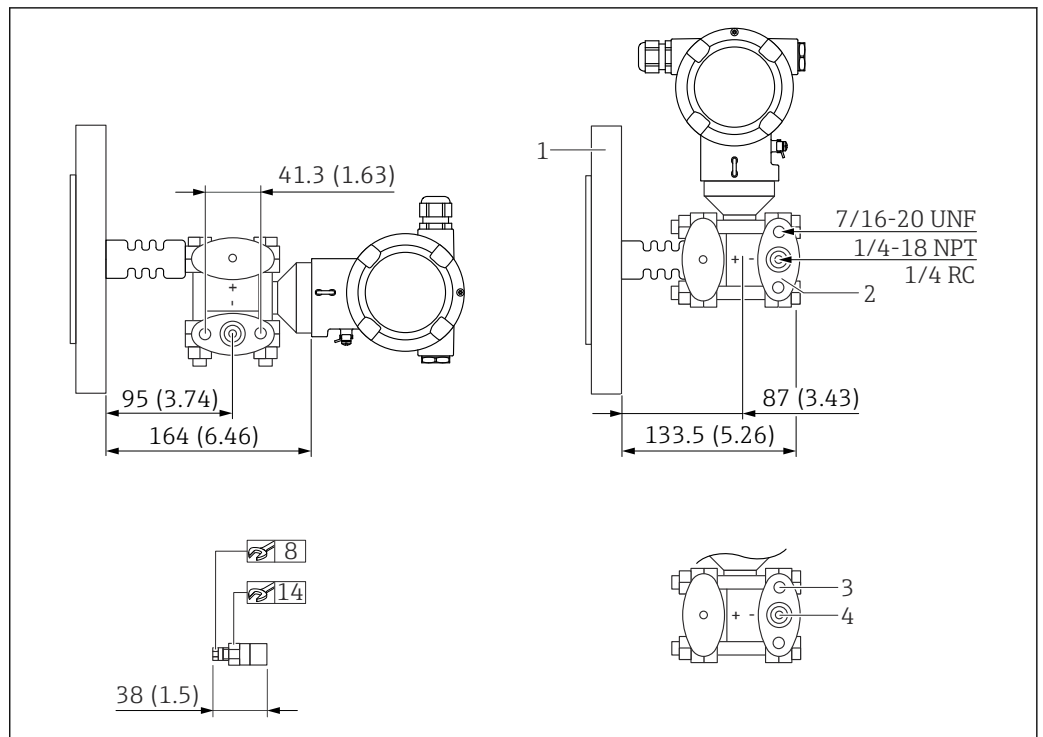


A0059262

测量单位 mm (in)

- 1 高压侧
- 2 低压侧
- 3 螺纹深度: 15 mm (0.59 in)
- 4 螺纹深度: 12 mm (0.47 in) (±1 mm (0.04 in))

外形尺寸

EN1092-1 法兰（型式 B1 和 B2），齐平安装膜片，隔膜密封系统
连接尺寸符合 EN1092-1 标准。

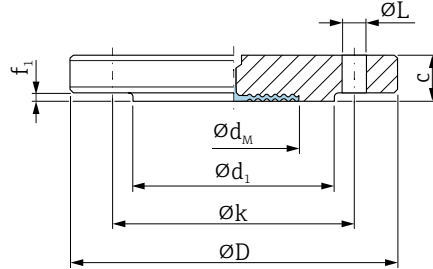

A0059092

ØD 法兰口径
c 厚度
Ød₁ 突面
f₁ 突面
Øk 螺栓圆直径
ØL 孔径
Ød_M 最大膜片直径

单位: mm (in)

法兰 ^{1) 2)}							螺栓孔			选型代号 ³⁾
DN	PN	型式	ØD	c	Ød ₁	f ₁	数量	ØL	Øk	
			mm	mm	mm	mm		mm	mm	
DN 50	PN 10...40	B1	165	20	102	2	4	18	125	H3J
DN 50	PN 63	B2	180	26	102	2	4	22	135	FGJ
DN 50	PN 100...160	B2	195	30	102	2	4	26	145	MCJ
DN 80	PN 10...40	B1	200	24	138	2	8	18	160	H5J
DN 80	PN 100	B2	230	36	138	2	8	26	180	FPJ

1) 材质: AISI 316L


2) 法兰突面材质与膜片材质相同。

3) Configurator 产品选型软件，订购选项“过程连接”

膜片最大直径 Ød_M

DN	PN	Ød _M (mm)			
		316L	Alloy C276 合金	钽	蒙乃尔 (Alloy 400 合金)
DN 50	PN 10...40	60	92	92	92
DN 50	PN 63	60	92	92	92
DN 50	PN 100...160	60	92	92	92
DN 80	PN 10...40	89	127	127	127
DN 80	PN 100	89	127	127	127

EN1092-1 法兰（型式 E），齐平安装膜片，隔膜密封系统
连接尺寸符合 EN1092-1 标准。

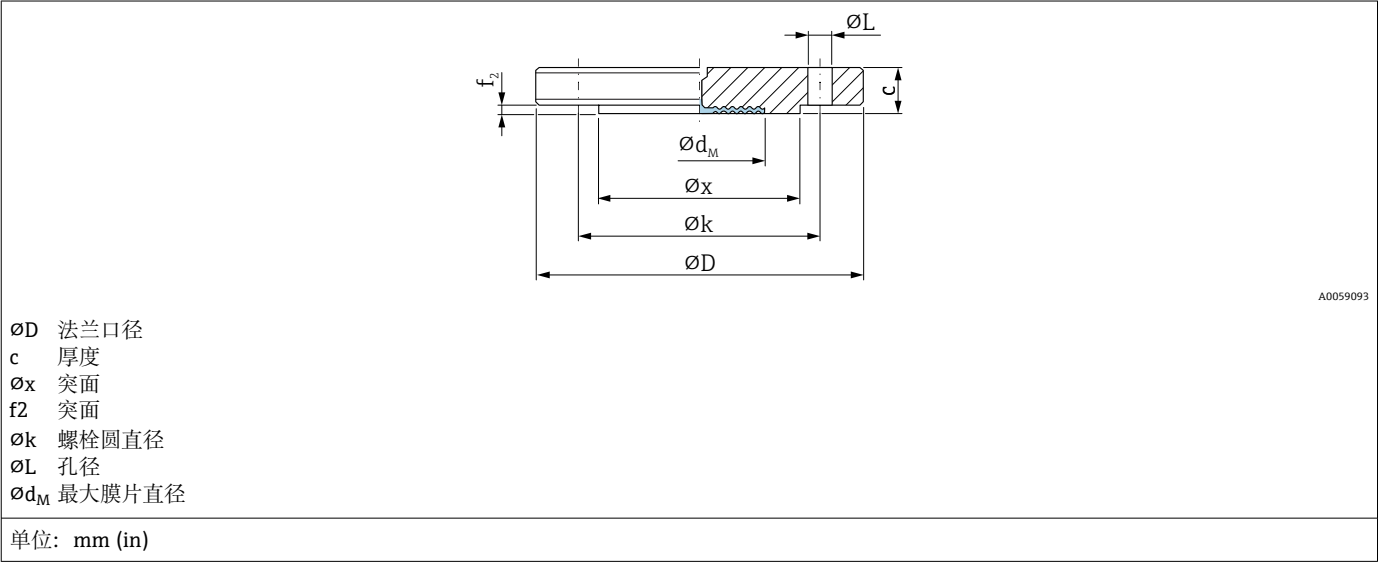


法兰 ^{1) 2)}							螺栓孔			选型代号 ³⁾
DN	PN	型式	ØD	c	Øx	f2	数量	ØL	Øk	
			mm	mm	mm	mm		mm	mm	
DN 25	PN 10...40	E	115	18	57	4.5	4	14	85	H0J
DN 50	PN 10...40	E	165	20	87	4.5	4	18	125	H3J
DN 80	PN 10...40	E	200	24	120	4.5	8	18	160	H5J

- 1) 材质: AISI 316L
2) 法兰突面材质与膜片材质相同。
3) Configurator 产品选型软件，订购选项“过程连接”

膜片最大直径 Ød_M

DN	PN	Ød _M (mm)			
		316L	Alloy C276 合金	钽	蒙乃尔 (Alloy 400 合金)
DN 50	PN 10...40	60	92	92	92
DN 80	PN 10...40	89	127	127	127

EN1092-1 法兰 (型式 F) , 齐平安装膜片, 隔膜密封系统
连接尺寸符合 EN1092-1 标准。

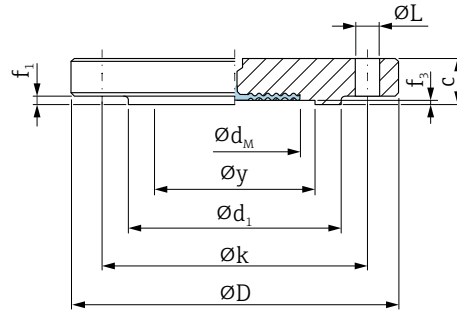

A0059094

$\varnothing D$ 法兰口径
 c 厚度
 $\varnothing d_1$ 突面
 f_1 突面
 f_3 凹槽高度
 $\varnothing k$ 螺栓圆直径
 $\varnothing L$ 孔径
 $\varnothing d_M$ 最大膜片直径

单位: mm (in)


法兰 ^{1) 2)}									螺栓孔			选型代号 ³⁾
DN	PN	型式	$\varnothing D$	c	$\varnothing d_1$	$\varnothing y$	f_1	f_3	数量	$\varnothing L$	$\varnothing k$	
			mm	mm	mm	mm	mm	mm		mm	mm	
DN 50	PN 10...40	F	165	20	102	88	3	4	4	18	125	H3J
DN 80	PN 10...40	F	200	24	138	121	3	4	8	18	160	H5J

- 1) 材质: AISI 316L
 2) 法兰突面材质与膜片材质相同。
 3) Configurator 产品选型软件, 订购选项“过程连接”

膜片最大直径 $\varnothing d_M$

DN	PN	$\varnothing d_M$ (mm)			
		316L	Alloy C276 合金	钽	蒙乃尔 (Alloy 400 合金)
DN 50	PN 10...40	60	92	92	92
DN 80	PN 10...40	89	127	127	127

ASME B16.5 法兰（型式 RF 和 LM），齐平安装膜片，隔膜密封系统
连接尺寸符合 ASME B 16.5 标准。

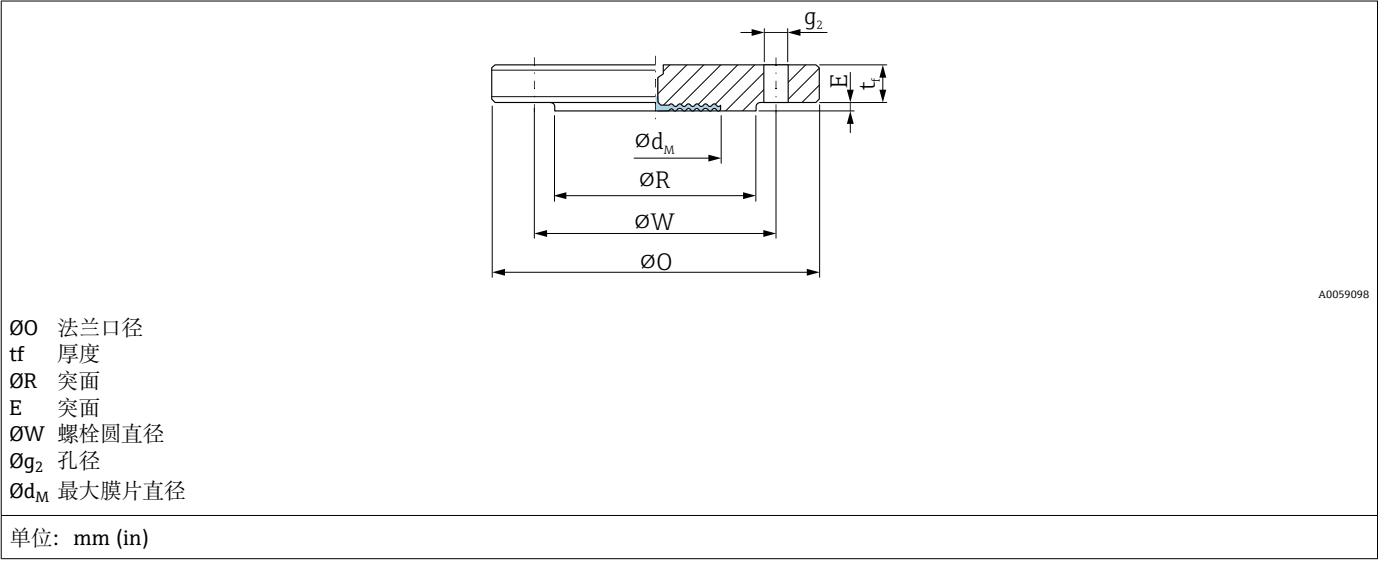


法兰 ^{1) 2)}						螺栓孔			选型代号 ³⁾
公称管道尺寸 NPS	压力等级 Class	ØO	tf	ØR	E	数量	Øg ₂	ØW	
in		in	in	in	in		in	in	
2	150	6	0.71	3.63	0.08	4	3/4	4.75	ADJ
2	300	6.5	0.81	3.63	0.08	8	3/4	5	AQJ
2	400/600	6.5	1.00	3.63	0.28	8	3/4	5	A0J
2	900/1500	8.46	1.52	3.63	0.28	8	1	6.5	BFJ
2	2500	9.25	2.01	3.63	0.28	8	1 1/8	6.75	BLJ
3	150	7.5	0.88	5	0.08	4	3/4	6	AFJ
3	300	8.23	1.06	5	0.08	8	7/8	6.63	ASJ
3	400/600	8.23	1.23	5	0.28	8	7/8	6.63	A1J
3	900	9.80	1.5	5	0.28	8	1	7.5	BAJ
3	1500	10.43	1.88	5	0.28	8	1.3	8	BGJ
3	2500	12.01	2.63	5	0.28	8	1.42	9	BMJ

1) 材质: AISI 316L
2) 法兰突面材质与膜片材质相同。
3) Configurator 产品选型软件，订购选项“过程连接”

膜片最大直径 $\varnothing d_M$

公称管道尺寸 NPS	压力等级 Class	$\varnothing d_M$ (in)			
		316L	Alloy C276 合金	钽	蒙乃尔 (Alloy 400 合金)
2	150	2.36	3.63	3.63	3.63
2	300	2.36	3.63	3.63	3.63
2	400/600	2.36	3.63	3.63	3.63
2	900/1500	2.36	3.63	3.63	3.63
2	2500	2.36	3.63	3.63	3.63
3	150	3.50	5.00	5.00	5.00
3	300	3.50	5.00	5.00	5.00
3	400/600	3.50	5.00	5.00	5.00
3	900	3.50	5.00	5.00	5.00
3	1500	3.50	5.00	5.00	5.00
3	2500	3.50	5.00	5.00	5.00

ASME B16.5 法兰（型式 RTJ），齐平安装膜片，隔膜密封系统
连接尺寸符合 ASME B 16.5 标准。

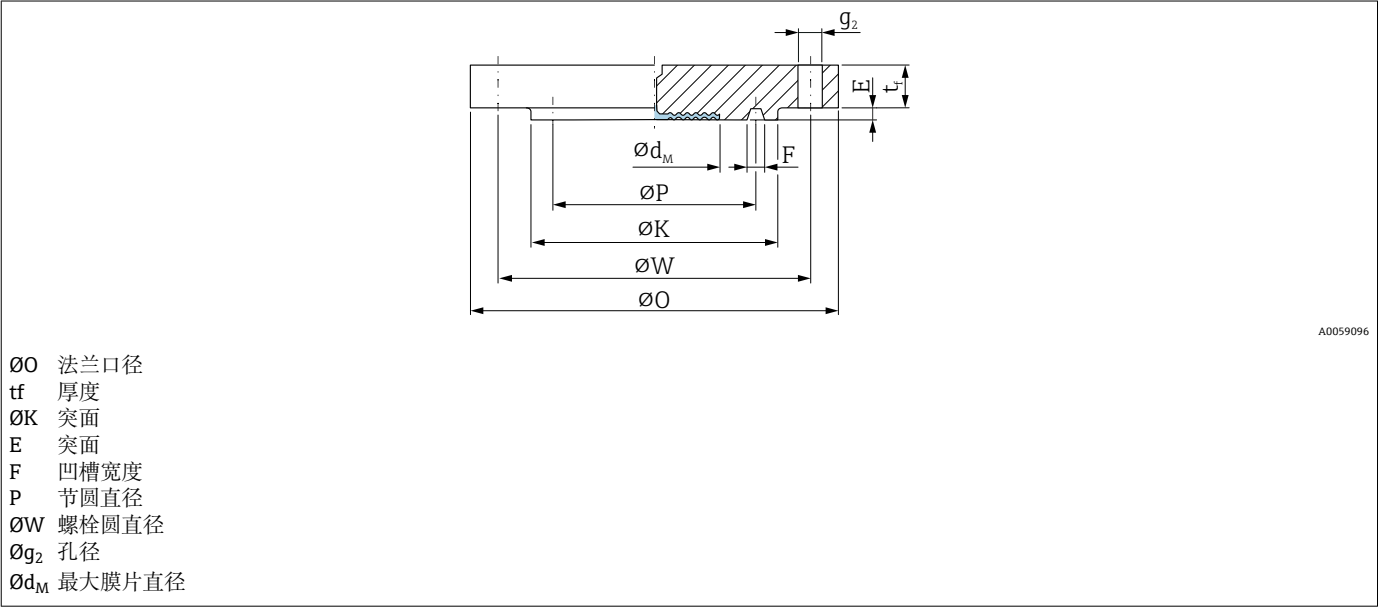


法兰 ^{1) 2)}								螺栓孔			选型代号 ³⁾
公称管道尺寸 NPS	压力等级 Class	ØO	tf	P	E	F	ØK	数量	Øg ₂	ØW	
in		in	in	in	in	in	in		in	in	
2	150	6	0.71	82.55	6.35	8.74	102	4	3/4	4.75	ADJ
2	300	6.5	0.81	82.55	7.92	11.91	108	8	3/4	5	AQJ
2	400/600	6.5	1.00	82.55	7.92	11.91	108	8	3/4	5	A0J
2	900/1500	8.46	1.52	95.25	7.92	11.91	124	8	1	6.5	BFJ
2	2500	9.25	2.01	101.60	7.92	11.91	133	8	1 1/8	6.75	BLJ
3	150	7.5	0.88	114.30	6.35	8.74	133	4	3/4	6	AFJ
3	300	8.23	1.06	123.82	7.92	11.91	146	8	7/8	6.63	ASJ
3	400/600	8.23	1.23	123.82	7.92	11.91	146	8	7/8	6.63	A1J
3	900	9.80	1.5	123.82	7.92	11.91	155	8	1	7.5	BAJ
3	1500	10.43	1.88	136.52	7.92	11.91	168	8	1.3	8	BGJ
3	2500	12.01	2.63	127	9.53	13.49	168	8	1.42	9	BMJ

1) 材质: AISI 316L
2) 法兰突面材质与膜片材质相同。
3) Configurator 产品选型软件，订购选项“过程连接”

膜片最大直径 $\varnothing d_M$

公称管道尺寸 NPS	压力等级 Class	$\varnothing d_M$ (in)			
		316L	Alloy C276 合金	钽	蒙乃尔 (Alloy 400 合金)
2	150	2.36	3.63	3.63	3.63
2	300	2.36	3.63	3.63	3.63
2	400/600	2.36	3.63	3.63	3.63
2	900/1500	2.36	3.63	3.63	3.63
2	2500	2.36	3.63	3.63	3.63
3	150	3.50	5.00	5.00	5.00
3	300	3.50	5.00	5.00	5.00
3	400/600	3.50	5.00	5.00	5.00
3	900	3.50	5.00	5.00	5.00
3	1500	3.50	5.00	5.00	5.00
3	2500	3.50	5.00	5.00	5.00

ASME B16.5 法兰（型式 LG），齐平安装膜片，隔膜密封系统
连接尺寸符合 ASME B 16.5 标准。

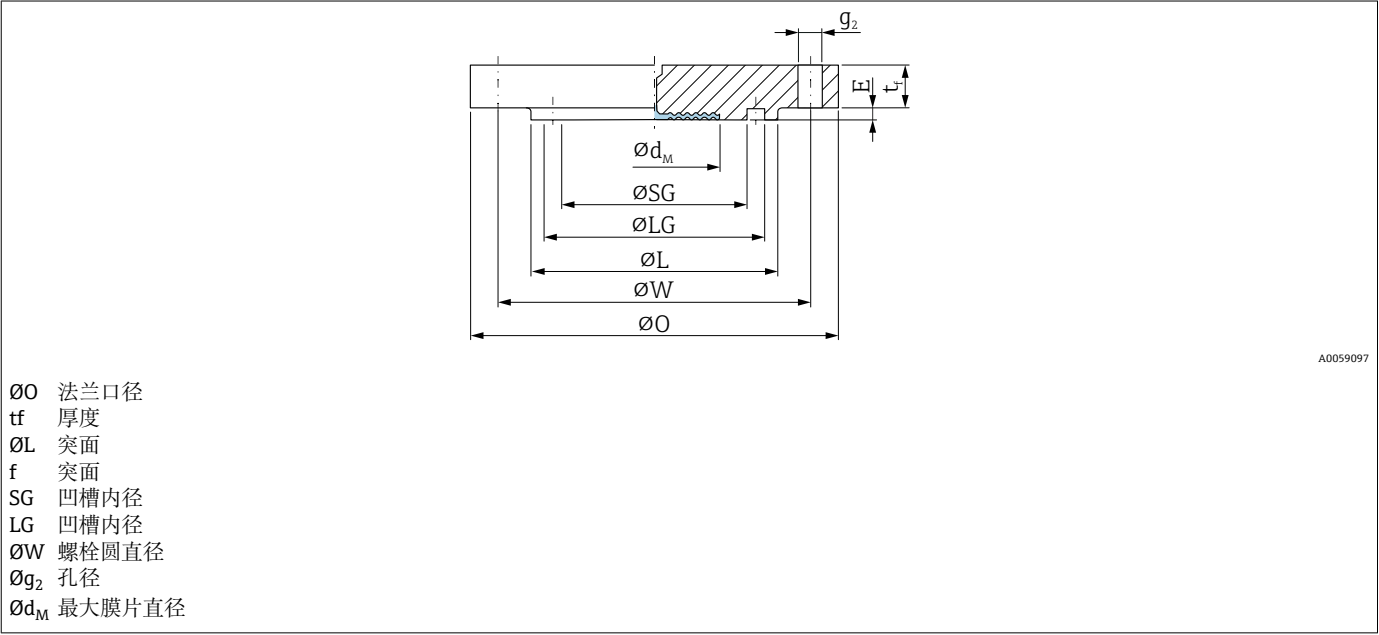

法兰 ^{1) 2)}								螺栓孔			选型代号 ³⁾
公称管道尺寸 NPS	压力等级 Class	ØO	tf	ØL	f	SG	LG	数量	Øg ₂	ØW	
in		in	in	in	in	mm	mm		in	in	
2	150	6	0.71	3.63	0.08	71.4	93.7	4	3/4	4.75	ADJ
2	300	6.5	0.81	3.63	0.08	71.4	93.7	8	3/4	5	AQJ
2	400/600	6.5	1.00	3.63	0.28	71.4	93.7	8	3/4	5	A0J
2	900/1500	8.46	1.52	3.63	0.28	71.4	93.7	8	1	6.5	BFJ
2	2500	9.25	2.01	3.63	0.28	71.4	93.7	8	1 1/8	6.75	BLJ
3	150	7.5	0.88	5	0.08	106.4	128.5	4	3/4	6	AFJ
3	300	8.23	1.06	5	0.08	106.4	128.5	8	7/8	6.63	ASJ
3	400/600	8.23	1.23	5	0.28	106.4	128.5	8	7/8	6.63	A1J
3	900	9.80	1.5	5	0.28	106.4	128.5	8	1	7.5	BAJ
3	1500	10.43	1.88	5	0.28	106.4	128.5	8	1.3	8	BGJ
3	2500	12.01	2.63	5	0.28	106.4	128.5	8	1.42	9	BMJ

- 1) 材质: AISI 316L
2) 法兰突面材质与膜片材质相同。
3) Configurator 产品选型软件, 订购选项“过程连接”

膜片最大直径 $\varnothing d_M$

公称管道尺寸 NPS	压力等级 Class	$\varnothing d_M$ (in)			
		316L	Alloy C276 合金	钽	蒙乃尔 (Alloy 400 合金)
2	150	2.36	3.63	3.63	3.63
2	300	2.36	3.63	3.63	3.63
2	400/600	2.36	3.63	3.63	3.63
2	900/1500	2.36	3.63	3.63	3.63
2	2500	2.36	3.63	3.63	3.63
3	150	3.50	5.00	5.00	5.00
3	300	3.50	5.00	5.00	5.00
3	400/600	3.50	5.00	5.00	5.00
3	900	3.50	5.00	5.00	5.00
3	1500	3.50	5.00	5.00	5.00
3	2500	3.50	5.00	5.00	5.00

重量

过程连接

重量 ¹⁾	选型代号 ²⁾
1.20 kg (2.65 lb)	AAJ
1.50 kg (3.31 lb)	AMJ
1.60 kg (3.53 lb)	ACJ
2.70 kg (5.95 lb)	APJ
2.50 kg (5.51 lb)	ADJ
3.40 kg (7.50 lb)	AQJ
5.10 kg (11.25 lb)	AFJ
7.00 kg (15.44 lb)	ASJ
1.70 kg (3.75 lb)	AXJ
4.30 kg (9.48 lb)	A0J
8.60 kg (18.96 lb)	A1J
13.30 kg (29.33 lb)	BAJ
3.70 kg (8.16 lb)	BDJ
10.30 kg (22.71 lb)	BFJ
21.80 kg (48.07 lb)	BGJ
15.80 kg (34.84 lb)	BLJ
39.00 kg (86.00 lb)	BMJ
1.70 kg (3.75 lb)	BJJ
1.38 kg (3.04 lb)	H0J
3.20 kg (7.06 lb)	H3J
5.54 kg (12.22 lb)	H5J

1) 包括传感器组件和过程连接的总重量。

2) Configurator 产品选型软件，订购选项“过程连接”

接液部件材质

膜片材质

- 316L
- Alloy C276 合金
法兰突面材质与膜片材质相同。
 - 使用 EN 1092-1 法兰时, 材质为 316L
 - 使用 ASME 法兰时, 材质为 316L
- 钽
法兰突面材质与膜片材质相同。
 - 使用 EN 1092-1 法兰时, 材质为 316L
 - 使用 ASME 法兰时, 材质为 316L
- Monel 蒙乃尔 (Alloy 400 合金)
法兰突面材质与膜片材质相同。
 - 使用 EN 1092-1 法兰时, 材质为 316L
 - 使用 ASME 法兰时, 材质为 316L

膜片涂层

PTFE:

- 涂层: 50 ... 65 µm (0.0019 ... 0.0025 µin)
- 最大过程压力:
 - 过程温度 ≤ +40 °C (+104 °F): 最大过程压力+150 bar (+2 175 psi)
 - 过程温度 ≤ +150 °C (+302 °F): 最大过程压力+50 bar (+725 psi)
 - 过程温度 ≤ +200 °C (+392 °F): 最大过程压力+20 bar (+290 psi)
- 允许过程温度:
 - -40 ... +260 °C (-40 ... +500 °F)
 - 在 $p_{abs} \leq 1$ bar 的真空或负压条件下: -40 ... +200 °C (-40 ... +392 °F)
- PTFE 涂层用作防粘附层, 防止介质磨损

金:

涂层: 25 µm (0.00098 µin)

非接液部件材质

毛细管护套

316L

- 毛细管: ASTM 312 - 316L
- 毛细管保护套: ASTM A240 - 316 L

证书和认证

腐蚀测试

特定型号可选标准和测试方法。

关于所选系统配置和或订货号的详细说明，请联系 Endress+Hauser。

溢出保护系统

此仪表型号尚未根据§63 WHG（德国水资源法）进行溢出保护验证。

船级社认证

此仪表型号未获得船级社认证。

CRN 认证

此仪表型号未获得 CRN 认证。

测试报告

测试、证书、声明

此仪表型号不满足以下要求：

- AD 2000（金属接液部件）、声明，不包括膜片
- NACE MR0175 / ISO 15156（金属接液部件）、声明
- ASME B31.3 过程管道、声明
- ASME B31.1 动力管道、声明
- NACE MR0103/ISO 17945（接液部件）、测试报告

此仪表型号不能提供以下测试：

- 氮气泄漏测试、内部程序、测试报告
- 焊接文档、接液/带压焊缝
- EN 10204 - 3.1 材质证书（金属接液部件材质证书）
- 光谱现场测试（PMI）、内部程序（接液金属部件）、测试报告
- 液体渗透测试 ISO23277-1（PT），接液/带压金属部件，测试报告
- NACE MR0103/ISO 17945（接液部件）、测试报告
- 变送器环境温度范围（-50 °C (-58 °F)），传感器环境温度范围，参见规格参数
- 变送器环境温度范围（-60 °C (-76 °F)），传感器环境温度范围，参见规格参数

制造商声明

此仪表型号目前无有效的制造商声明。

如需要，请咨询 Endress+Hauser。



www.addresses.endress.com

中国E+H技术销售 www.ainstru.com
电话: 0755-82221901
邮箱: sales@ainstru.com